

Mode **Take a New Calibration Point**

Calib file



iBook_G4_HD :Users :paul_local :Documents :LabVIEW_data :
Examples :Calib_Files :XW_Calib1.txt

Calib const

n1	0.690000
A1	-3.455017
B1	8.399167
Av % err1	0.107615
n2	0.680000
A2	-2.879345
B2	7.973111
Av % err2	0.109003
psi1	33.24690500
psi2	30.96760200

n 0.45

Find best n

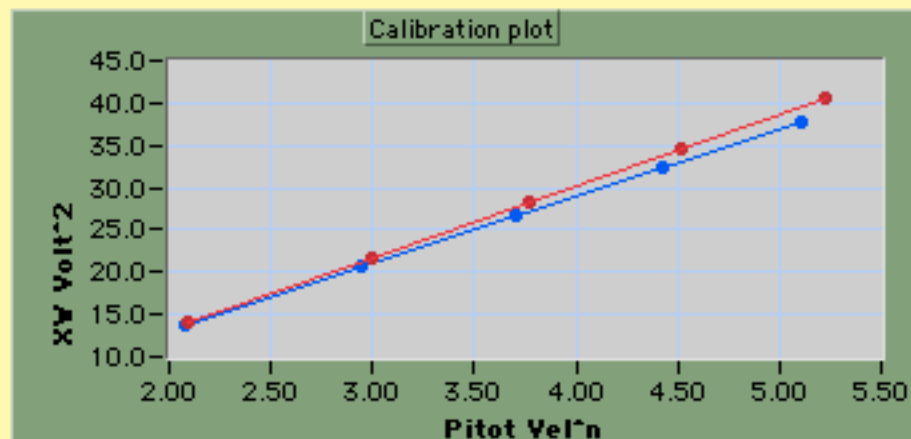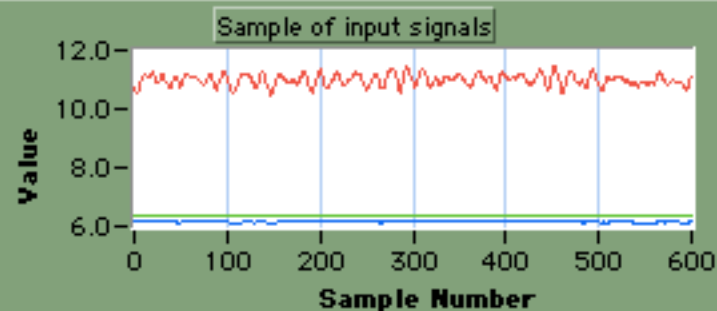

Pitot Vel

XW1 Voltage

XW2 Voltage

Samples /ch

600

Sampling Rate /ch (Hz)

100.00

XW1 Volt

3.761	4.661	5.311	5.873	6.359	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.694	4.544	5.158	5.690	6.148	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.921	4.903	6.857	8.891	10.983	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XW2 Volt

Pitot Vel

Selector