

Mode **Take a New Calibration Point**

Calib file



iBook\_G4\_HD :Users :paul\_local :Documents :LabVIEW\_data :  
Examples :Calib\_Files :XW\_Calib.txt

Calib const

n1	0.635000
A1	-6.187430
B1	10.024619
Av % err1	0.129032
n2	0.625000
A2	-5.382556
B2	9.516991
Av % err2	0.132940
psi1	0.0000000000
psi2	0.0000000000

n 0.45

Find best n

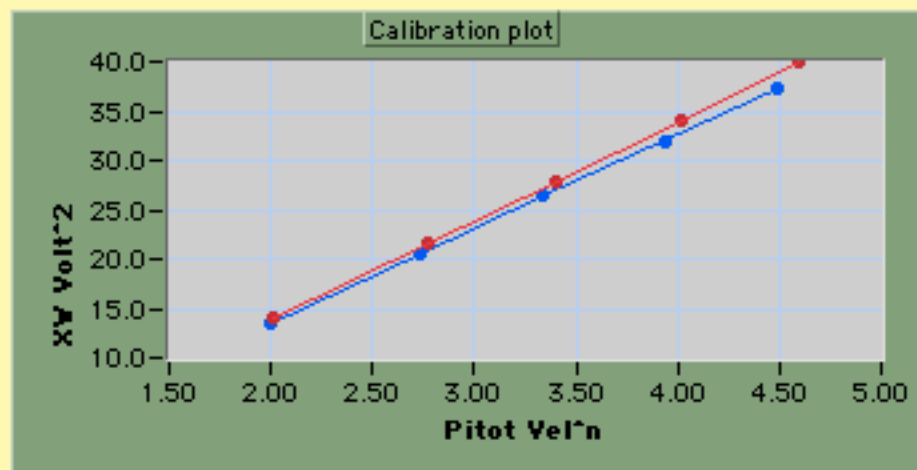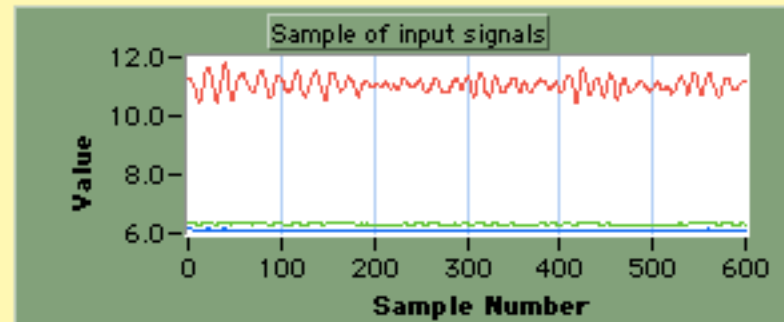

Pitot Vel

XW1 Voltage

XW2 Voltage

Samples /ch

600

Sampling Rate /ch (Hz)

100.00

XW1 Volt

3.746	4.653	5.286	5.837	6.319	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.688	4.540	5.138	5.657	6.112	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.018	4.997	6.874	8.944	11.053	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

XW2 Volt

Pitot Vel

Selector