Calibration.vi

Calib Prog

Mode: Take a New Calibration Point

Calib file: iBook_G4_HD:Users:paul_local:Documents:LabVIEW_data:Examples:Calib_Files:XW_Calib1.txt

n: 0.45 Find best n

Calib const

n1	0.100000
A1	NaN
B1	NaN
Av % err1	NaN
n2	0.100000
A2	NaN
B2	NaN
Av % err2	NaN
psi1	33.24690500
psi2	30.96760200

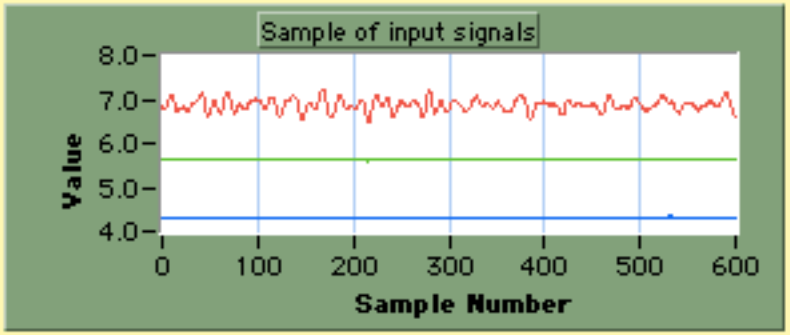

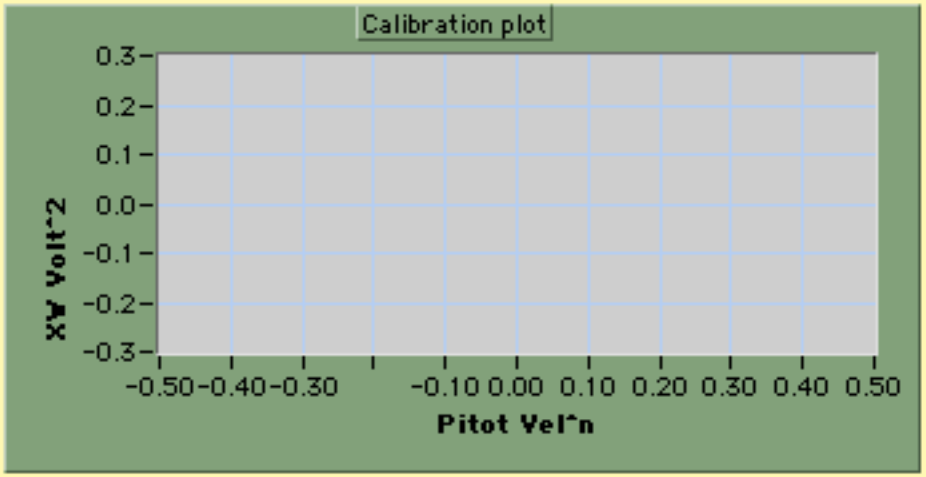

Pitot Vel
XW1 Voltage
XW2 Voltage

Samples /ch: 600

Sampling Rate /ch (Hz): 100.00

XW1 Volt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
XW2 Volt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Pitot Vel	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selector														