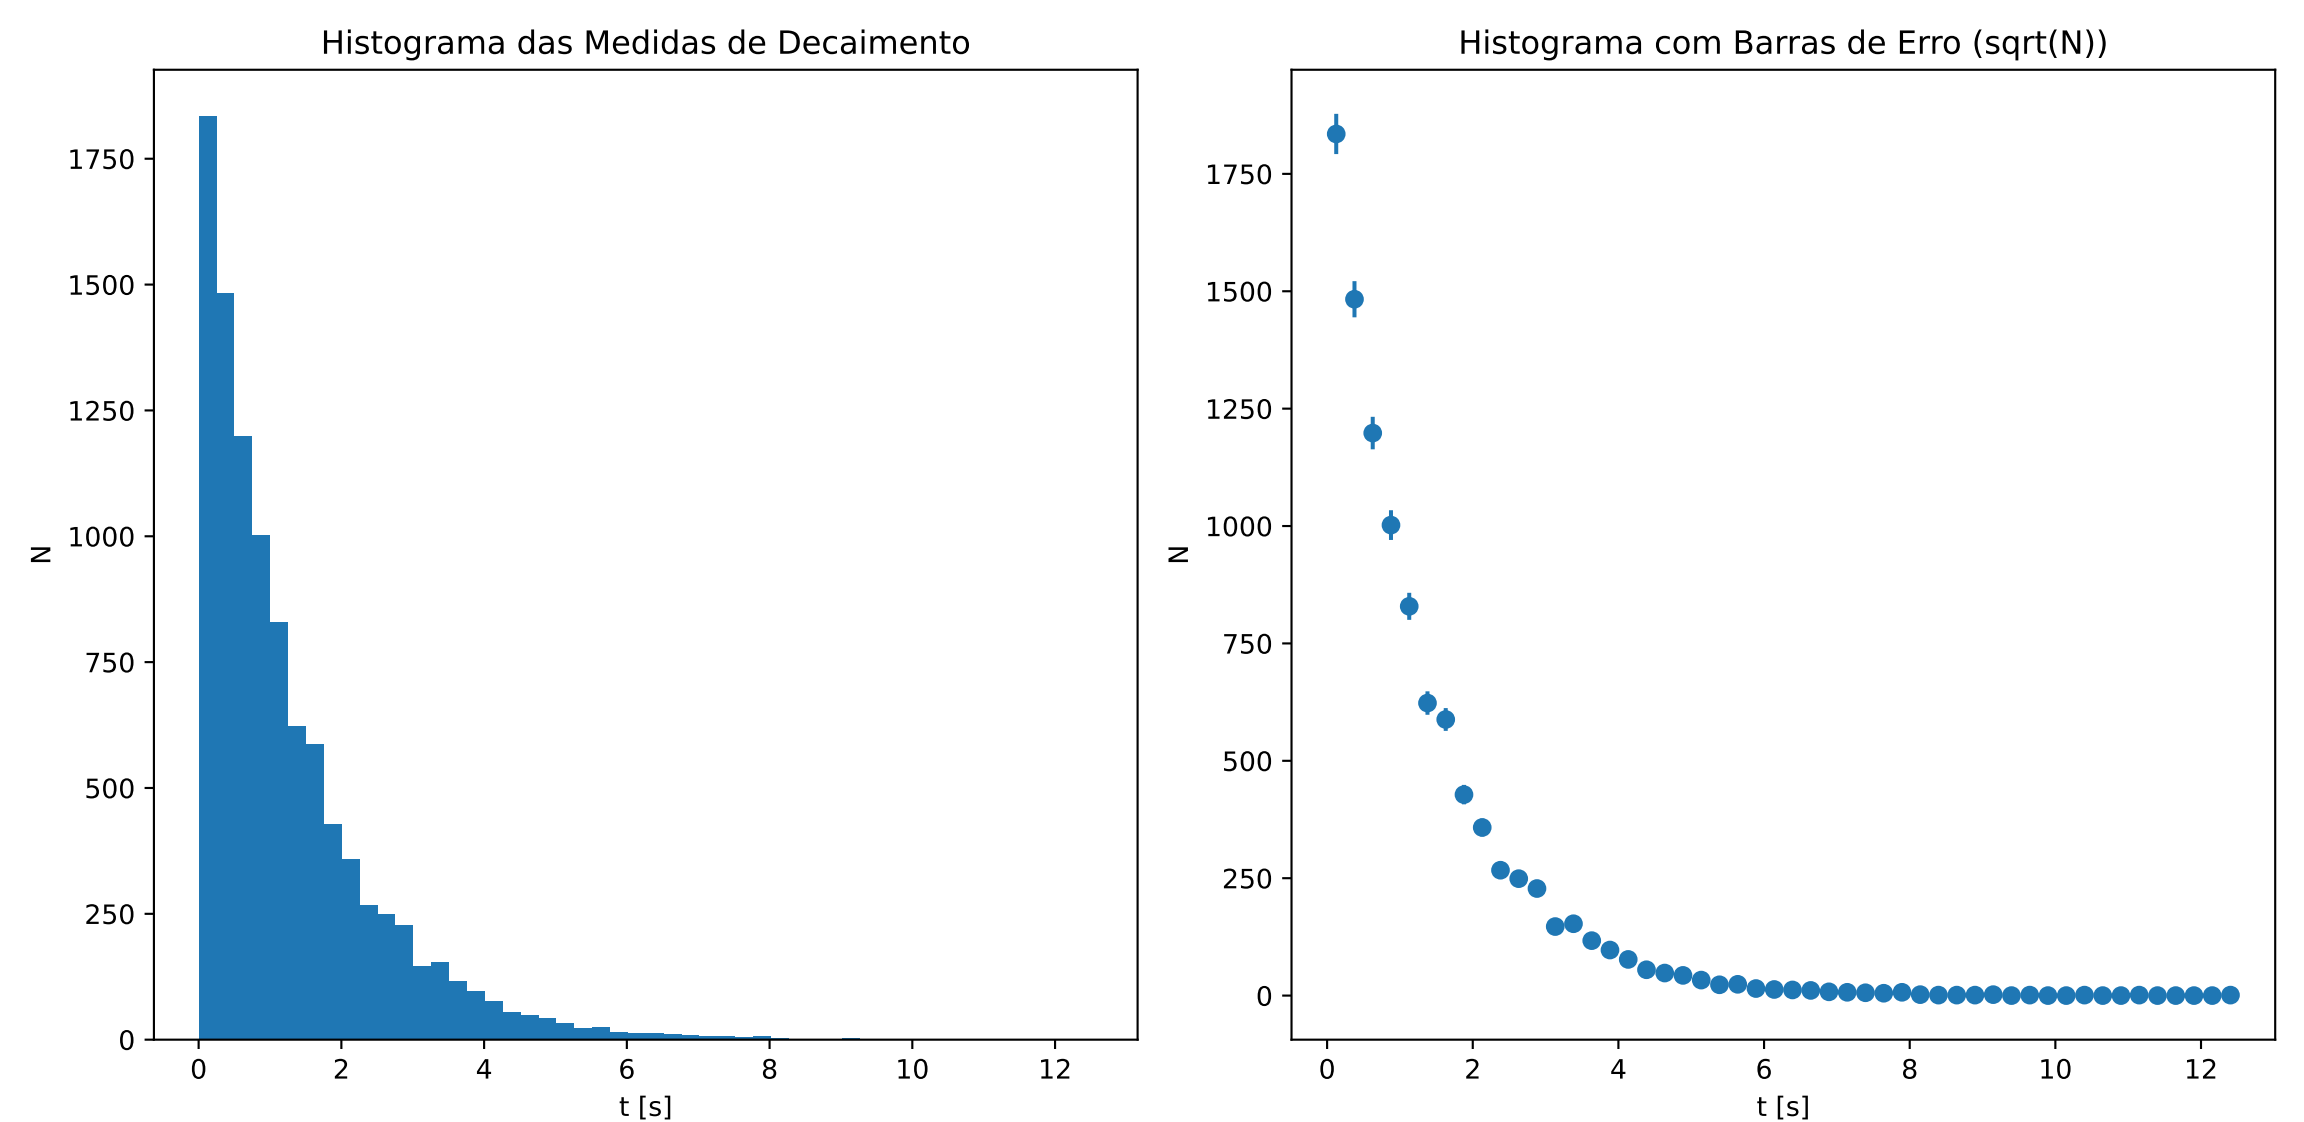
Histograma das Medidas de Decaimento
N
t [s]
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
0
2
4
6
8
10
12
Histograma com Barras de Erro (sqrt(N))
N
t [s]
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
0
2
4
6
8
10
12