


TCN19-123 normalized to TCN19-120A: 1.0060021689738605 +/- 0.005916085747193024

Transmission (normalized during counting)

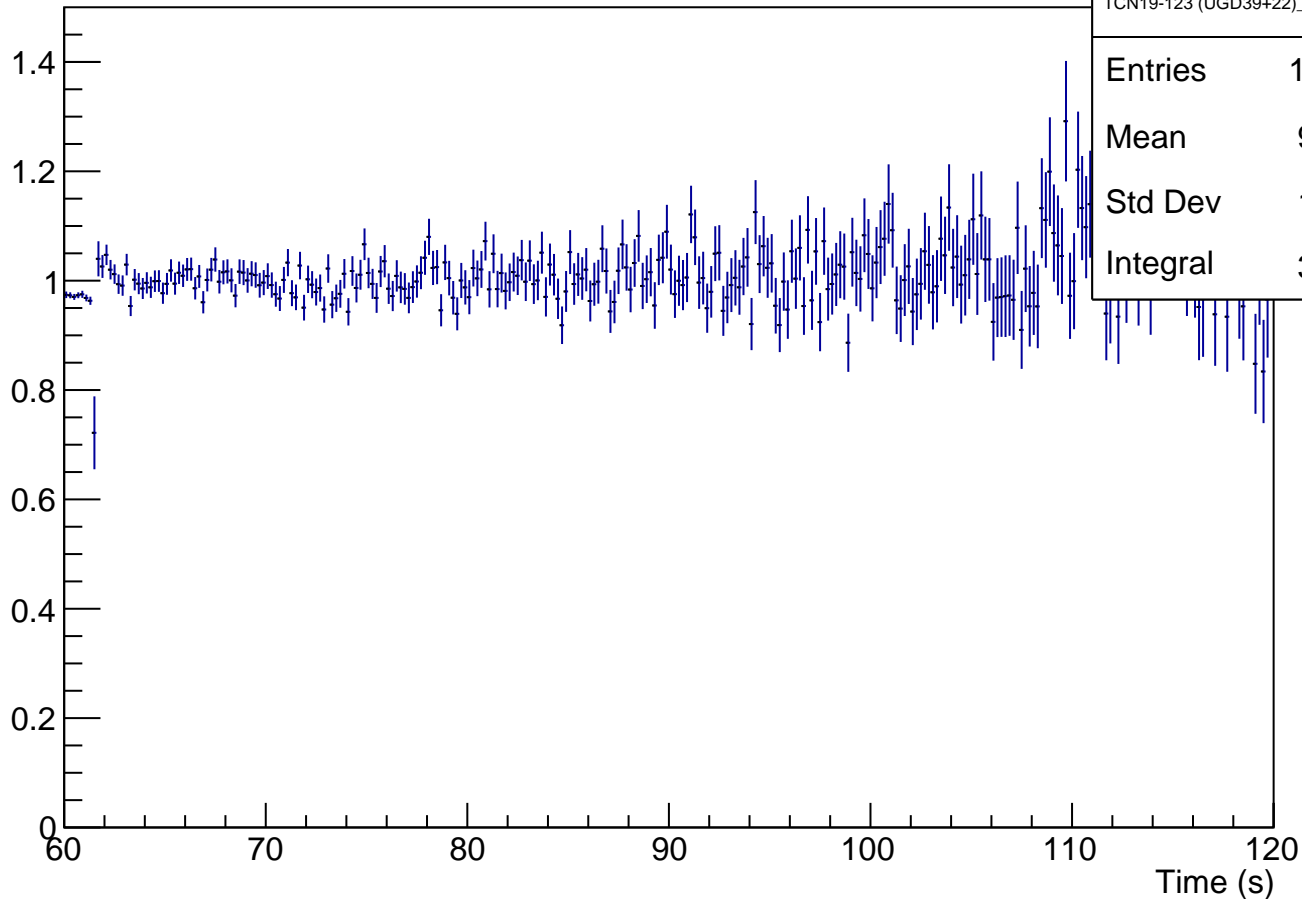


TCN19-123 (UGD39+22)\_Li6\_norm

Entries	12982
Mean	90.48
Std Dev	17.39
Integral	306.5

TCN19-123 normalized to TCN19-120A: 1.0079861872097713 +/- 0.007182500995234526

Transmission (normalized during irradiation)

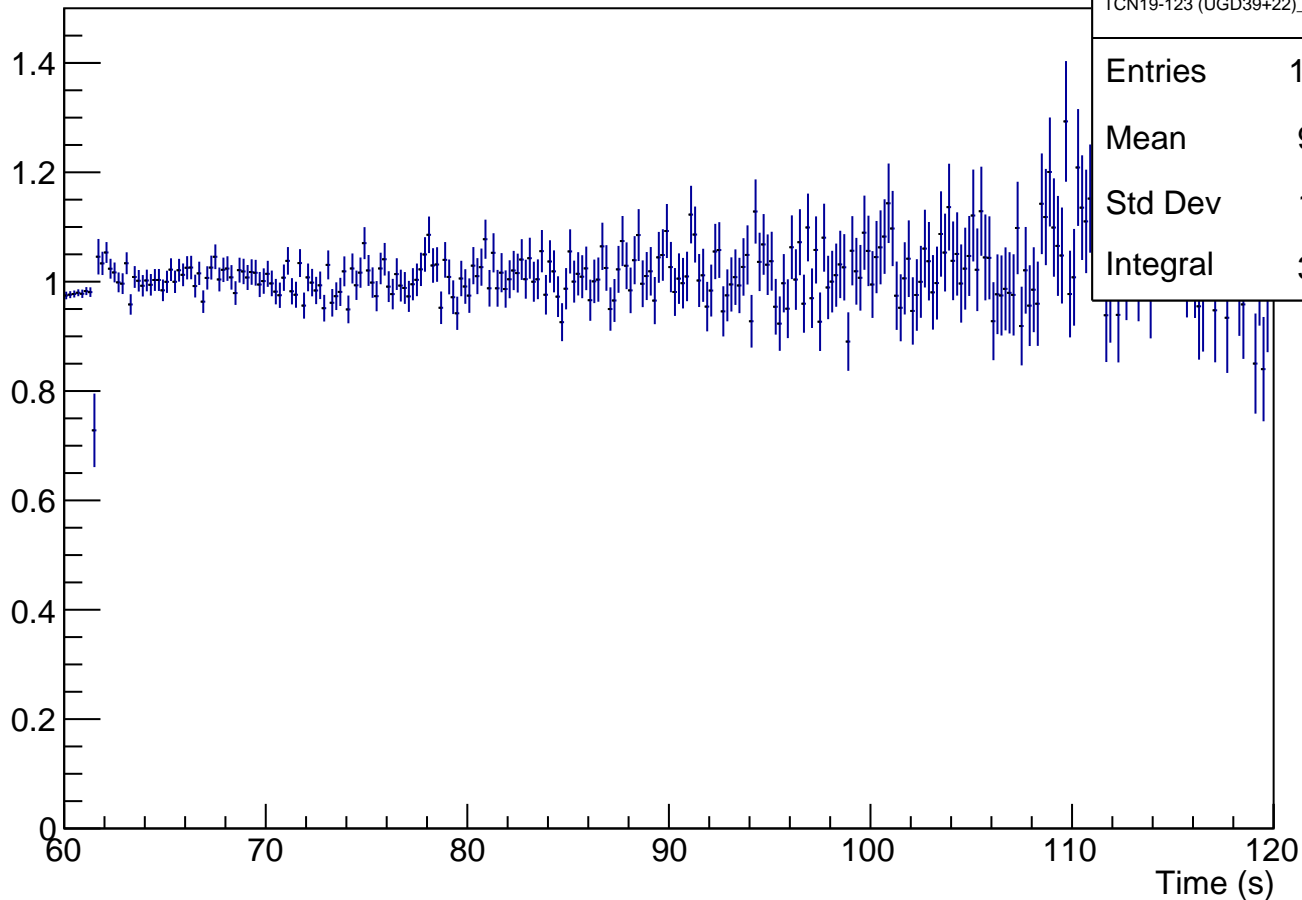

TCN19-123 (UGD39+22)\_Li6\_norm

Entries 12835

Mean 90.48

Std Dev 17.39

Integral 308.2