


TCN19-010E normalized to TCN19-010: 0.945992270901004 +/- 0.004880489581453132

Transmission (normalized during counting)

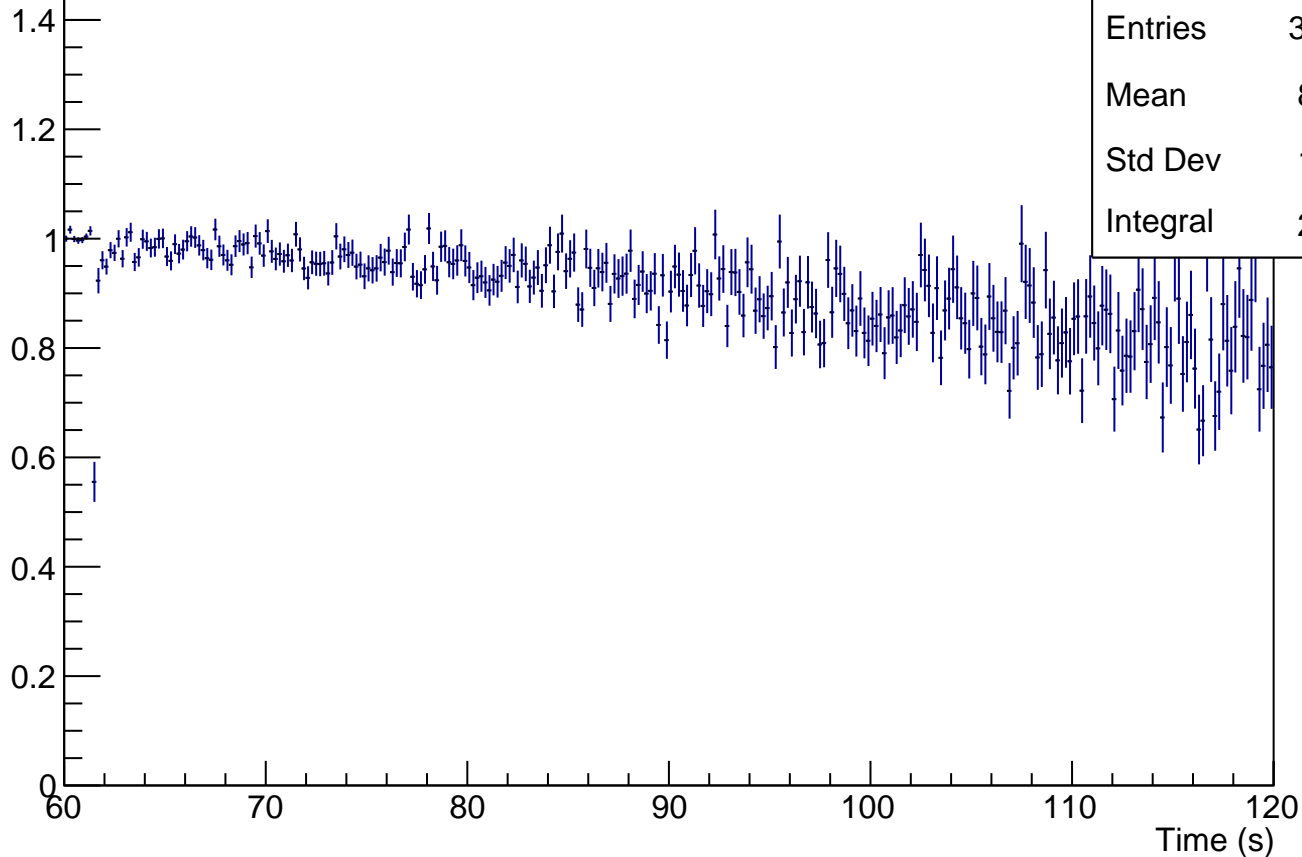

TCN19-010E normalized to TCN19-010: 0.9388757680099777 +/- 0.005791040549530299

Transmission (normalized during irradiation)

