



Powermeter: eingebaute Kalibrierkennlinien

Firmware 0.1.30 · tatsächliche Stützstellen aus power_calibration.h · Detektoren: 1N4148

Gesamter kalibrierter Bereich

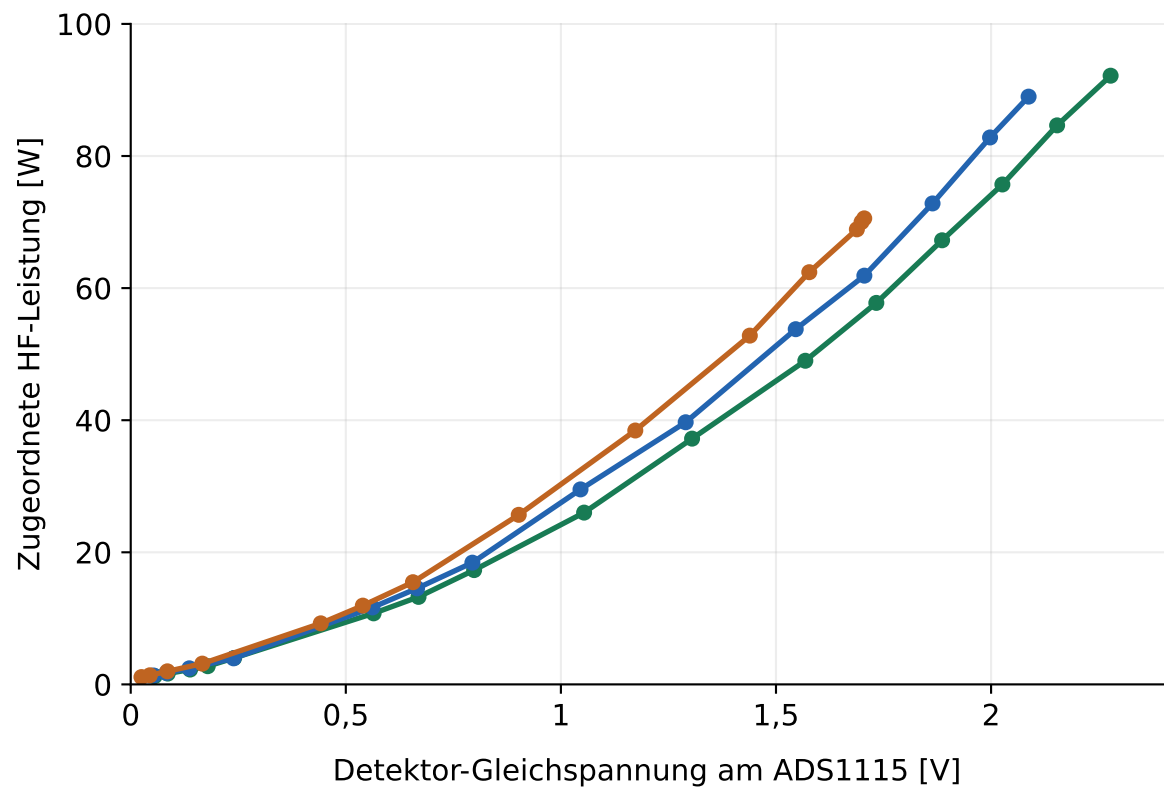

Unterer Bereich vergrößert

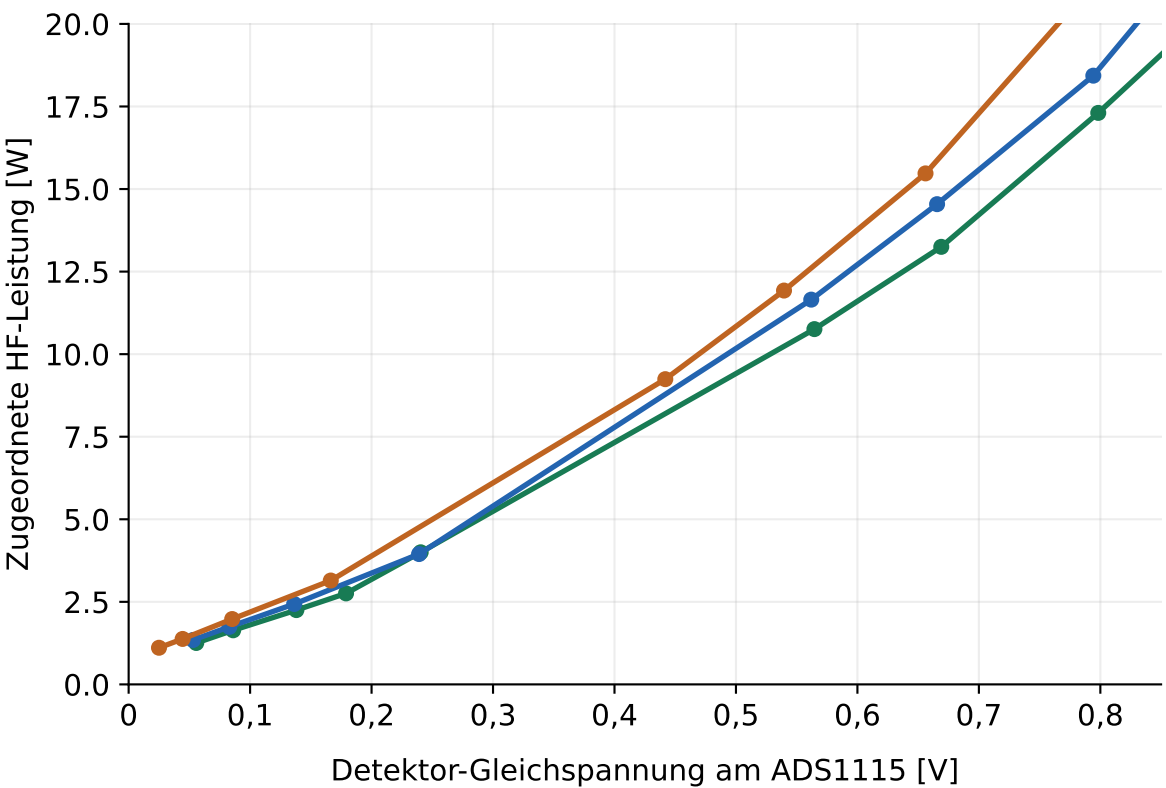

- Vorlauf · 7,03167 MHz · A0–A3
- Rücklauf · 7,1 MHz · A1–A3
- Rücklauf · 50,1 MHz · A1–A3

Punkte: hinterlegte Messstützstellen. Linien: lineare Interpolation wie in der Firmware; keine Extrapolation.

Vpp-Sinusreferenz an 50 Ω · Rücklauf mit umgedrehtem Koppler gemessen · Kennlinien vorläufig, aufbauabhängig.

Unterhalb der ersten Rücklaufstützstelle ist „~1“ nur eine Anzeigeannahme, kein Bestandteil dieser Kennlinien.