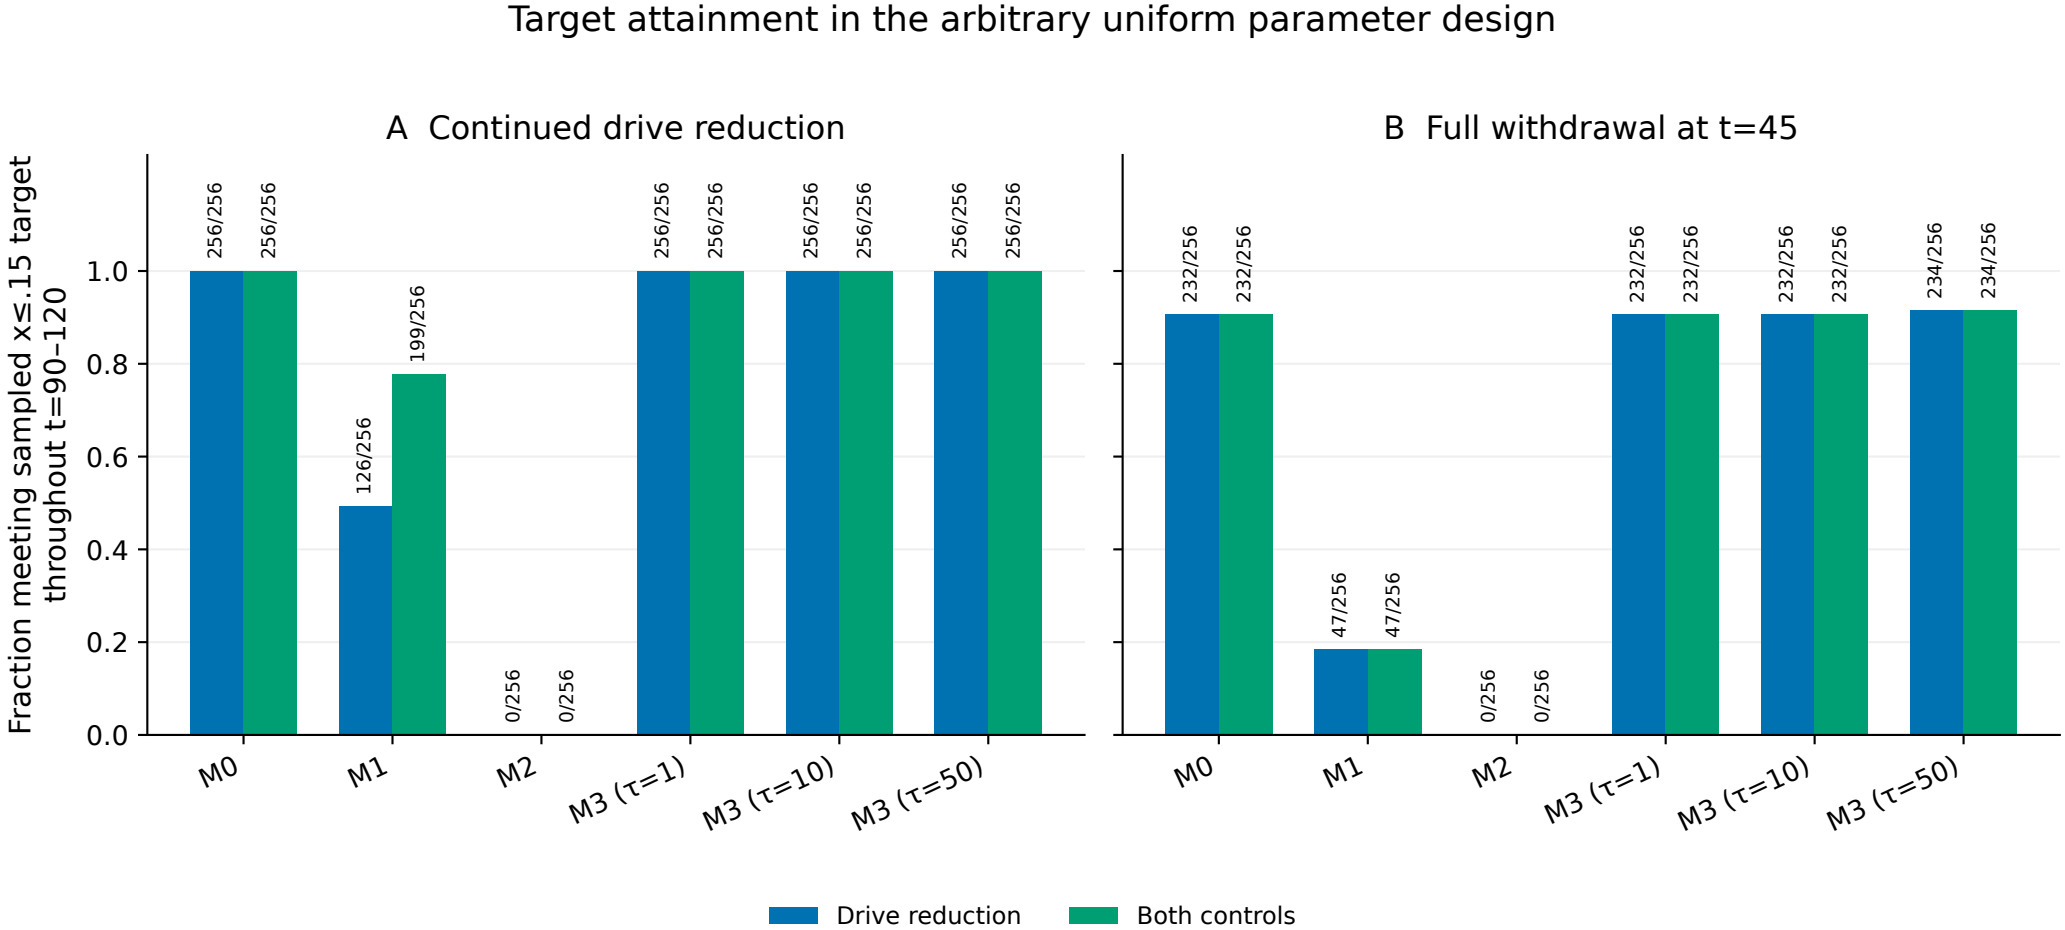
Target attainment in the arbitrary uniform parameter design
A Continued drive reduction
B Full withdrawal at t=45
Fraction meeting sampled x≤.15 target throughout t=90–120
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
256/256
256/256
126/256
199/256
0/256
0/256
256/256
256/256
256/256
256/256
256/256
256/256
232/256
232/256
47/256
47/256
0/256
0/256
232/256
232/256
232/256
232/256
234/256
234/256
M0
M1
M2
M3 (τ=1)
M3 (τ=10)
M3 (τ=50)
Drive reduction
Both controls
256 synthetic settings per bar; nominal excluded. M0/M3 ignore b. These are not patient probabilities.