



[illegible]

CALIBRATION TABLE				
Model Designation	Volume [L]	Frequency [Hz]	Time [s] [l]	Flow [L/s]
100AB	4.0	22.5	180.0	0.0222
100AB	4.0	47.5	87.5	0.0457
100AB	4.0	83.5	51.5	0.0777
100BC	4.0	12.0	159.6	0.0251
100BC	4.0	17.5	113.2	0.0353
100BC	4.0	21.0	93.8	0.0427
100BC	4.0	34.3	58.0	0.0690
100BC	4.0	41.6	47.8	0.0836
100BC	4.0	50.0	40.0	0.1001
100BC	4.0	60.0	33.4	0.1198
100DC	4.0	11.6	48.1	0.0832
100DC	4.0	14.9	38.1	0.1051
100DC	4.0	16.5	34.7	0.1154
100DC	4.0	18.3	31.5	0.1270
100DC	4.0	19.8	30.1	0.1329
100DC	4.0	28.7	22.6	0.1770
300	10.0	14.2	53.6	0.1866
300	10.0	16.5	49.1	0.2037
300	10.0	18.4	42.1	0.2374
300	10.0	19.7	41.8	0.2395
300	10.0	23.5	34.3	0.2919
300	10.0	30.0	27.1	0.3697
300	10.0	40.0	20.6	0.4859
300	10.0	50.5	15.3	0.6545
300	10.0	68.0	11.2	0.8929
300B	10.0	17.0	112.8	0.0886
300B	10.0	20.8	96.1	0.1040
300B	10.0	26.4	78.5	0.1273
300B	10.0	34.7	64.5	0.1552
300B	10.0	41.3	55.5	0.1802
300B	10.0	48.8	45.9	0.2181
300B	10.0	51.5	42.0	0.2383


11.5	66.7
10.7	66.5
9.8	64.71





9.41E-04	0.00E+00
1.23E-05	#N/A
0.9997	1.21E-03
5.84E+03	2.00E+00
8.61E-03	2.95E-06

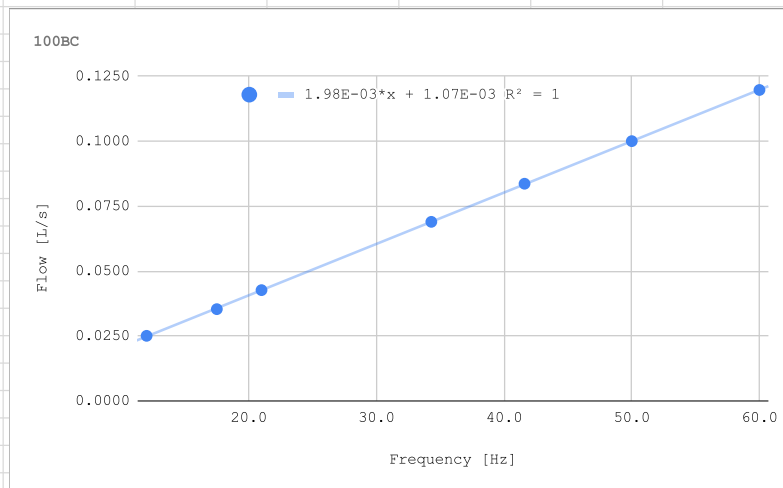

2.01E-03	0.00E+00
5.51E-06	#N/A
1.0000	5.48E-04
1.32E+05	6.00E+00
3.98E-02	1.80E-06



6.64E-03	0.00E+00
1.73E-04	#N/A
0.9966	8.08E-03
1.47E+03	5.00E+00



[1] Time to fill 1L beaker