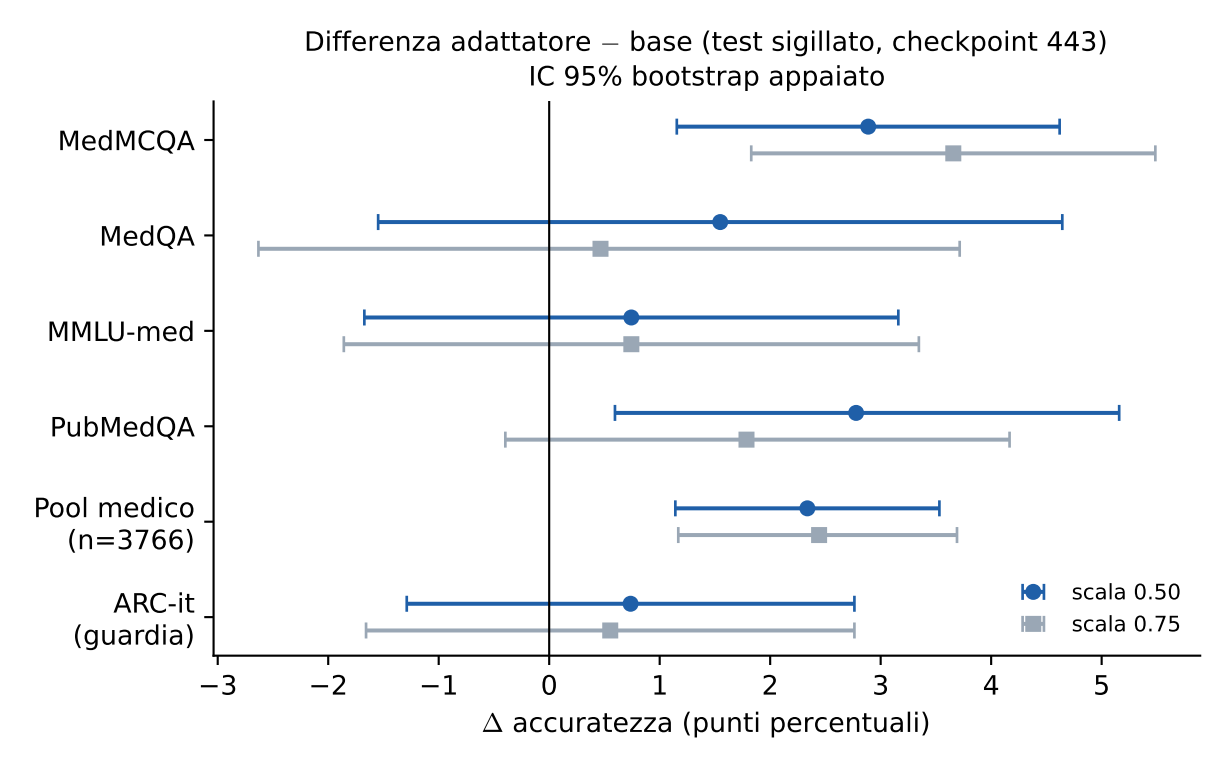
Differenza adattatore − base (test sigillato, checkpoint 443)
IC 95% bootstrap appaiato
MedMCQA
MedQA
MMLU-med
PubMedQA
Pool medico (n=3766)
ARC-it (guardia)
scala 0.50
scala 0.75
−3
−2
−1
0
1
2
3
4
5
Δ accuratezza (punti percentuali)