

半英寸双波片一体转接块


右视图 Y / Z

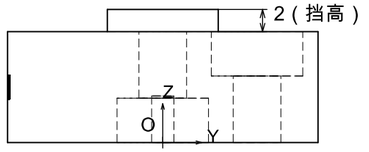

主视图 X / Z

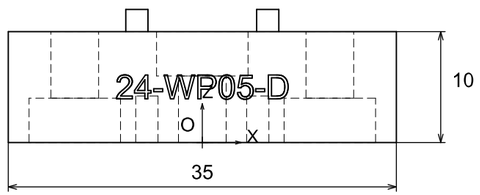

俯视图 X / Y

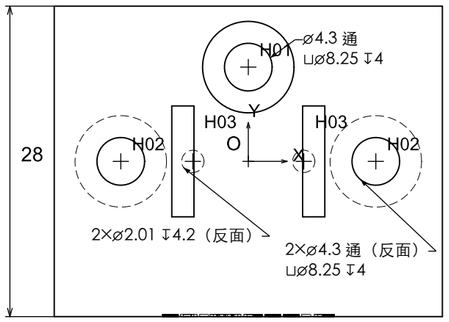

加工基准与说明

以主底面为Z=0，原万能柱轴投影为X=Y=0；原点距最小X外廓17.5、距最小Y外廓14。本图坐标单位mm。

未注尺寸公差、孔配合公差及表面粗糙度待加工确认。Ø2.01为沿用名义尺寸，未指定H7；双销须与原柱试配。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 按新37.5柱+本件承台10+CMRM05S中心高15，名义光轴为62.5。后挡高2不计入承台厚度。
5. 离柱先从底面固定CMRM05S并靠紧平行后挡，再插销放上正式新版柱，从顶面拧紧柱M4。两类沉孔方向不得颠倒。
6. 商用CMRM05S与3.2厚波片尺寸保持；532nm仅为机械示例，须按实际工作波长选片。
7. 仅0°安装；双波片几何中面X=±12.86，光轴高度62.5。
8. 商业M4×10名义旋入4，原厂牙深5.5。
9. 本图仅加工转接块，不含柱或紧固件；正式柱孔位已核，双销实配与末端完整牙仍须验收。
10. 柱固定建议M4×12；名义旋入6，距8深直段孔底2；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
3451108510c088c0ae988dcacb02334d
e9cc78620046e87de9f4f827e9025627

24-WP05-D / 半英寸双波片一体转接块 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：24-WP05-D-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

半英寸双波片一体转接块

孔坐标与加工标注

局部基准：以主底面为Z=0，原万能柱轴投影为X=Y=0；原点距最小X外廓17.5、距最小Y外廓14。本图坐标单位mm。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	0, 8.5, 10	(0, 0, -1)	主顶面局部Z=10，向下-Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（顶面向下）	对应正式37.5柱M4，孔轴已核；名义孔深8，末端完整牙须验收。
H02	-11.5, 0, 0 11.5, 0, 0	(0, 0, 1)	主底面局部Z=0，向上+Z	2× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（底面向上）	与CMRM05S底M4×0.7螺纹配对。离柱先装；商架图示有效螺纹深5.5。
H03	-5, 0, 0 5, 0, 0	(0, 0, 1)	主底面局部Z=0，向上+Z	2× Ø2.01 盲孔；有效圆柱深4.2，118°钻尖另计	模型未表示钻尖；有效圆柱深4.2，118°钻尖另计约0.604，不得贯穿。双孔须与原柱孔距及实际Ø2销试配。

未注尺寸公差、孔配合公差及表面粗糙度待加工确认。Ø2.01为沿用名义尺寸，未指定H7；双销须与原柱试配。

24-WP05-D / 半英寸双波片一体转接块 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：24-WP05-D-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

半英寸双波片一体转接块

台阶、挡边与刻字

局部基准：以主底面为Z=0，原万能柱轴投影为X=Y=0；原点距最小X外廓17.5、距最小Y外廓14。本图坐标单位mm。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。


编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	主座矩形实体	局部起点(-17.5,-14,0)；X×Y×Z=35×28×10	
S01	短平行后挡；接触平面X=-6.9	局部起点(-6.9,-5,10)；X×Y×Z=2×10×2	保留与波片面平行的接触面；不增加侧向抱挡。商业架底边有0.5倒角，平面接触位于其上方。
S02	短平行后挡；接触平面X=6.9	局部起点(4.9,-5,10)；X×Y×Z=2×10×2	保留与波片面平行的接触面；不增加侧向抱挡。商业架底边有0.5倒角，平面接触位于其上方。
ENG	实体凹刻 24-WP05-D	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 3.9；6.1	加工面 外侧Y=-14；字框中心(0,-14,5)；阅读方向+X、字顶+Z；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差、孔配合公差及表面粗糙度待加工确认。Ø2.01为沿用名义尺寸，未指定H7；双销须与原柱试配。


24-WP05-D / 半英寸双波片一体转接块 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：24-WP05-D-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

24-WP05-D 半英寸双波片一体转接块
材料：316L不锈钢；去磁、钝化
以主底面为Z=0，原万能柱轴投影为X=Y=0；原点距最小X外廓17.5、距最小Y外廓14。本图坐标单位mm。
未注尺寸公差、孔配合公差及表面粗糙度待加工确认。Ø2.01为沿用名义尺寸，未指定H7；双销须与原柱试配。
H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（顶面向下）；入口 主顶面局部Z=10，向下-Z；局部XYZ 0；8.5；10
H02 2× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（底面向上）；入口 主底面局部Z=0，向上+Z；局部XYZ -11.5；0；0；11.5；0；0
H03 2× Ø2.01 盲孔；有效圆柱深4.2，118°钻尖另计；入口 主底面局部Z=0，向上+Z；局部XYZ -5；0；0；5；0；0

右视图 Y / Z



主视图 X / Z

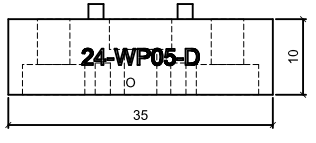

俯视图 X / Y

