原1inch可调镜架真承镜面校正转接件

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号

右视图 Y / Z

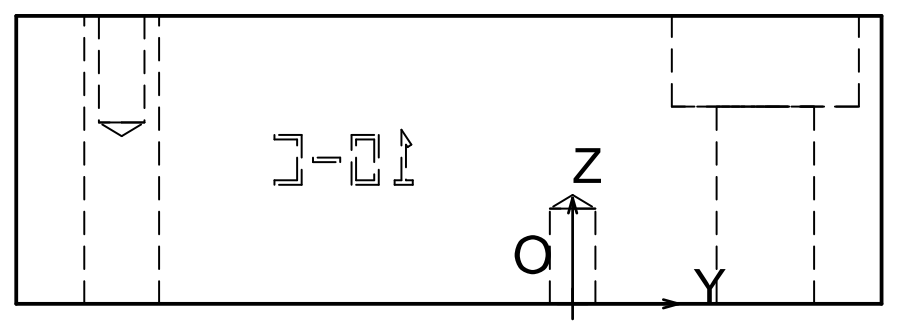

主视图 X / Z

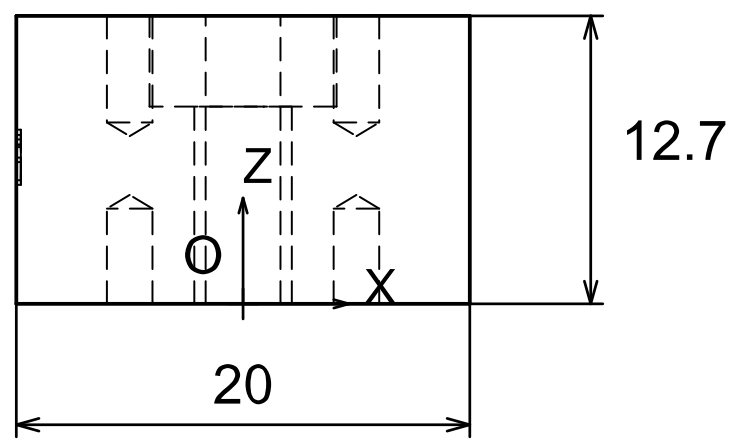

俯视图 X / Y

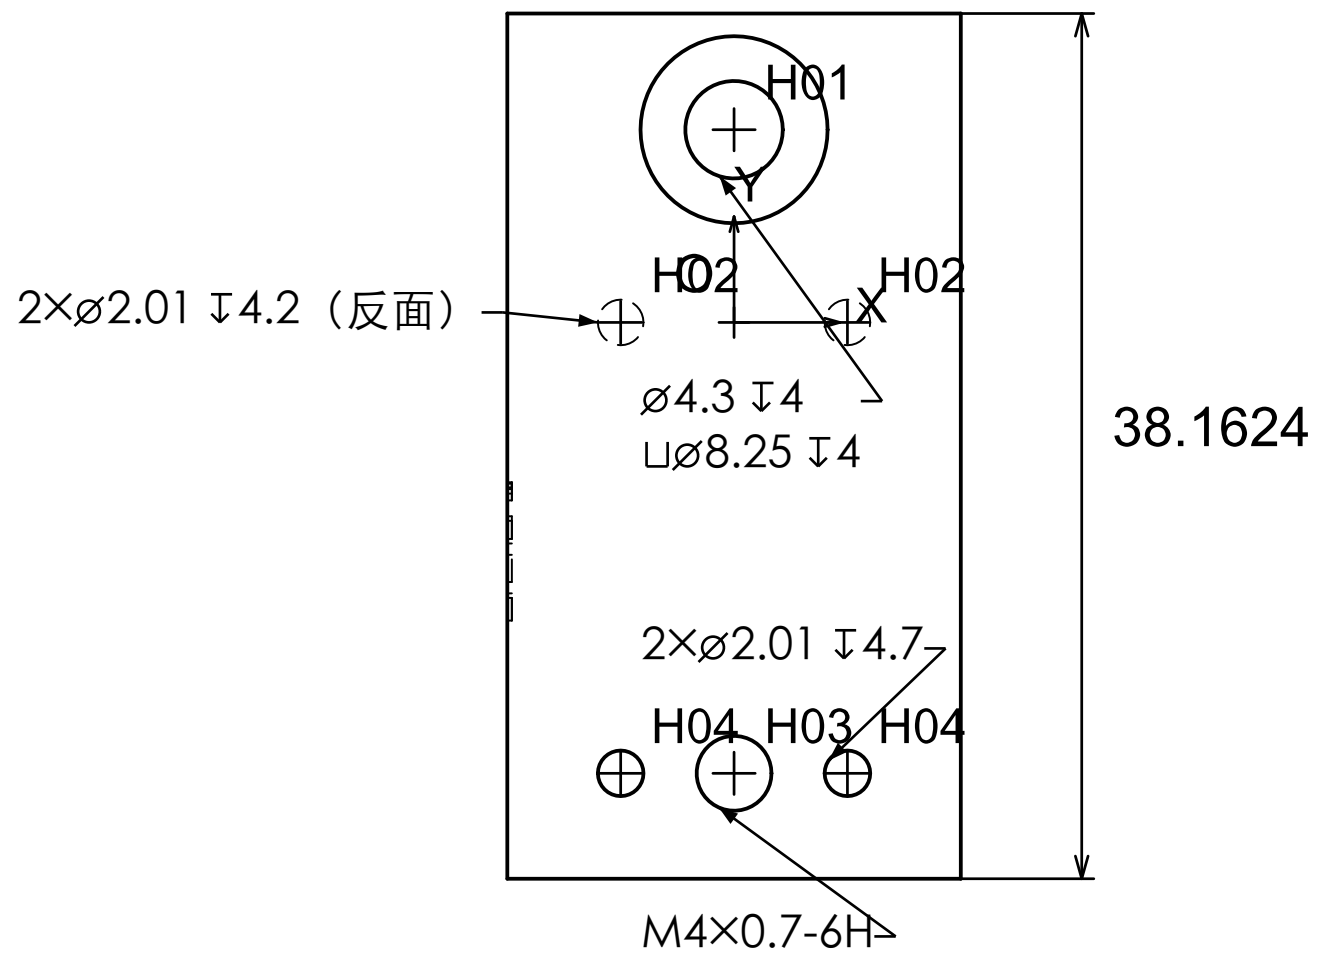

加工基准与说明

单件以正式柱轴与底面交点为原点；X为镜架宽度负向，Y为真实镜片前法向，Z沿柱轴朝镜架。底面全局Z12.5、局部Z0；X负边距10，Y负边距24.5373629。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 本图仅定制加工件；商用器件、万能柱与标准螺钉不出加工图。
5. 螺钉沉孔：Onshape ISO公制间隙孔Close配合默认尺寸，按孔表完整加工。
6. 新编号独立加工件，原custom10不改；原unused中心M4孔取消，因为正式12.5柱中央是M6。
7. 真基准来自MT-AM1S5三个后肩面102/105/108沿前法向+6mm，不取夹唇小面或镜架外廓。
8. 光学面Y0含柱轴X=Y=0，镜面中心距柱脚50.6mm；本件厚12.7保持原高度链。
9. 厂家圆销孔/长圆槽提供方向定位，不另加无用侧挡。
10. 先在离柱状态按厂家M4沉孔把镜架固定到本件，再用两柱销落柱，外露偏置M4锁紧；反序拆卸。
11. 标准螺钉和销不导出实体；定位销突出量须测量控制，钻尖不作销端止挡。
12. 保留厂家夹唇与理想6mm镜片的闭合态局部交叠例外，实际需松夹就位；未试验全微调行程/强度。

冻结源 SHA256：
43dd9408332c8017c962d40677cbbac0
589fb97f4c20c7da3678ebd38a21bc96

10-C / 原1inch可调镜架真承镜面校正转接件
修订 R3 单位 mm 第一角投影
图号：10-C-R3

材料：316L不锈钢
表面处理：去磁、钝化
孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 1.5:1
A3 420 × 297
打印：实际大小 100%

页次 1 / 3
加工工程图
未注条件见技术说明

原1inch可调镜架真承镜面校正转接件

孔坐标与加工标注

局部基准：单件以正式柱轴与底面交点为原点；X为镜架宽度负向，Y为真实镜片前法向，Z沿柱轴朝镜架。底面全局Z12.5、局部Z0；X负边距10，Y负边距24.5373629。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	0, 8.5, 12.7	(0, 0, -1)	局部Z=12.7，向-Z	1× Ø4.3贯穿12.7；同入口沉孔Ø8.25深4	正式12.5柱的偏置M4×0.7孔；M4×14名义夹8.7、入牙5.3。未使用中心M6。
H02	-5, 0, 0 5, 0, 0	(0, 0, 1)	局部Z=0，向+Z	2× Ø2.01全径深4.2 + 118°尖约0.603865；总钻深约4.803865	柱端双销Ø2×8；4/4插入，各全径孔深4.2。
H03	0, -19.8874, 12.7	(0, 0, -1)	局部Z=12.7，向-Z	1× M4×0.7-6H贯穿12.7；STEP为Ø3.3攻牙底孔	厂家底安装M4沉孔配此螺纹；M4×14通过厂家9夹持后名义入5。
H04	-5, -19.8874, 12.7 5, -19.8874, 12.7	(0, 0, -1)	局部Z=12.7，向-Z	2× Ø2.01全径深4.7 + 118°尖约0.603865；总钻深约5.303865	厂家1圆1槽方向销；Ø2×6，实测板外露1.5（板内4.5），厂家1.9全径孔余0.4。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

10-C / 原1inch可调镜架真承镜面校正转接件
修订 R3　单位 mm　第一角投影
图号：10-C-R3

材料：316L不锈钢
表面处理：去磁、钝化
孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 1.5:1
A3　420 × 297
打印：实际大小 100%

页次 2 / 3
加工工程图
未注条件见技术说明

原1inch可调镜架真承镜面校正转接件

台阶、挡边与刻字

局部基准：单件以正式柱轴与底面交点为原点；X为镜架宽度负向，Y为真实镜片前法向，Z沿柱轴朝镜架。底面全局Z12.5、局部Z0；X负边距10，Y负边距24.5373629。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
F01	矩形板	尺寸X×Y×Z=[20.0, 38.162363, 12.7]；局部起点=[-10.0, -24.537363, 0.0]	尺寸由冻结实体及特征表确定。
E01	实体凹刻 10-C	字框中心局部(-10, -10, 6.35)；高2.2；深0.2；宽6.3	外法向局部(-1, 0, 0)；字右(0, -1, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
OPT	实际镜面与光路基准	厂家三个后承肩面沿镜片前法向+6mm确定光学面。校正后光学面局部Y0，包含柱轴X=Y=0；镜面中心沿柱轴距底面[illegible].6mm。	相对旧脚接口，厂家M4与销孔沿+Y移动0.812637；光学基准不取镜架外表面。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

10-C / 原1inch可调镜架真承镜面校正转接件	材料：316L不锈钢	比例 1.5:1	页次 3 / 3
修订 R3 单位 mm 第一角投影	表面处理：去磁、钝化	A3 420 × 297	加工工程图
图号：10-C-R3	孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	打印：实际大小 100%	未注条件见技术说明

10-C 原1inch可调镜架真承镜面校正转接件

材料：316L不锈钢；去磁、钝化

单件以正式柱轴与底面交点为原点；X为镜架宽度负向，Y为真实镜片前法向，Z沿柱轴朝镜架。底面全局Z12.5、局部Z0；X负边距10，Y负边距24.5373629。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

H01 1× Ø4.3贯穿12.7；同入口沉孔Ø8.25深4；入口 局部Z=12.7，向-Z；局部XYZ 0.0；8.5；12.7

H02 2× Ø2.01全径深4.2 + 118°尖约0.603865；总钻深约4.803865；入口 局部Z=0，向+Z；局部XYZ -5.0；0.0；0.0；5.0；0.0；0.0

H03 1× M4×0.7-6H贯穿12.7；STEP为Ø3.3攻牙底孔；入口 局部Z=12.7，向-Z；局部XYZ 0.0；-19.887362902254946；12.7

H04 2× Ø2.01全径深4.7 + 118°尖约0.603865；总钻深约5.303865；入口 局部Z=12.7，向-Z；局部XYZ -5.0；-19.887362902254946；12.7；5.0；-19.887362902254946；12.7

右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y