

# 固定半英寸PBS上板（删指定挡）




右视图 Y / Z

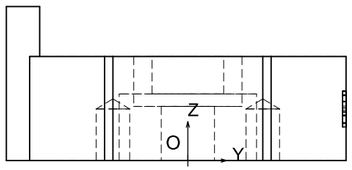


主视图 X / Z

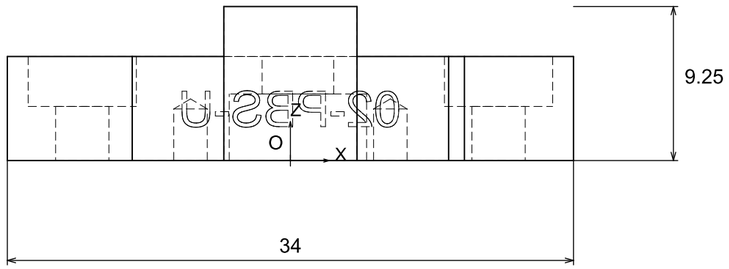


俯视图 X / Y

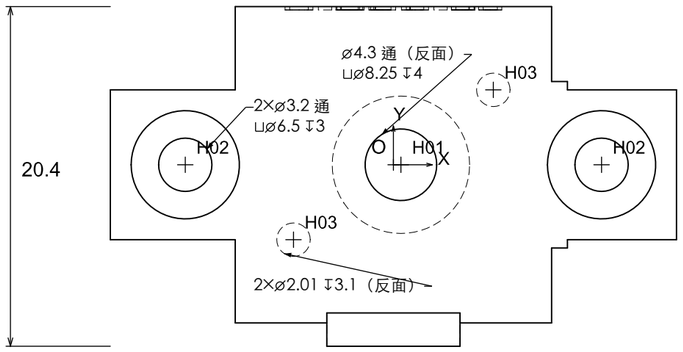


## 加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓10.9mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 商业架M4沉孔从主底面加工，M3沉孔从顶面加工。
5. 仅保留-Y小定位挡；+X支承基底保留，不加原已删除的高挡。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高37.5；本图局部Z0对应世界Z=43.5。
9. 商业固定M4×7名义旋入4.75、深5.5余0.75；M4×8会入5.75超深，不得直接替换。

冻结源 SHA256：
6a13e4bcf3fc92a7e3d0f9f6346f0179
66a31af678a33b1b463db1785162e3b3

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02-PBS-U / 固定半英寸PBS上板（删指定挡）<br>修订 M1　单位 mm　第一角投影<br>图号：02-PBS-U-M1 | 材料：316L不锈钢<br>表面处理：去磁及钝化处理<br>孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明 | 比例 3:1<br>A3　420 × 297<br>打印：实际大小 100% | 页次 1 / 3<br>加工工程图<br>未注条件见技术说明 |

# 固定半英寸PBS上板（删指定挡）



局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓10.9mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

| 编号 | 孔轴坐标 X, Y, Z (mm) | 入孔轴向 | 入口面 / 基准 | 加工标注 | 补充说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | 0.45, 0, 0 | (0, 0, 1) | 入口局部Z=0；向+Z | 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工） | |
| H02 | -12.5, 0, 6.25<br>12.5, 0, 6.25 | (0, 0, -1) | 入口局部Z=6.25；向-Z | 2× Ø3.2 通孔；同轴沉孔 Ø6.5 深3（从本行入口加工） | |
| H03 | -6, -4.5, 0<br>6, 4.5, 0 | (0, 0, 1) | 入口局部Z=0；向+Z | 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深3.1；118°钻尖另计，不得贯穿 | 标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。 |

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02-PBS-U / 固定半英寸PBS上板（删指定挡）<br>修订 M1　单位 mm　第一角投影<br>图号：02-PBS-U-M1 | 材料：316L不锈钢<br>表面处理：去磁及钝化处理<br>孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明 | 比例 3:1<br>A3　420 × 297<br>打印：实际大小 100% | 页次 2 / 3<br>加工工程图<br>未注条件见技术说明 |

# 固定半英寸PBS上板（删指定挡）

台阶、挡边与刻字

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓10.9mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。


| 编号 | 加工部位 | 尺寸 / 操作 | 说明 |
|---|---|---|---|
| B01 | 外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次） | 局部起点(-9.5,-9.5,0)；X×Y×Z=19×19×6.25 | |
| B02 | 外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次） | 局部起点(-17,-4.5,0)；X×Y×Z=34×9×6.25 | |
| B03 | 外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次） | 局部起点(8.45,-5,0)；X×Y×Z=2×10×6.25 | |
| B04 | 外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次） | 局部起点(-4,-10.9,0)；X×Y×Z=8×3.5×6.25 | |
| S01 | 保留唯一-Y小定位挡；+X高挡已删除 | 局部起点(-4,-10.9,6.25)；X×Y×Z=8×2×3 | |
| ENG | 实体凹刻 02-PBS-U | 字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 2.0；4.2 | 加工面 字框中心(0,9.5,3.1)；阅读方向(-1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。 |

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。


| | | | |
|---|---|---|---|
| 02-PBS-U / 固定半英寸PBS上板（删指定挡）<br>修订 M1　单位 mm　第一角投影<br>图号：02-PBS-U-M1 | 材料：316L不锈钢<br>表面处理：去磁及钝化处理<br>孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明 | 比例 3:1<br>A3　420 × 297<br>打印：实际大小 100% | 页次 3 / 3<br>加工工程图<br>未注条件见技术说明 |

02-PBS-U 固定半英寸PBS上板（删指定挡）
材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理
以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓10.9mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。
H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 0.45；0.0；0.0
H02 2× Ø3.2 通孔；同轴沉孔 Ø6.5 深3（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=6.25；向-Z；局部XYZ -12.5；0.0；6.25；12.5；0.0；6.25
H03 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深3.1；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ -6.0；-4.5；0.0；6.0；4.5；0.0

右视图 Y / Z



主视图 X / Z




俯视图 X / Y

