

308向Y短横板

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号


右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y

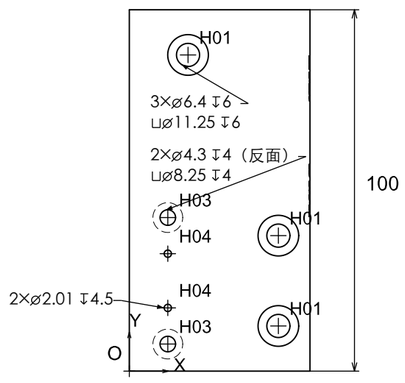

加工基准与说明

局部原点为50×100板左下角与底面交点；A底面Z0，B左长边X0，C短边Y0。X沿50短边，Y沿100长边，Z向上。图纸全部孔坐标从该实体角点计，不从光学中心计。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 本图仅定制加工件；商用器件、万能柱与标准螺钉不出加工图。
5. 螺钉沉孔：Onshape ISO公制间隙孔Close配合默认尺寸，按孔表完整加工。
6. 308 nm G58为用户批准的可修正试制假设，激光器绝对足孔位置仍需实测。
7. 底/竖板先在桌外用2×M4×16及2×Ø2×8组装；销埋入量另测。

冻结源 SHA256：
0d6c81510dcae922560d559e891954e4
a1389af1c931380ea519b8f326104420

28-BY3 / 308向Y短横板 修订 R3　单位 mm　第一角投影 图号：28-BY3-R3	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1.5385 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

308向Y短横板

局部基准：局部原点为50×100板左下角与底面交点；A底面Z0，B左长边X0，C短边Y0。X沿50短边，Y沿100长边，Z向上。图纸全部孔坐标从该实体角点计，不从光学中心计。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	41.25, 12.5, 10 41.25, 37.5, 10 16.25, 87.5, 10	(0, 0, -1)	局部Z=10，向-Z	3× Ø6.4贯穿10；同入口沉孔Ø11.25深6	主板三点非共线夹紧；M6×12，夹4、名义旋入8；主板有效牙须复核
H03	10.65, 7.5, 0 10.65, 42.5, 0	(0, 0, 1)	局部Z=0，向+Z	2× Ø4.3贯穿10；同入口沉孔Ø8.25深4	从底面锁竖板，必须离桌操作；2×M4×16，夹6、名义入牙10
H04	10.65, 17.5, 10 10.65, 32.5, 10	(0, 0, -1)	局部Z=10，向-Z	2× Ø2.01全径深4.5 + 118°尖约0.603865；总钻深约5.103865	Ø2×8定位销；名义埋入4、上露4，须测突出量

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

28-BY3 / 308向Y短横板 修订 R3　单位 mm　第一角投影 图号：28-BY3-R3	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1.5385 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

308向Y短横板

台阶、挡边与刻字

局部基准：局部原点为50×100板左下角与底面交点；A底面Z0，B左长边X0，C短边Y0。X沿50短边，Y沿100长边，Z向上。图纸全部孔坐标从该实体角点计，不从光学中心计。


坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
F01	矩形板	尺寸X×Y×Z=[50.0, 100.0, 10.0]；局部起点=[0.0, 0.0, 0.0]	尺寸由冻结实体及特征表确定。
E01	实体凹刻 28-BY3 R3	字框中心局部(50, 50, 6)；高2.2；深0.2；宽14.485282	外法向局部(1, 0, 0)；字右(0, 1, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E02	实体凹刻 PROTO g58	字框中心局部(50, 81, 6)；高2.2；深0.2；宽12.565055	外法向局部(1, 0, 0)；字右(0, 1, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
OPT	实际镜面与光路基准	总装世界上镜反射面圆心(0,4.5,135)；下镜反射面圆心(0,4.5,O)，O=50/62.5/75/87.5。方向−X→−Z→+Y。	后承面加1inch镜厚6mm；俯视可见背面圆心不作反射基准。镜片镀膜另选。


未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

28-BY3 / 308向Y短横板 修订 R3　单位 mm　第一角投影 图号：28-BY3-R3	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1.5385 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明


右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y



28-BY3 308向Y短横板

材料：316L不锈钢；去磁、钝化

局部原点为50×100板左下角与底面交点；A底面Z0，B左长边X0，C短边Y0。X沿50短边，Y沿100长边，Z向上。图纸全部孔坐标从该实体角点计，不从光学中心计。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

H01 3× Ø6.4贯穿10；同入口沉孔Ø11.25深6；入口 局部Z=10，向-Z；局部XYZ 41.25；12.5；10.0；41.25；37.5；10.0；16.25；87.5；10.0

H03 2× Ø4.3贯穿10；同入口沉孔Ø8.25深4；入口 局部Z=0，向+Z；局部XYZ 10.649999999999999；7.5；0.0；10.649999999999999；42.5；0.0

H04 2× Ø2.01全径深4.5 + 118°尖约0.603865；总钻深约5.103865；入口 局部Z=10，向-Z；局部XYZ 10.649999999999999；17.5；10.0；10.649999999999999；32.5；10.0