

二英寸可调反射镜单柱转接块

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号


右视图 Y / Z



主视图 X / Z

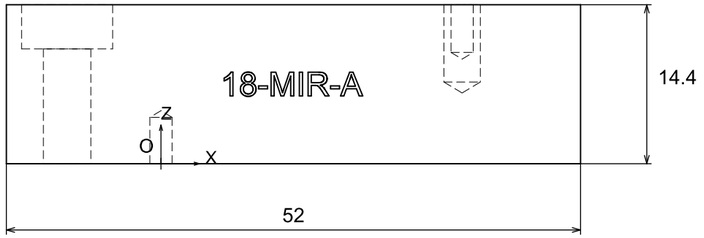

俯视图 X / Y

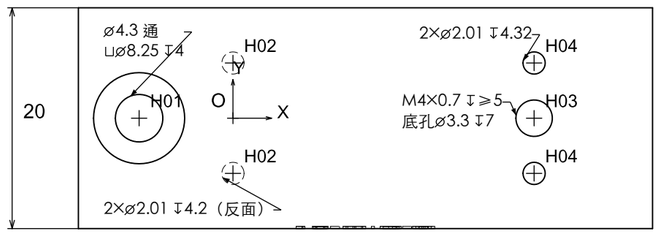

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 商业M4为本件盲牙，配原厂镜架沉孔。
5. 12 mm镜片按承镜后肩定位时，反射面距柱轴名义偏差0.4 mm；依≤0.5 mm允许值保留转接件。装配CAD镜片为X=0名义参考位置。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高12.5；本图局部Z0对应世界Z=12.5。
9. 商业M4×12旋入5，直钻深7。
10. 柱固定建议M4×16；名义旋入5.6，距8深直段孔底2.4；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
a2068ee356bb1496c28eb70e9811c9fb
d03383023e7e220f49d152f0448bfcfb

18-MIR-A / 二英寸可调反射镜单柱转接块 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：18-MIR-A-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

二英寸可调反射镜单柱转接块

孔坐标与加工标注

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-8.5, 0, 14.4	(0, 0, -1)	入口局部Z=14.4；向-Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	0, -5, 0 0, 5, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。
H03	27.2738, 0, 14.4	(0, 0, -1)	入口局部Z=14.4；向-Z	1× M4×0.7；完整有效牙深≥5；底孔Ø3.3有效圆柱深7；118°钻尖另计	使用底锥丝锥或螺纹铣达到所列完整有效牙深；不能把底孔圆柱深度全部算作有效牙深。；螺纹等级仍待确认，三维仅表达螺纹底孔。
H04	27.2738, -5, 14.4 27.2738, 5, 14.4	(0, 0, -1)	入口局部Z=14.4；向-Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.32；118°钻尖另计，不得贯穿	标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

18-MIR-A / 二英寸可调反射镜单柱转接块 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：18-MIR-A-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

二英寸可调反射镜单柱转接块

台阶、挡边与刻字

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	单一矩形转接块	局部起点(-14,-10,0)；X×Y×Z=52×20×14.4	
ENG	实体凹刻 18-MIR-A	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 6.1；8.3	加工面 字框中心(12,-10,7.2)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,-1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

18-MIR-A / 二英寸可调反射镜单柱转接块 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：18-MIR-A-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

18-MIR-A 二英寸可调反射镜单柱转接块

材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。


H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=14.4；向-Z；局部XYZ -8.5；0.0；14.4

H02 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 0.0；-5.0；0.0；0.0；5.0；0.0


H03 1× M4×0.7；完整有效牙深≥5；底孔Ø3.3有效圆柱深7；118°钻尖另计；入口 入口局部Z=14.4；向-Z；局部XYZ 27.273759005；0.0；14.4

H04 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.32；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=14.4；向-Z；局部XYZ 27.273759005；-5.0；14.4；27.273759005；5.0；14.4

右视图 Y / Z



主视图 X / Z

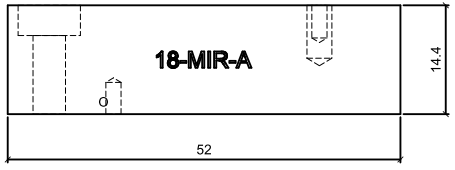

俯视图 X / Y

