

固定半英寸PBS下板


右视图 Y / Z



主视图 X / Z

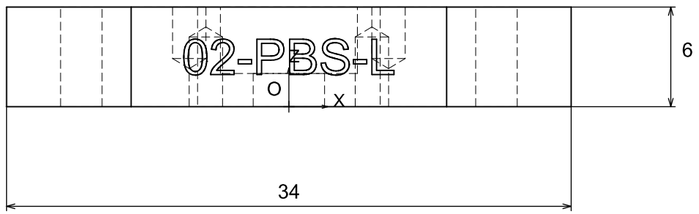

俯视图 X / Y

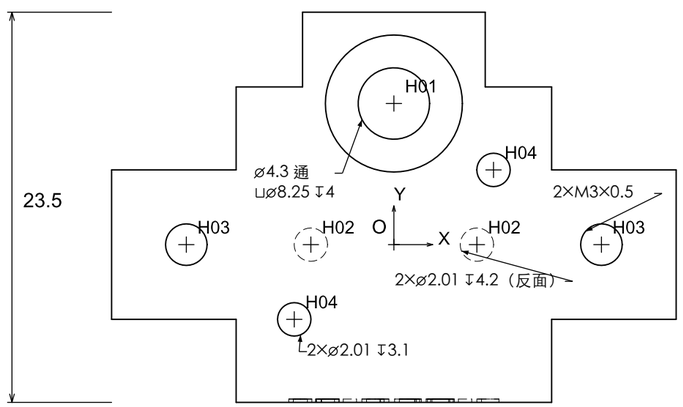

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓9.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. M3孔为通孔攻牙，非普通Ø2.5通孔。
5. 层间销孔从顶面加工；柱销孔从主底面加工。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高37.5；本图局部Z0对应世界Z=37.5。
9. 柱固定建议M4×8；名义旋入6，距8深直段孔底2；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
1f4972e5cf6b663a33563a3ff0215c4a
3a9ac19587b1d4836b9d9f33e4216ab9

02-PBS-L / 固定半英寸PBS下板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：02-PBS-L-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

固定半英寸PBS下板

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓9.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	0, 8.5, 6	(0, 0, -1)	入口局部Z=6；向-Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	-5, 0, 0 5, 0, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。
H03	-12.5, 0, 6 12.5, 0, 6	(0, 0, -1)	入口局部Z=6；向-Z	2× M3×0.5 通孔攻牙；贯穿6	
H04	-6, -4.5, 6 6, 4.5, 6	(0, 0, -1)	入口局部Z=6；向-Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深3.1；118°钻尖另计，不得贯穿	标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

02-PBS-L / 固定半英寸PBS下板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：02-PBS-L-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

固定半英寸PBS下板

台阶、挡边与刻字

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓9.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。


编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-9.5,-9.5,0)；X×Y×Z=19×19×6	
B02	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-17,-4.5,0)；X×Y×Z=34×9×6	
B03	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-5.5,0,0)；X×Y×Z=11×14×6	
ENG	实体凹刻 02-PBS-L	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 1.9；4.1	加工面 字框中心(0,-9.5,3)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,-1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。


02-PBS-L / 固定半英寸PBS下板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：02-PBS-L-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

02-PBS-L 固定半英寸PBS下板
材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理
以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓9.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。
H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4 (从本行入口加工) ；入口 入口局部Z=6；向-Z；局部XYZ 0.0；8.5；6.0
H02 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ -5.0；0.0；0.0；5.0；0.0；0.0
H03 2× M3×0.5 通孔攻牙；贯穿6；入口 入口局部Z=6；向-Z；局部XYZ -12.5；0.0；6.0；12.5；0.0；6.0
H04 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深3.1；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=6；向-Z；局部XYZ -6.0；-4.5；6.0；6.0；4.5；6.0

右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y

