

公制直向多档一体爬架_25-S3


右视图 Y / Z

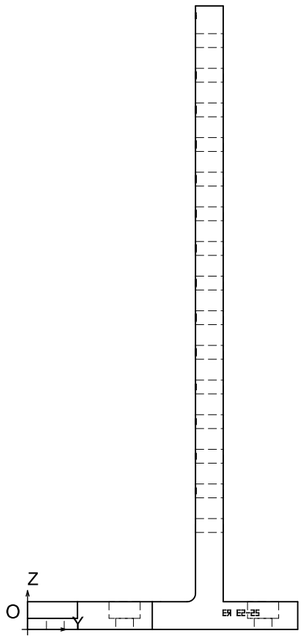

主视图 X / Z

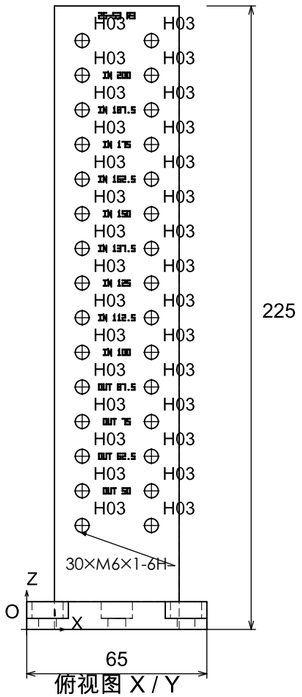

俯视图 X / Y

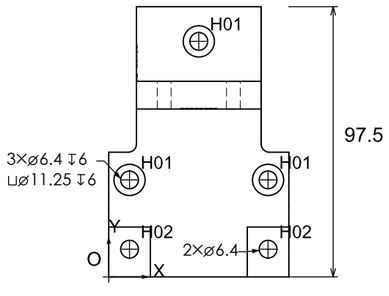

加工基准与说明

原点为全底板最前X=10、左外缘Y=-32.5、底面Z=0；图纸局部X沿世界+Y，局部Y沿世界−X，局部Z向上。光路名义X=Y=0。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 本图仅定制加工件；商用器件、万能柱与标准螺钉不出加工图。
5. 螺钉沉孔：Onshape ISO公制间隙孔Close配合默认尺寸，按孔表完整加工。
6. 一整块连续材料加工，底壁不拼装、不焊接。
7. 材料316L，加工后去磁、钝化。
8. M6孔用Ø5攻丝底孔表达，牙型未在STEP中细建；制造M6×1-6H。
9. 底部M6为Onshape公制Close默认Ø6.4/Ø11.25深6。
10. 标字真实高2.2、刻深0.2；数字为光高，并非安装孔Z坐标。
11. 主板先夹紧L，再装裸横柱，再装新10-C与镜架；拆卸反序。
12. 22阶梯销定位螺纹孔网格为辅助定位，实物孔根径、装配微调及夹紧刚度需检查。
13. 光学调整连续行程、手握空间、刚度与实际重复定位未实测。
14. 两镜均使用新10-C；原custom10不属于此正式S3配置。真实后肩+6mm反射面含实际柱轴，无墙孔偏心补偿。
15. H100→75、H100→87.5、H112.5→87.5禁止：实体碰撞。其余33组合支持；H112.5→75由通用同轴孔重新支持。
16. 厂家闭合夹唇与理想6mm镜片的原源交叠仍需松夹就位；不作为已装实物保证。
17. 仅使用相应型号已核验的H/O档位；详细档位矩阵随资料包。
18. 先裸底座锁主板，再裸支架，最后安装镜组。

冻结源 SHA256：
6efaee3d4b687653629eb10f50d07dde
fe0910eba3e5e382418097a6d9a902d0

25-S3 / 公制直向多档一体爬架_25-S3 修订 R3　单位 mm　第一角投影 图号：25-S3-R3	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:2 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明

公制直向多档一体爬架_25-S3

局部基准：原点为全底板最前X=10、左外缘Y=-32.5、底面Z=0；图纸局部X沿世界+Y，局部Y沿世界−X，局部Z向上。光路名义X=Y=0。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	32.5, 85, 10 7.5, 35, 10 57.5, 35, 10	(0, 0, -1)	局部Z=10，向-Z	3× Ø6.4贯穿10；同入口沉孔Ø11.25深6	3×M6×12至主板，夹持4、名义旋入8；全部孔位为25mm整数网格
H02	7.5, 10, 4 57.5, 10, 4	(0, 0, -1)	局部Z=4，向-Z	2× Ø6.4贯穿4	22阶梯销临时定位；不作为精密定位衬套
H03	20, 60.6, 37.5 20, 60.6, 50 20, 60.6, 62.5 20, 60.6, 75 20, 60.6, 87.5 20, 60.6, 100 20, 60.6, 112.5 20, 60.6, 125 20, 60.6, 137.5 20, 60.6, 150 20, 60.6, 162.5 20, 60.6, 175 20, 60.6, 187.5 20, 60.6, 200 20, 60.6, 212.5 45, 60.6, 37.5 45, 60.6, 50 45, 60.6, 62.5 45, 60.6, 75 45, 60.6, 87.5 45, 60.6, 100 45, 60.6, 112.5 45, 60.6, 125 45, 60.6, 137.5 45, 60.6, 150 45, 60.6, 162.5 45, 60.6, 175 45, 60.6, 187.5 45, 60.6, 200 45, 60.6, 212.5	(0, 1, 0)	局部Y=60.6，向+Y	30× M6×1-6H贯穿10；STEP为Ø5攻牙底孔	30通用墙孔：Y±12.5；Z37.5至212.5每12.5。每镜按H±12.5或O±12.5取四孔。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

公制直向多档一体爬架_25-S3

局部基准：原点为全底板最前X=10、左外缘Y=-32.5、底面Z=0；图纸局部X沿世界+Y，局部Y沿世界−X，局部Z向上。光路名义X=Y=0。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
F01	同一整料L型主体	底板尺寸X×Y×Z=[45.0, 97.5, 10.0]；墙板尺寸X×Y×Z=[45.0, 10.0, 215.0]；底板局部起点=[10.0, 0.0, 0.0]；墙板局部起点=[10.0, 87.5, 10.0]	尺寸由冻结实体及特征表确定。
F02	局部安装耳	尺寸X×Y×Z=[65.0, 45.0, 10.0]；局部起点=[0.0, 0.0, 0.0]	与F01并集，同一整料；仅此段拓宽至65
F03	内根部圆角	半径R=3；轴向=[1, 0, 0]；轴上点=[32.5, 57.6, 13.0]；长度=45	尺寸由冻结实体及特征表确定。
F04	安装耳过渡圆角	半径R=3；轴向组=[[0, 0, 1], [0, 0, 1]]；轴上点组=[[7.0, 48.0, 0.0], [58.0, 48.0, 0.0]]；长度=10	尺寸由冻结实体及特征表确定。
F05	对外敞开沉台	尺寸X×Y×Z=[15, 18, 6]；底台Z=4；局部起点组=[[0.0, 0.0, 4.0], [50.0, 0.0, 4.0]]	对外侧和前方敞开；不能读成底板全厚通槽
E01	实体凹刻 25-S3 R3	字框中心局部(32.5, 60.6, 221.5)；高2.2；深0.2；宽13.1	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E02	实体凹刻 25-S3 R3	字框中心局部(10, 77, 6)；高2.2；深0.2；宽13.1	外法向局部(-1, 0, 0)；字右(0, -1, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E03	实体凹刻 OUT 50	字框中心局部(32.5, 60.6, 50)；高2.2；深0.2；宽9.7	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E04	实体凹刻 OUT 62.5	字框中心局部(32.5, 60.6, 62.5)；高2.2；深0.2；宽13.1	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E05	实体凹刻 OUT 75	字框中心局部(32.5, 60.6, 75)；高2.2；深0.2；宽9.7	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E06	实体凹刻 OUT 87.5	字框中心局部(32.5, 60.6, 87.5)；高2.2；深0.2；宽13.1	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E07	实体凹刻 IN 100	字框中心局部(32.5, 60.6, 100)；高2.2；深0.2；宽9.7	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E08	实体凹刻 IN 112.5	字框中心局部(32.5, 60.6, 112.5)；高2.2；深0.2；宽13.1	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E09	实体凹刻 IN 125	字框中心局部(32.5, 60.6, 125)；高2.2；深0.2；宽9.7	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E10	实体凹刻 IN 137.5	字框中心局部(32.5, 60.6, 137.5)；高2.2；深0.2；宽13.1	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E11	实体凹刻 IN 150	字框中心局部(32.5, 60.6, 150)；高2.2；深0.2；宽9.7	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E12	实体凹刻 IN 162.5	字框中心局部(32.5, 60.6, 162.5)；高2.2；深0.2；宽13.1	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E13	实体凹刻 IN 175	字框中心局部(32.5, 60.6, 175)；高2.2；深0.2；宽9.7	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

25-S3 / 公制直向多档一体爬架_25-S3 修订 R3　单位 mm　第一角投影 图号：25-S3-R3	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:2 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明

公制直向多档一体爬架_25-S3


局部基准：原点为全底板最前X=10、左外缘Y=-32.5、底面Z=0；图纸局部X沿世界+Y，局部Y沿世界−X，局部Z向上。光路名义X=Y=0。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
E14	实体凹刻 IN 187.5	字框中心局部(32.5, 60.6, 187.5)；高2.2；深0.2；宽13.1	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E15	实体凹刻 IN 200	字框中心局部(32.5, 60.6, 200)；高2.2；深0.2；宽9.7	外法向局部(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
OPT	实际镜面与光路基准	总装世界上镜反射面圆心(0,0,H)、下镜反射面圆心(0,0,O)；竖直光段连接两前面圆心。H/O选择见本件档位矩阵。	承面加1inch镜厚6mm；俯视可见背面圆心不作反射基准。镜片镀膜另选。


未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

25-S3 / 公制直向多档一体爬架_25-S3 修订 R3　单位 mm　第一角投影 图号：25-S3-R3	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:2 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 4 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明


右视图 Y / Z

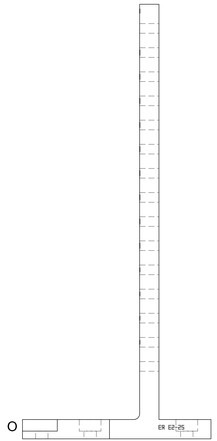

主视图 X / Z

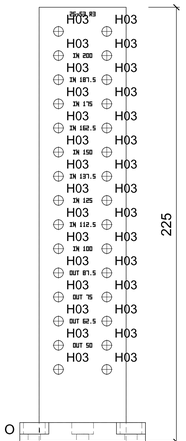

俯视图 X / Y



25-S3 公制直向多档一体爬架_25-S3

材料：316L不锈钢；去磁、钝化

原点为全底板最前X=10、左外缘Y=-32.5、底面Z=0；图纸局部X沿世界+Y，局部Y沿世界−X，局部Z向上。光路名义X=Y=0。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

H01 3× Ø6.4贯穿10；同入口沉孔Ø11.25深6；入口 局部Z=10，向-Z；局部XYZ 32.5；85.0；10.0；7.5；35.0；10.0；57.5；35.0；10.0

H02 2× Ø6.4贯穿4；入口 局部Z=4，向-Z；局部XYZ 7.5；10.0；4.0；57.5；10.0；4.0

H03 30× M6×1-6H贯穿10；STEP为Ø5攻牙底孔；入口 局部Y=60.6，向+Y；局部XYZ 20.0；60.6；37.5；20.0；60.6；50.0；20.0；60.6；62.5；20.0；60.6；75.0；20.0；60.6；87.5；20.0；60.6；100.0；20.0；60.6；112.5；20.0；60.6；125.0；20.0；60.6；137.5；20.0；60.6；150.0；20.0；60.6；162.5；20.0；60.6；175.0；20.0；60.6；187.5；20.0；60.6；200.0；20.0；60.6；212.5；45.0；60.6；37.5；45.0；60.6；50.0；45.0；60.6；62.5；45.0；60.6；75.0；45.0；60.6；87.5；45.0；60.6；100.0；45.0；60.6；112.5；45.0；60.6；125.0；45.0；60.6；137.5；45.0；60.6；150.0；45.0；60.6；162.5；45.0；60.6；175.0；45.0；60.6；187.5；45.0；60.6；200.0；45.0；60.6；212.5