

一英寸透镜转接上板

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号


右视图 Y / Z

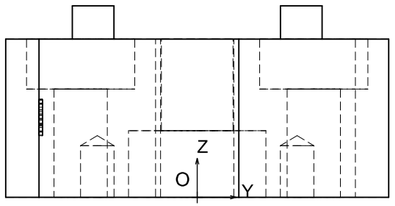

主视图 X / Z

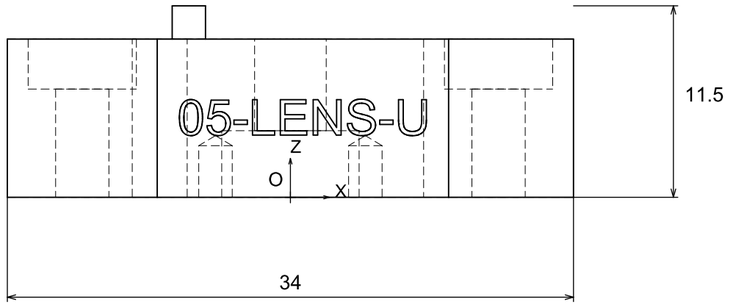

俯视图 X / Y

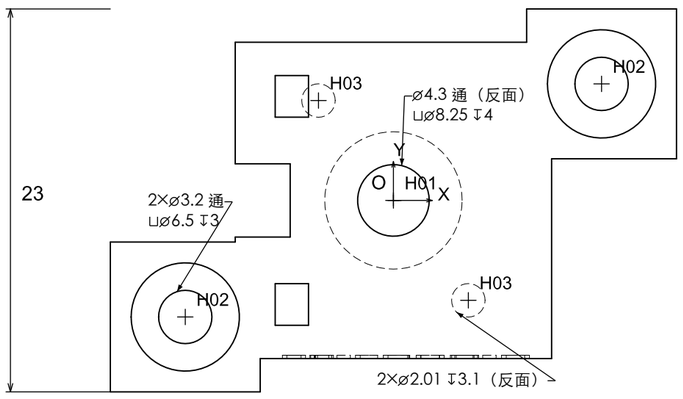

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓11.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 前方宽4.4开放槽供内六角杆通过，不是螺钉头沉孔。
5. 两短挡保留；透镜几何中面经柱心。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高25；本图局部Z0对应世界Z=31。
9. 商业M4×10名义旋入4.5，原厂深5.5、底余1。

冻结源 SHA256：
0e41c6f4b16b4043e32837769dc292bb
014bf3fc7a8b543e75c0e4c7528b15cf

05-LENS-U / 一英寸透镜转接上板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：05-LENS-U-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

一英寸透镜转接上板

孔坐标与加工标注

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓11.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	0, 0, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	-12.5, -7, 9.5 12.5, 7, 9.5	(0, 0, -1)	入口局部Z=9.5；向-Z	2× Ø3.2 通孔；同轴沉孔 Ø6.5 深3（从本行入口加工）	
H03	4.5, -6, 0 -4.5, 6, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深3.1；118°钻尖另计，不得贯穿	标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

05-LENS-U / 一英寸透镜转接上板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：05-LENS-U-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

一英寸透镜转接上板

台阶、挡边与刻字

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓11.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-9.5,-9.5,0)；X×Y×Z=19×19×9.5	
B02	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-17,-11.5,0)；X×Y×Z=9×9×9.5	
B03	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(8,2.5,0)；X×Y×Z=9×9×9.5	
R01	前缘开放钥匙直槽；不是额外沉孔	局部X由前侧开通至-6.2；Y=-2.2至2.2；贯穿主厚9.5	
S-7.5	两短X定位挡	局部起点(-7.1,-7.5,9.5)；X×Y×Z=2×2.5×2	
S5	两短X定位挡	局部起点(-7.1,5,9.5)；X×Y×Z=2×2.5×2	
ENG	实体凹刻 05-LENS-U	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 3.7；5.9	加工面 字框中心(0.75,-9.5,4.8)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,-1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

05-LENS-U / 一英寸透镜转接上板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：05-LENS-U-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

05-LENS-U 一英寸透镜转接上板

材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓11.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。


未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 0.0；0.0；0.0


H02 2× Ø3.2 通孔；同轴沉孔 Ø6.5 深3（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=9.5；向-Z；局部XYZ -12.5；-7.0；9.5；12.5；7.0；9.5

H03 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深3.1；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 4.5；-6.0；0.0；-4.5；6.0；0.0

右视图 Y / Z



主视图 X / Z

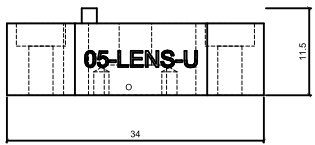

俯视图 X / Y

