

物镜万能柱一体转接座

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号


右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y

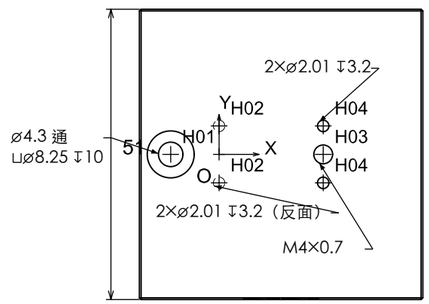

加工基准与说明

O为柱轴与转接座底面交点；X为光轴方向，物镜朝-X；安装M4轴X=18.2874，物镜后端机械面中心X=0。

按用户现行规则不标通用公差及粗糙度。Ø2.01销孔为名义值，需实配核验。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 正式公制H25万能柱及原厂镜架不改。
5. 标准螺钉/销不另建详细加工实体。
6. 安装定位取最终镜架零俯仰/零偏摆位；改变镜架姿态后须复核真实后端面。

冻结源 SHA256：
65a360e33dba2c9ee3511908e08f1586
15d62b723520f55c353184c3ecf60f21

30-OBJ-M / 物镜万能柱一体转接座 修订 R2　单位 mm　第一角投影 图号：30-OBJ-M-R2	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明

物镜万能柱一体转接座

局部基准：O为柱轴与转接座底面交点；X为光轴方向，物镜朝-X；安装M4轴X=18.2874，物镜后端机械面中心X=0。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-8.5, 0, 12.1	(0, 0, -1)	顶面Z12.1，向-Z	1×Ø4.3通；同轴圆柱沉孔Ø8.25深10；座面Z2.1。	M4×8穿2.1、旋入正式柱偏置牙孔5.9；柱孔有效8。先锁柱，再装镜架。
H02	0, -5, 0 0, 5, 0	(0, 0, 1)	底面Z0，向+Z	2×Ø2.01盲销孔，有效圆柱深3.2；118°钻尖另计0.61。	Ø2×6插3.2露2.8；正式柱销孔深4.2。
H03	18.2874, 0, 12.1	(0, 0, -1)	顶面Z12.1，向-Z	1×M4×0.7通牙，全厚12.1；底孔Ø3.3通。	原厂薄头M4×14穿镜架9、旋入5；底余7.1。
H04	18.2874, -5, 12.1 18.2874, 5, 12.1	(0, 0, -1)	顶面Z12.1，向-Z	2×Ø2.01盲销孔，有效圆柱深3.2；118°钻尖另计0.61。	Ø2×5插3.2露1.8，配原厂+Y圆孔/-Y短槽，深1.9。

按用户现行规则不标通用公差及粗糙度。Ø2.01销孔为名义值，需实配核验。

30-OBJ-M / 物镜万能柱一体转接座 修订 R2　单位 mm　第一角投影 图号：30-OBJ-M-R2	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明

物镜万能柱一体转接座

局部基准：O为柱轴与转接座底面交点；X为光轴方向，物镜朝-X；安装M4轴X=18.2874，物镜后端机械面中心X=0。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。


编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	一体主体	49.7874×51×12.1；X=-14..35.7874，Y=±25.5。	安装孔偏置A=18.2874=L(98.2874)−80。两端面不以物镜安装肩面替代。
C01	外棱倒角	12条外棱C0.3，实体包含。	孔口去毛刺，保持配合尺寸。
E01	刻字30-OBJ-M	字高2.2、深0.2；中心(10.8937,-25.5,6.05)，阅读+X、字顶+Z。	实际刻入侧面。
ENG	实体凹刻 30-OBJ-M	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 见STEP	加工面 见STEP；字形与位置以配套冻结STEP为准。

按用户现行规则不标通用公差及粗糙度。Ø2.01销孔为名义值，需实配核验。


30-OBJ-M / 物镜万能柱一体转接座 修订 R2　单位 mm　第一角投影 图号：30-OBJ-M-R2	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明

物镜万能柱一体转接座

底视图：沿+Z观察；纸面横向+X、纵向-Y

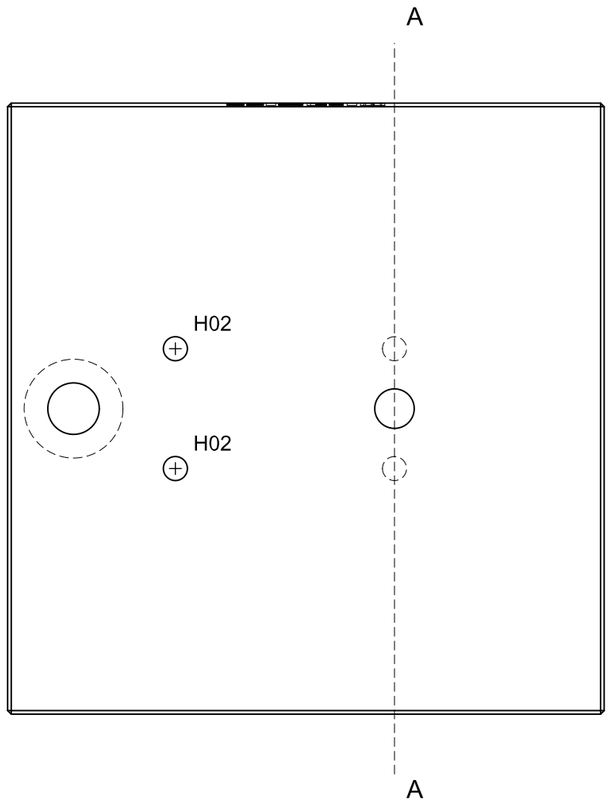

A-A剖面：X=18.2874；横向+Y、纵向+Z

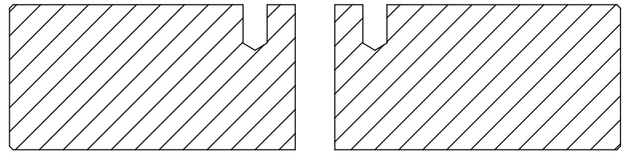

底视与剖面均由同一冻结STEP提取；A-A经过镜架安装轴。

本页补充底面入口和实际剖面；全部孔坐标、螺纹、有效深度及钻尖见第2页。

H01从顶面加工Ø8.25圆柱沉孔，深10；剩余夹紧厚2.1。

H02柱向销孔从底面入刀；H04镜架销孔从顶面入刀。均为有效圆柱深3.2，118°钻尖另计0.61。

H03为M4×0.7通牙；STEP显示Ø3.3底孔，不以几何圆柱代替成品牙型。

先以M4×8固定本件到柱，再装镜架及原厂薄头M4×14。

按用户现行规则不标通用公差及粗糙度。Ø2.01销孔为名义值，需实配核验。

30-OBJ-M / 物镜万能柱一体转接座 修订 R2　单位 mm　第一角投影 图号：30-OBJ-M-R2	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 2:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 4 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明

30-OBJ-M 物镜万能柱一体转接座

材料：316L不锈钢；去磁、钝化

O为柱轴与转接座底面交点；X为光轴方向，物镜朝-X；安装M4轴X=18.2874，物镜后端机械面中心X=0。

按用户现行规则不标通用公差及粗糙度。Ø2.01销孔为名义值，需实配核验。


H01 1×Ø4.3通；同轴圆柱沉孔Ø8.25深10；座面Z2.1。；入口 顶面Z12.1，向-Z；局部XYZ -8.5；0；12.1

H02 2×Ø2.01盲销孔，有效圆柱深3.2；118°钻尖另计0.61。；入口 底面Z0，向+Z；局部XYZ 0；-5；0；0；5；0


H03 1×M4×0.7通牙，全厚12.1；底孔Ø3.3通。；入口 顶面Z12.1，向-Z；局部XYZ 18.287362902251004；0；12.1

H04 2×Ø2.01盲销孔，有效圆柱深3.2；118°钻尖另计0.61。；入口 顶面Z12.1，向-Z；局部XYZ 18.287362902251004；-5；12.1；18.287362902251004；5；12.1

右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y

