

光阱双柱桥座

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号


右视图 Y / Z

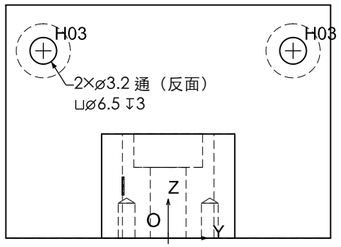

主视图 X / Z

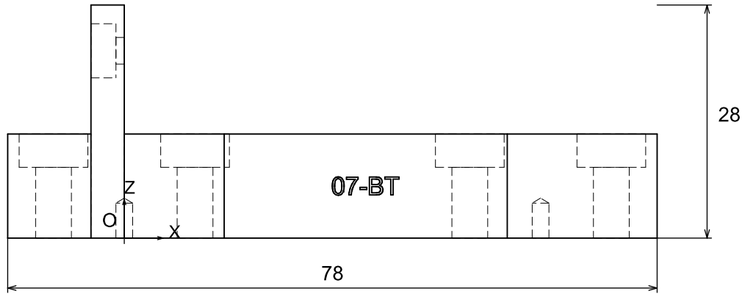

俯视图 X / Y

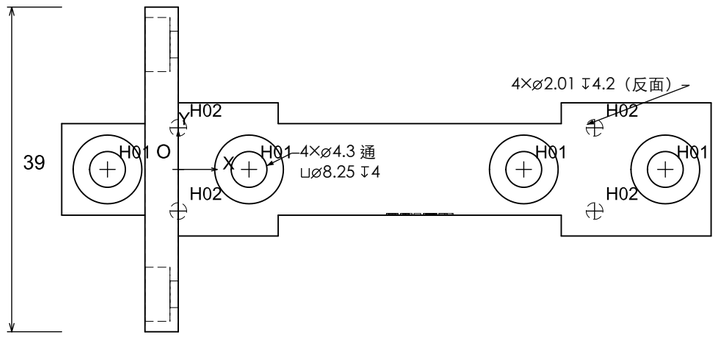

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓19.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 前立壁M3沉孔从X=-4朝+X加工；侧壁厚4。
5. 4个柱端M4孔均按图保留，包括备用位置。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高25；本图局部Z0对应世界Z=25。
9. 前墙选M3×4名义旋入3、深5余2；旧M3×6会入5无底余，不直接沿用。
10. 柱固定建议M4×14；名义旋入5.5，距8深直段孔底2.5；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
54e2be3b84e7923ddefe54f7af159c79
25e62b9fbda9c4cb3e86a01c6282b35c

07-BT / 光阱双柱桥座 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：07-BT-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

光阱双柱桥座

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓19.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-8.5, 0, 12.5 8.5, 0, 12.5 41.5, 0, 12.5 58.5, 0, 12.5	(0, 0, -1)	入口局部Z=12.5；向-Z	4× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	0, -5, 0 0, 5, 0 50, -5, 0 50, 5, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	4× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	
H03	-4, -15, 22.5 -4, 15, 22.5	(1, 0, 0)	入口局部X=-4；向+X	2× Ø3.2 通孔；同轴沉孔 Ø6.5 深3（从本行入口加工）	

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

07-BT / 光阱双柱桥座 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：07-BT-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

光阱双柱桥座

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓19.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-4,-8,0)；X×Y×Z=16×16×12.5	
B02	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-14,-5.5,0)；X×Y×Z=10×11×12.5	
B03	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(12,-5.5,0)；X×Y×Z=34×11×12.5	
B04	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(46,-8,0)；X×Y×Z=18×16×12.5	
B05	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-4,-19.5,0)；X×Y×Z=4×39×12.5	
B06	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-4,-19.5,12.5)；X×Y×Z=4×39×15.5	
ENG	实体凹刻 07-BT	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 5.15；7.35	加工面 字框中心(29,-5.5,6.25)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,-1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

07-BT / 光阱双柱桥座 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：07-BT-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

07-BT 光阱双柱桥座

材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓14mm，距最小Y侧外廓19.5mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。


未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

H01 4× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=12.5；向-Z；局部XYZ -8.5；0.0；12.5；8.5；0.0；12.5；41.5；0.0；12.5；58.5；0.0；12.5


H02 4× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 0.0；-5.0；0.0；0.0；5.0；0.0；50.0；-5.0；0.0；50.0；5.0；0.0

H03 2× Ø3.2 通孔；同轴沉孔 Ø6.5 深3（从本行入口加工）；入口 入口局部X=-4；向+X；局部XYZ -4.0；-15.0；22.5；-4.0；15.0；22.5

右视图 Y / Z



主视图 X / Z

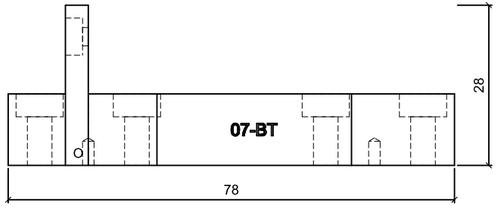

俯视图 X / Y

