

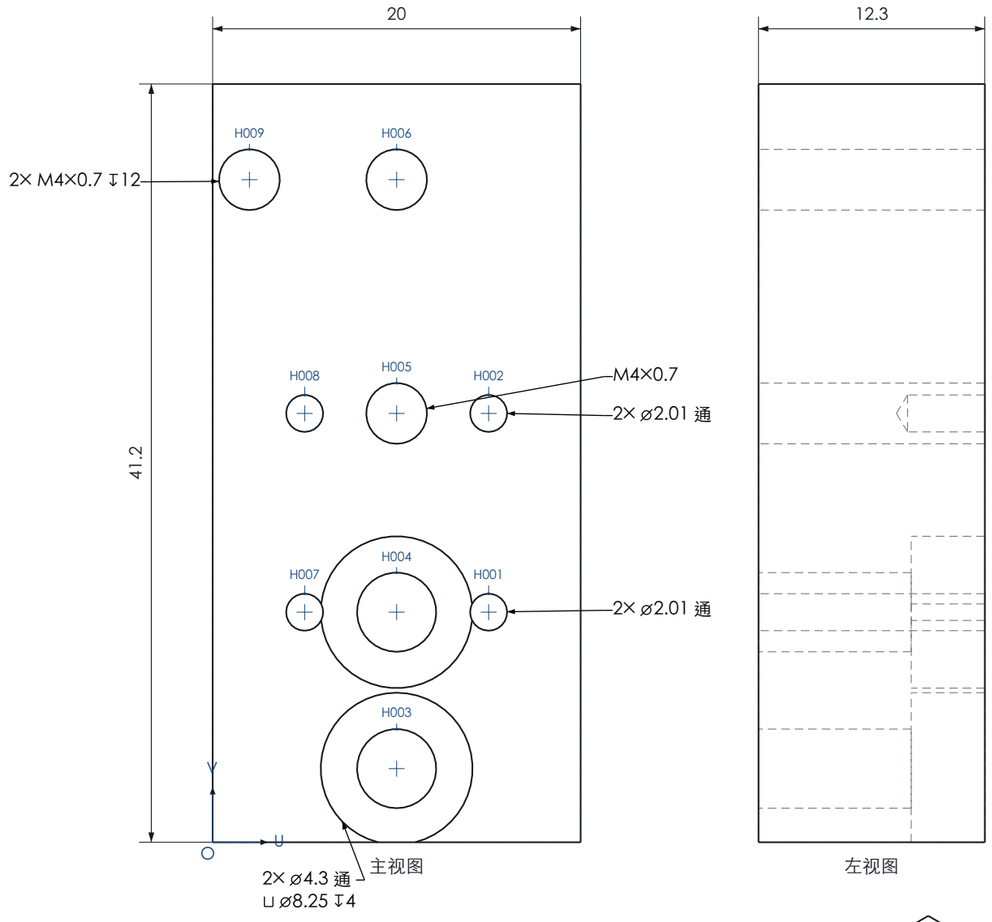


主视图

左视图

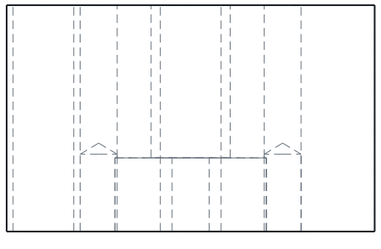

俯视图

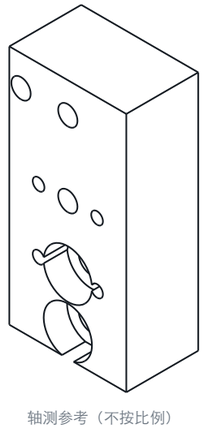

轴测参考（不按比例）

孔组概要

G1　2 处　Ø2.01, W0~12.3

G2　2 处　Ø2.01, W0~4.2

G3　2 处　Ø4.3, W4~12.3 / Ø8.25, W0~4

G4　3 处　Ø3.3, W0~12.3

读图及审核事项

1. O为主视图包络左下角；U向右、V向上；W=0为主视侧最外平面，W正向深入零件。

2. 孔径、孔段与坐标取自公制STEP；螺纹规格沿用已核对的Onshape孔特征，等级待确认。

3. 本体名义厚度 12.3 mm；配合公制支撑后对应套件名义光高62.5 mm。

4. 保留已有孔组、镜面位置校正及相交孔口；孔段按实际边界标出。

源文件：11_可调反射镜_0.5inch_电动.step

可调反射镜 0.5inch 电动 / M1 公制

三视图 · 外形尺寸 · 孔位索引

图号 GLMK-11 / REV M1 / 2026-10-06

单位：mm　投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：3:1

A3　420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图

螺纹等级待确认

孔位与圆柱孔段

编号	U	V	圆柱段：直径及 W 起止	螺纹 / 工艺标注
H001	15	12.5	Ø2.01: W0~12.3	光孔
H002	15	23.3	Ø2.01: W0~4.2	光孔
H003	10	4	Ø8.25: W0~4; Ø4.3: W4~12.3	光孔
H004	10	12.5	Ø8.25: W0~4; Ø4.3: W4~12.3	光孔
H005	10	23.3	Ø3.3: W0~12.3	M4×0.70 ；等级待确认
H006	10	36	Ø3.3: W0~12.3	M4×0.70 螺深12（W=0起）；等级待确认
H007	5	12.5	Ø2.01: W0~12.3	光孔
H008	5	23.3	Ø2.01: W0~4.2	光孔
H009	2	36	Ø3.3: W0~12.3	M4×0.70 螺深12（W=0起）；等级待确认

W 为沿孔轴从主视侧参考面测得的深度坐标；“起止区间”不是默认钻孔深度。下表补列原模型锥底。

锥底（模型值）

孔号	顶角	W 起止
H002	118°	4.2~4.8039
H008	118°	4.2~4.8039

结构轮廓线段坐标

(U,V) 为主视坐标；W 指明该线段所在的轴向平面。相同端点数值不另设公差。

序	U,V 端点	W
1	(0,0) → (0,41.2)	0
2	(0,0) → (8.9922,0)	0
3	(0,0) → (0,41.2)	12.3
4	(0,0) → (20,0)	12.3
5	(0,41.2) → (20,41.2)	0
6	(0,41.2) → (20,41.2)	12.3
7	(8.9922,0) → (11.0078,0)	4
8	(11.0078,0) → (20,0)	0
9	(20,0) → (20,41.2)	0
10	(20,0) → (20,41.2)	12.3

螺纹等级：待确认。

M1：配合12.5mm级差公制支撑柱；安装面、完整孔段及螺纹见本页。

来源：Onshape 固定版本 6e749963ebef18952db7c82d；完整STEP校验码见孔表JSON。

可调反射镜 0.5inch 电动 / M1 公制

孔表 · 轴向孔段 · 结构轮廓

图号 GLMK-11 / REV M1 / 2026-10-06

单位：mm 投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：表格尺寸

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图

螺纹等级待确认