

带罩隔离器双柱桥板


右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y

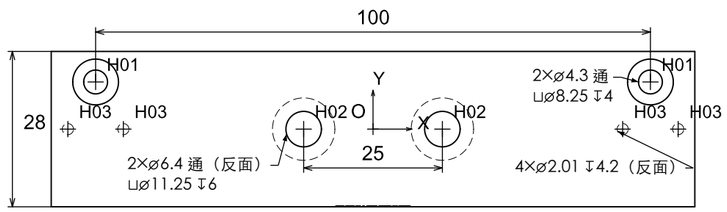

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓58mm，距最小Y侧外廓14mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 顶面2个M4沉孔、主底面2个M6沉孔，方向相反。
5. 本件无螺纹孔；100mm双柱间距不等于两M6孔25mm间距。
6. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
7. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
8. 配套名义柱高12.5；本图局部Z0对应世界Z=12.5。
9. 罩端M6×16名义旋入6.8，原厂深8，底余1.2。
10. 柱固定建议M4×16；名义旋入4.8，距8深直段孔底3.2；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
79dbacf41a7d7db905cc520f65f067d0
e8e1c6e931094e11ed1a80fa9fe68603

09-ISO-C / 带罩隔离器双柱桥板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：09-ISO-C-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

带罩隔离器双柱桥板

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓58mm，距最小Y侧外廓14mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-50, 8.5, 15.2 50, 8.5, 15.2	(0, 0, -1)	入口局部Z=15.2；向-Z	2× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	-12.5, 0, 0 12.5, 0, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø6.4 通孔；同轴沉孔 Ø11.25 深6（从本行入口加工）	
H03	-55, 0, 0 -45, 0, 0 45, 0, 0 55, 0, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	4× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

09-ISO-C / 带罩隔离器双柱桥板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：09-ISO-C-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

带罩隔离器双柱桥板

台阶、挡边与刻字

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓58mm，距最小Y侧外廓14mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
F01	单一矩形桥板；无附加台阶或挡块	局部起点(-58,-14,0)；X×Y×Z=116×28×15.2	
ENG	实体凹刻 09-ISO-C	字高 2.4；深 0.2；局部Z范围 6.9；9.3	加工面 外侧Y=-14；字框中心(0,-14,8.1)；沿+X阅读，字顶+Z；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

09-ISO-C / 带罩隔离器双柱桥板 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：09-ISO-C-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁及钝化处理 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

09-ISO-C 带罩隔离器双柱桥板

材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓58mm，距最小Y侧外廓14mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。


未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

H01 2× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=15.2；向-Z；局部XYZ -50.0；8.5；15.2；50.0；8.5；15.2


H02 2× Ø6.4 通孔；同轴沉孔 Ø11.25 深6（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ -12.5；0.0；0.0；12.5；0.0；0.0

H03 4× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ -55.0；0.0；0.0；-45.0；0.0；0.0；45.0；0.0；0.0；55.0；0.0；0.0

右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y

