
PCF-B01 R1 | 转接件 / 主尺寸及顶面孔

平准 Ø14 PCF 准直器 / 固定式 / 名义光高 62.5 / 2026-10-28

右视 / 从 +X 看 / 2:1




主视 / 从 -Y 看 / 2:1

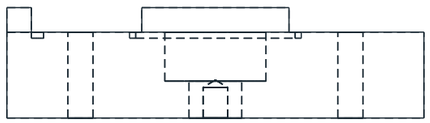

孔坐标（零件原点 O）

ID	X	Y
T1	-35	-11
T2	-35	11
T3	35	-11
T4	35	11
C1	-25	0
C2	25	0

T：M2.5；C：M4 间隙沉孔

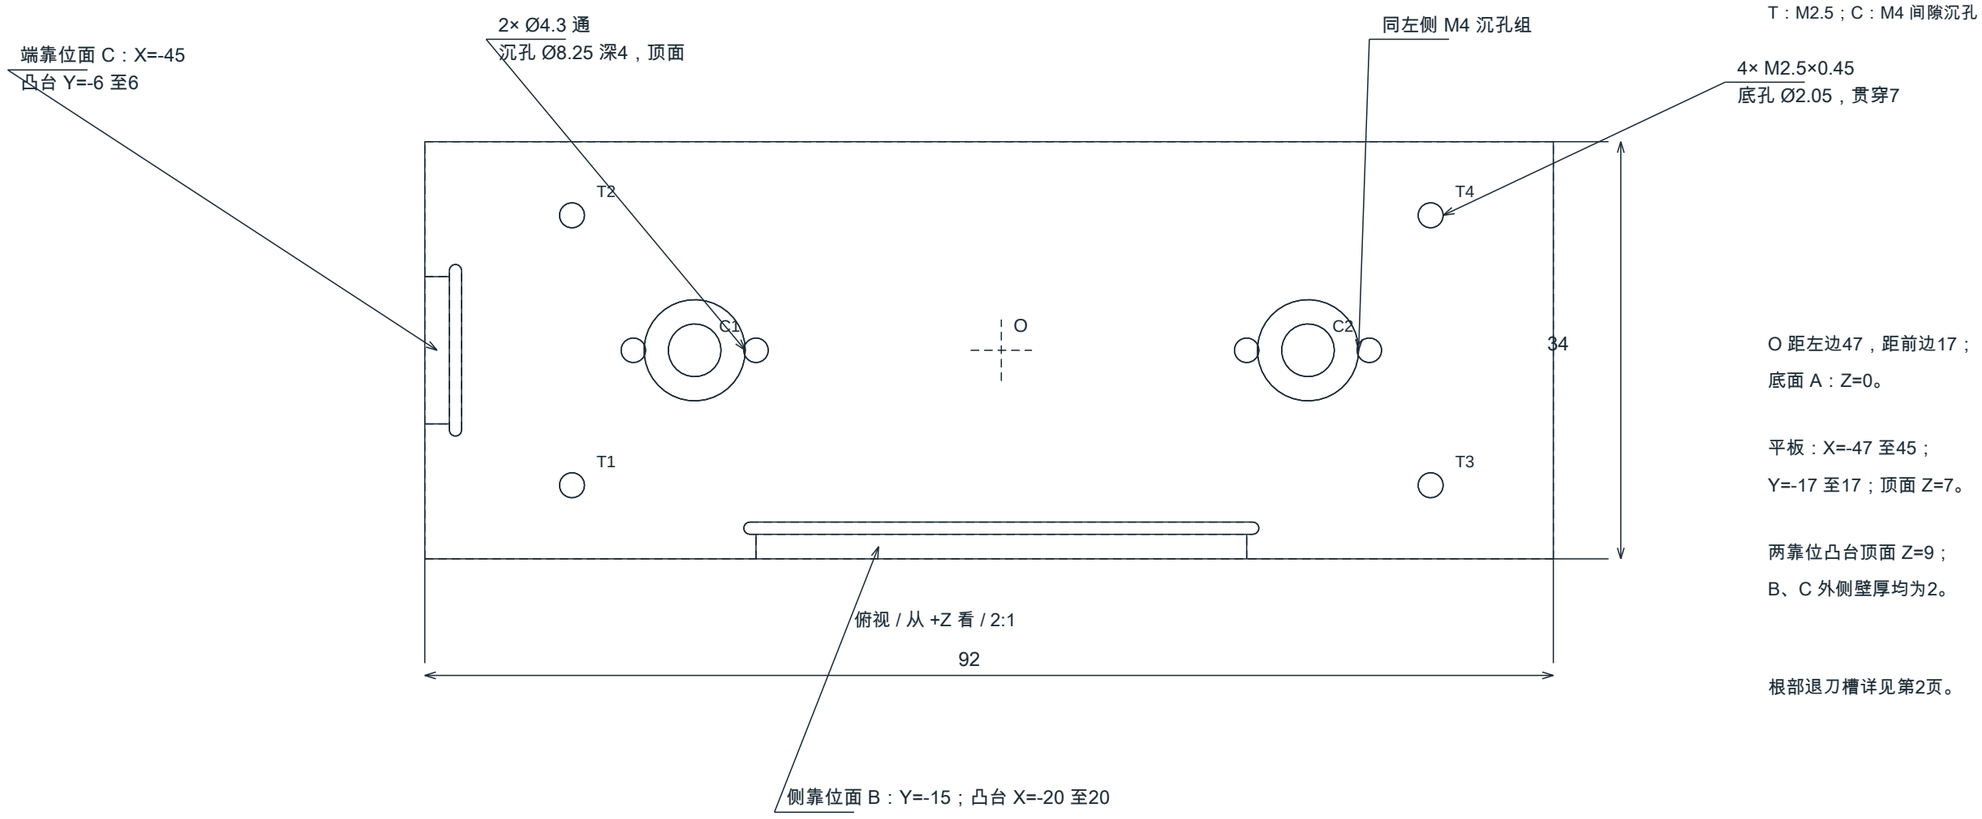

O 距左边47，距前边17；
底面 A：Z=0。

平板：X=-47 至45；
Y=-17 至17；顶面 Z=7。

两靠位凸台顶面 Z=9；
B、C 外侧壁厚均为2。

根部退刀槽详见第2页。

自制件：316L，去磁、钝化、去毛刺；数量 1。激光编号，不铣刻。


单位 mm；第一角法。工程审核版：螺纹等级、原厂夹紧接口及实物对光待确认。

STEP SHA256: 99efa7b65a84c72a976e732d7f4ef60bc999bcc70af2fb13a110453917c6b0f8


PCF-B01 R1 | 底面定位孔 / 剖面与退刀槽

平准 Ø14 PCF 准直器 / 固定式 / 名义光高 62.5 / 2026-10-28

底视 2:1 / 从 -Z 看；右为 +X，上为 -Y

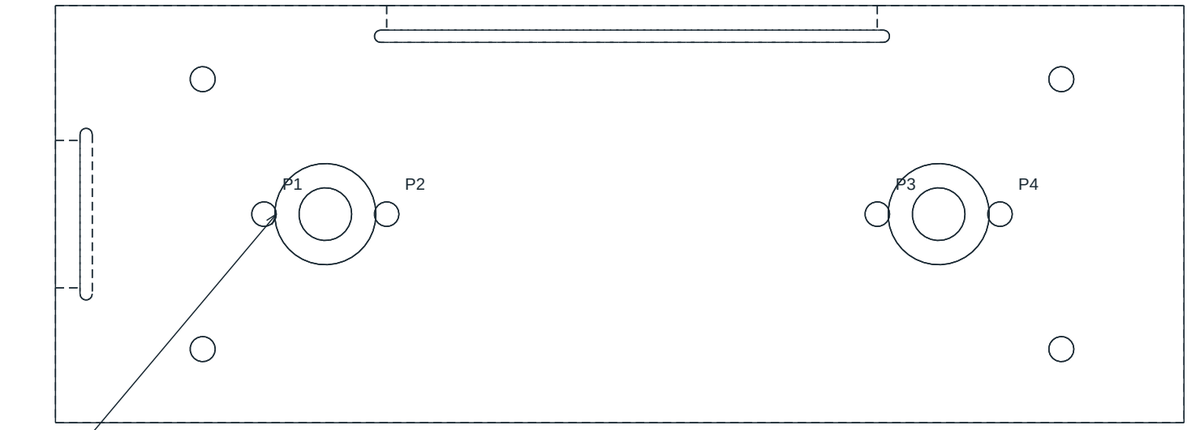

A-A 局部剖面 / Y=0 / 7:1（中心 M4 与邻近销孔）

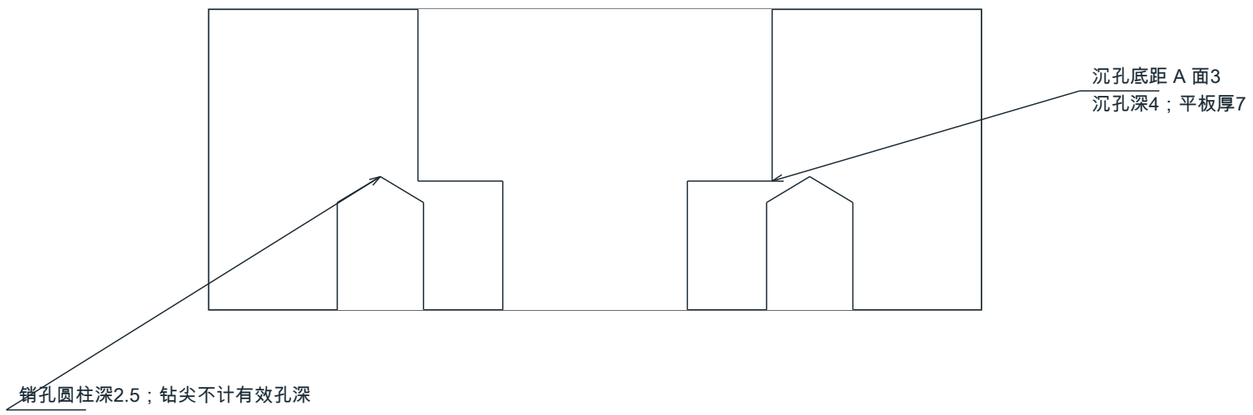

定位孔坐标（同第1页 O）

ID	X	Y
P1	-30	0
P2	-20	0
P3	20	0
P4	30	0

配 Ø2×6 方向销，4根。

插入柱约4，外露约2；

本件孔底预留约0.5。

靠位面根部退刀槽（顶面加工）

宽1，深0.5；端部 R0.5。

B槽：X=-20.5 至20.5 为圆心段；

槽中心 Y=-14.5，总长42。

C槽：Y=-6.5 至6.5 为圆心段；

槽中心 X=-44.5，总长14。

两槽底 Z=6.5，避开支承基准。

靠紧 B、C 后再锁紧原底座。

销孔配合及 M2.5 牙等级待确认。


自制件：316L，去磁、钝化、去毛刺；数量 1。激光编号，不铣刻。

单位 mm；第一角法。工程审核版：螺纹等级、原厂夹紧接口及实物对光待确认。

STEP SHA256: 99efa7b65a84c72a976e732d7f4ef60bc999bcc70af2fb13a110453917c6b0f8

PCF-B01 R1 | 总装 / 光轴基准与安装顺序

平准 Ø14 PCF 准直器 / 固定式 / 名义光高 62.5 / 2026-10-28

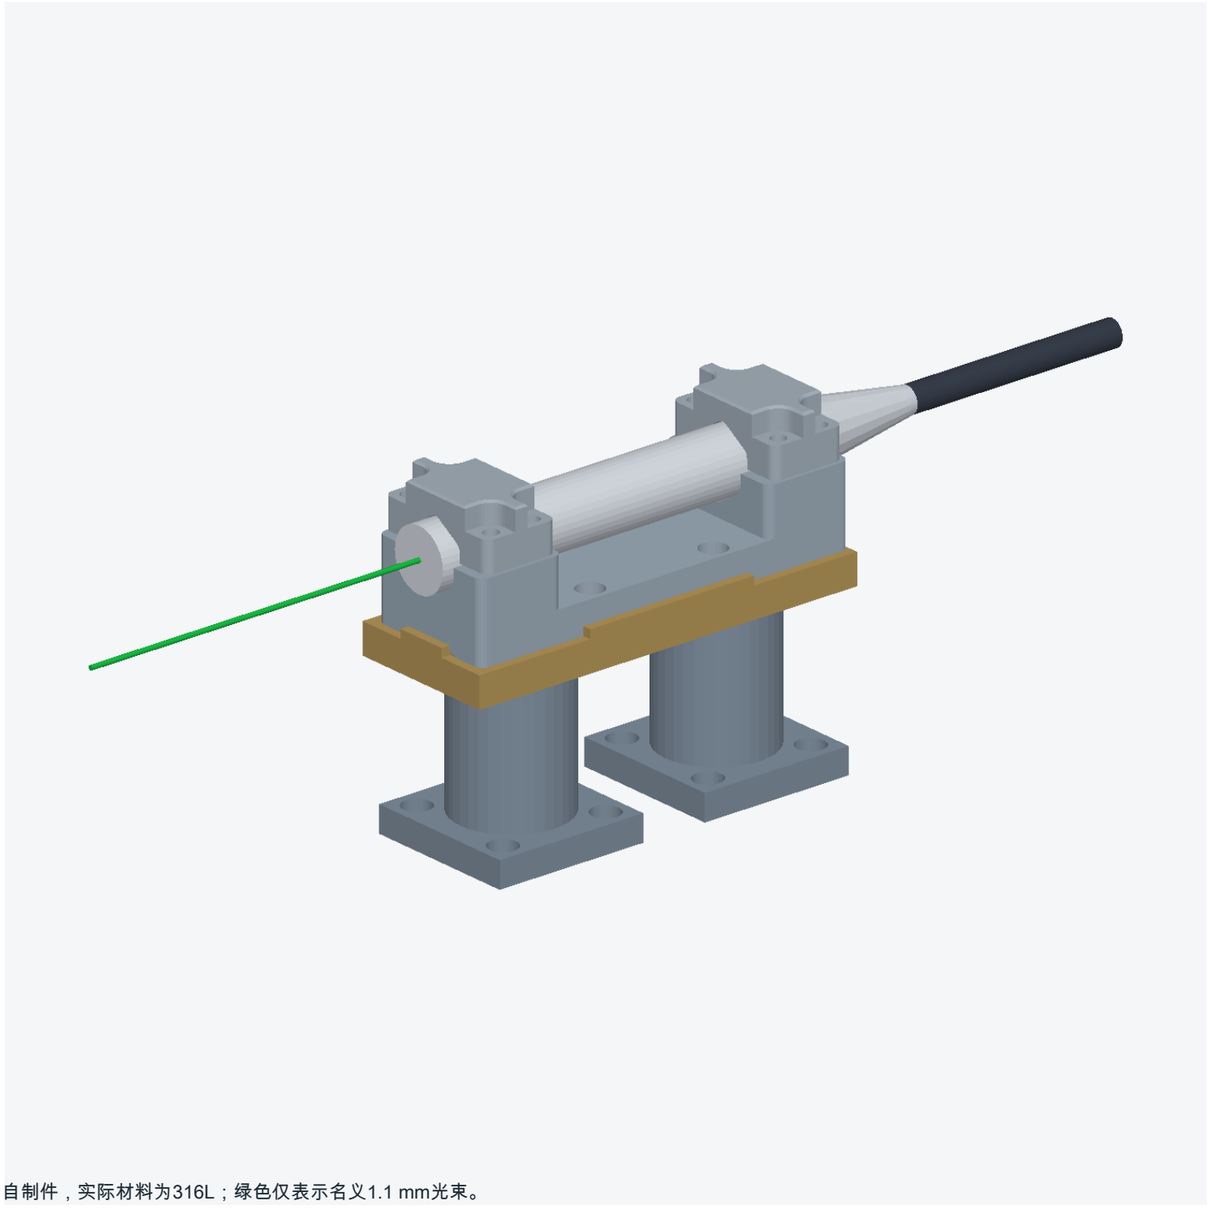

金色仅区分自制件，实际材料为316L；绿色仅表示名义1.1 mm光束。

光轴：Y=0，Z=62.5，沿 -X 出光。

37.5 + 7 + 18 = 62.5 mm

双柱中心：X=±25，Y=0；中心距50。

支脚孔：X=±12.5、±37.5；Y=±12.5。

全部位于12.5 mm基准网格。

本套组成

PCF-B01 自制转接件 ×1

正式 H37.5 B6 万能柱 ×2

用户原底座 ×1，原压块 ×2

准直器及光缆：外形参考模型

2× M4×10；4× M2.5×0.45×8

4× Ø2×6销；压块沿用原紧固件；

柱脚8×M6，螺长按母板牙深选

装配顺序

1. 柱脚先松装；销定位转接件，再锁柱脚。
2. 从上面锁2颗 M4；旋入柱内名义7。
3. 原底座靠紧 B/C；锁4颗 M2.5，旋入5。
4. 放入准直器；装压块，名义夹缝0.5。
5. 两个不同距离的靶点均对在同一基准线。

固定式无俯仰/偏摆微调。实际光轴需测定；

若有角差，应增加微调机构，不能靠强压纠偏。

准直器锥段/夹持区为R1外形假设，实物核对。

自制件：316L，去磁、钝化、去毛刺；数量 1。激光编号，不铣刻。

单位 mm；第一角法。工程审核版：螺纹等级、原厂夹紧接口及实物对光待确认。

STEP SHA256: 99efa7b65a84c72a976e732d7f4ef60bc999bcc70af2fb13a110453917c6b0f8


PCF-B01 R1 | 激光打标定位 / 1:1 毫米轮廓文件

平准 Ø14 PCF 准直器 / 固定式 / 名义光高 62.5 / 2026-10-28

编号：PCF-B01 R1 | 实际字高 2.2 mm | 激光打标，不铣刻

面：零件 Y=-17；从 -Y 看，字右 +X，字顶 +Z。标识包围盒左下角 (X,Z)=(4,1.9)。

正视定位图 3:1（参考轮廓不出光）

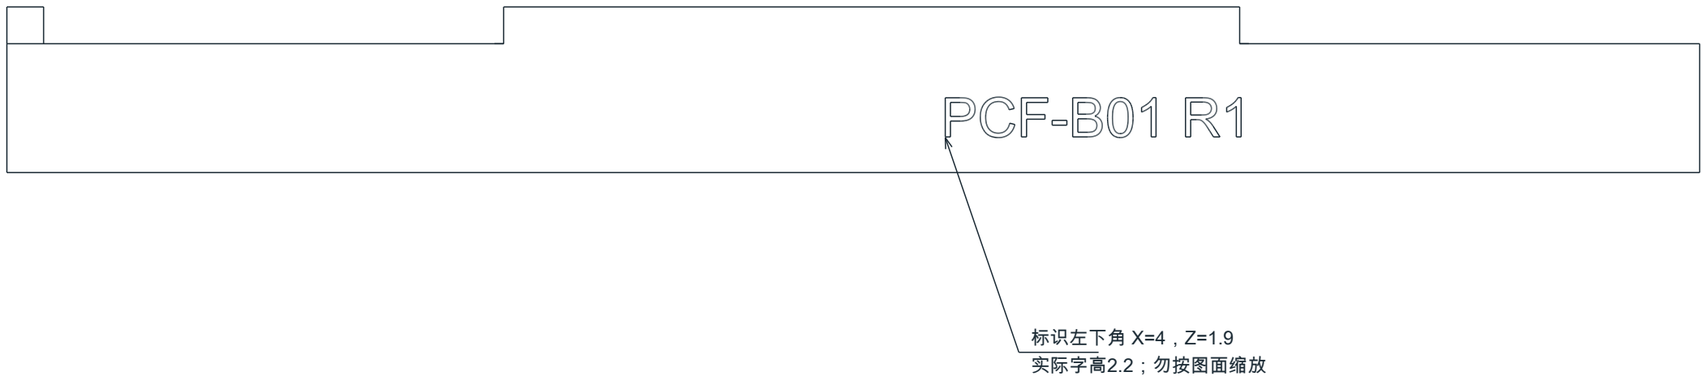

配套机器文件：PCF-B01_R1_front_LASER_ONLY.dxf

文件单位mm、1:1；仅闭合字形轮廓，无外框、孔或机加工线。

字体已转轮廓；勿再次替换字体、镜像或缩放。

激光功率、速度、遍数依同材同处理试样设定；本资料不指定去除深度。

定位绑定 PCF-B01_R1.step；模型哈希见各页标题栏。

自制件：316L，去磁、钝化、去毛刺；数量 1。激光编号，不铣刻。

单位 mm；第一角法。工程审核版：螺纹等级、原厂夹紧接口及实物对光待确认。

STEP SHA256: 99efa7b65a84c72a976e732d7f4ef60bc999bcc70af2fb13a110453917c6b0f8