

# 二英寸透镜一体转接块




右视图 Y / Z

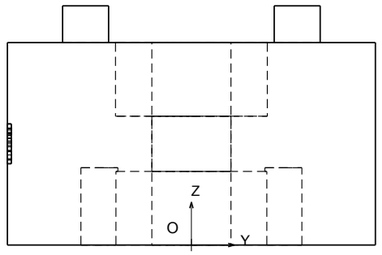


主视图 X / Z

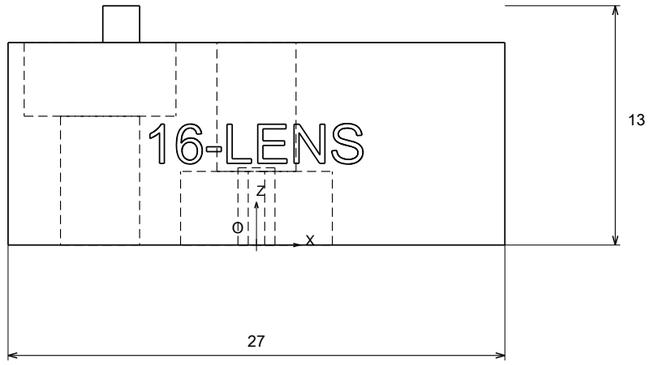


俯视图 X / Y

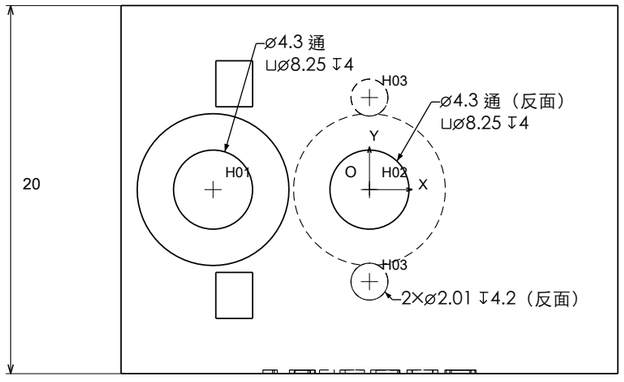


## 加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓13.5mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 中央底沉孔与两销孔局部相通；交口去毛刺并检查销配合。
5. 两短X定位挡保留；不加工侧加载窗。
6. 盲销孔标注为有效圆柱深；钻尖另计，不得贯穿。
7. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
8. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
9. 配套名义柱高12.5；本图局部Z0对应世界Z=12.5。
10. 商业底螺钉可选M4×10，名义旋入3、原厂深5.5；旧M4×12现旋入5、仅余0.5，不直接沿用。
11. 柱固定建议M4×12；名义旋入5，距8深直段孔底3；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
89760767862143fc164f8650b5154f68
25774897f0174738ebf4a1946bd8ed41

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16-LENS / 二英寸透镜一体转接块<br>修订 M1　单位 mm　第一角投影<br>图号：16-LENS-M1 | 材料：316L不锈钢<br>表面处理：去磁及钝化处理<br>孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明 | 比例 3:1<br>A3　420 × 297<br>打印：实际大小 100% | 页次 1 / 3<br>加工工程图<br>未注条件见技术说明 |

# 二英寸透镜一体转接块



局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓13.5mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

| 编号 | 孔轴坐标 X, Y, Z (mm) | 入孔轴向 | 入口面 / 基准 | 加工标注 | 补充说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | -8.5, 0, 11 | (0, 0, -1) | 入口局部Z=11；向-Z | 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工） | |
| H02 | 0, 0, 0 | (0, 0, 1) | 入口局部Z=0；向+Z | 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工） | |
| H03 | 0, -5, 0<br>0, 5, 0 | (0, 0, 1) | 入口局部Z=0；向+Z | 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿 | |

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16-LENS / 二英寸透镜一体转接块<br>修订 M1　单位 mm　第一角投影<br>图号：16-LENS-M1 | 材料：316L不锈钢<br>表面处理：去磁及钝化处理<br>孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明 | 比例 3:1<br>A3　420 × 297<br>打印：实际大小 100% | 页次 2 / 3<br>加工工程图<br>未注条件见技术说明 |

# 二英寸透镜一体转接块

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓13.5mm，距最小Y侧外廓10mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

| 编号 | 加工部位 | 尺寸 / 操作 | 说明 |
|---|---|---|---|
| B01 | 主座 | 局部起点(-13.5,-10,0)；X×Y×Z=27×20×11 | |
| S-7 | 两短X定位挡 | 局部起点(-8.35,-7,11)；X×Y×Z=2×2.5×2 | |
| S4.5 | 两短X定位挡 | 局部起点(-8.35,4.5,11)；X×Y×Z=2×2.5×2 | |
| D01 | 底面中央沉孔与两销孔局部相通是既定几何，不是要求留下0.13薄壁 | 沉孔与销孔径向相通0.13；相通深4；销孔末端0.2保留完整圆周；约307.008°销孔定位弧 | |
| ENG | 激光打标 16-LENS | 字高 2.2；示意 ；局部Z范围 4.4；6.6 | 加工面 字框中心(0,-10,5.5)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,-1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。 |

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16-LENS / 二英寸透镜一体转接块<br>修订 M1　单位 mm　第一角投影<br>图号：16-LENS-M1 | 材料：316L不锈钢<br>表面处理：去磁及钝化处理<br>孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明 | 比例 3:1<br>A3　420 × 297<br>打印：实际大小 100% | 页次 3 / 3<br>加工工程图<br>未注条件见技术说明 |