
20 mm PBS 二维可调架 · 总装与装配

标准光学协议 | 单位 mm | R1 | 2026-11-05 | 工程审核版

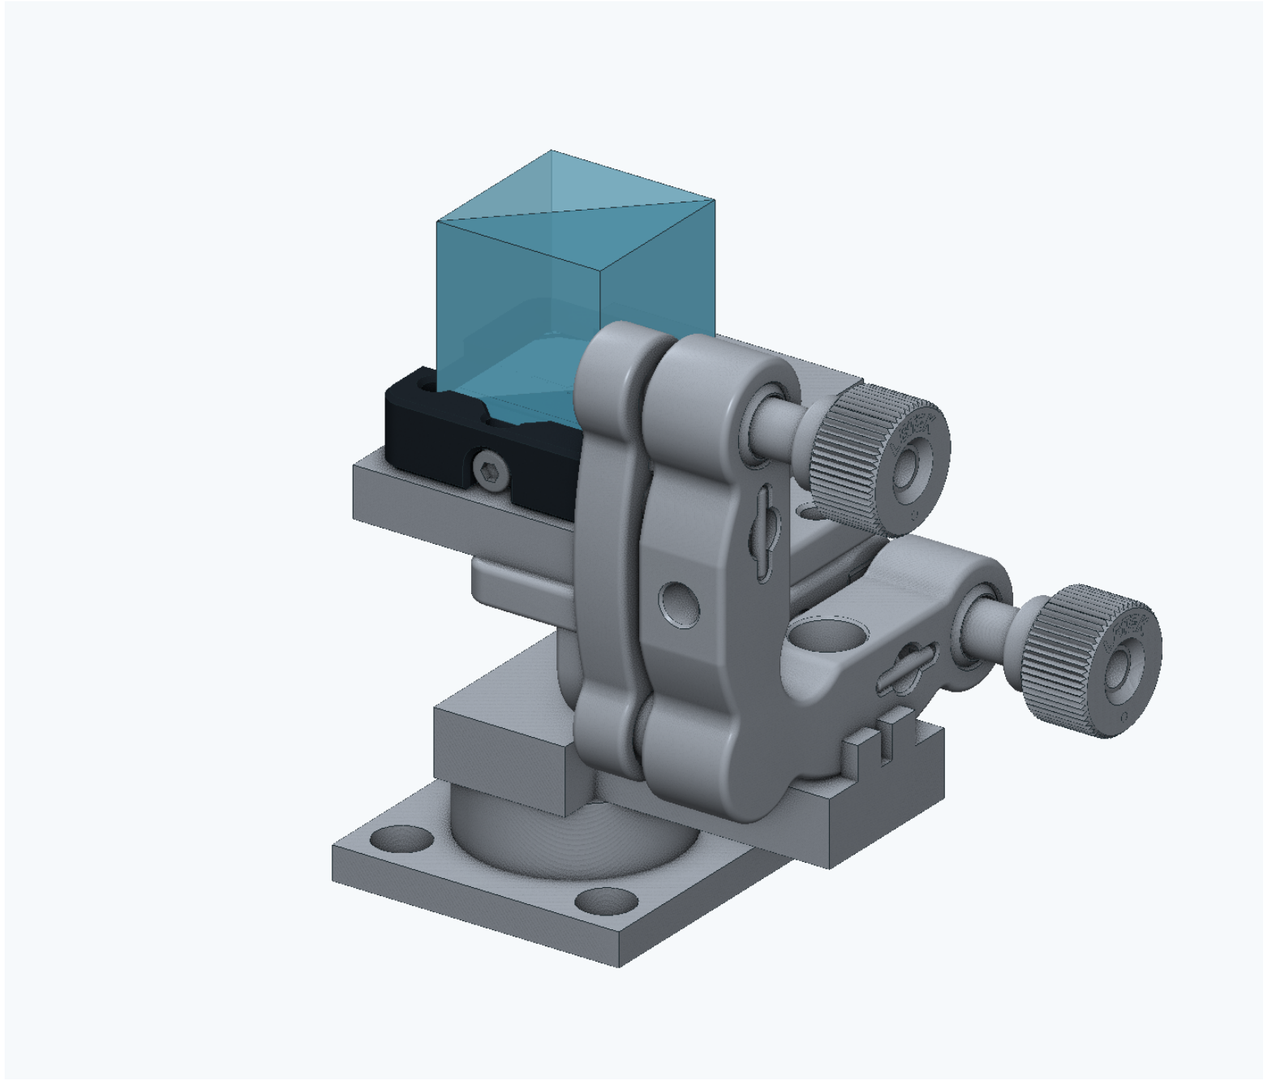

零位光心 (0,0,62.5) mm

20×20×20 mm 裸 PBS；型号与波长待选定

序号	构成	数量
1	H12.5 B4-R2 正式万能柱	1
2	P20-L-R1 下座（新制）	1
3	麓邦 AMP-1R 原调节机构	1
4	P20-U-R1 上板（新制）	1
5	麓邦 PCMS20 夹座（原厂）	1
6	20 mm PBS（名义光学参考）	1

高度链：12.5 + 7.8 + 19.8 + 6 + 6.4 + 10 = 62.5。

下座相对柱轴将 AMP 沿 +X 偏置 11 mm，PBS 保持居中。

① 4×M6×10 先锁裸柱到底板（啮合依实际板厚复核）。

② 2×Ø2×8 定向销；M4×10 从上方锁下座到柱。

③ 用原附 M4×10 锁 AMP 固定框，背面贴合两短挡块。

④ 在外部，从底面用 M4×6 把 PCMS20 锁到上板。

⑤ 将上板底键贴 AMP 台边，后排孔用 M4×6 从上锁紧。

⑥ 置入 PBS，沿 X 居中、贴后基准，AF2 轻锁夹座。

拆柱时先释放 AMP；不得在完整载荷下强拧柱端螺丝。

验收范围与限制

零位实体、STEP 回读、接触面和 Ø4 mm 通光已查。

厂家 AMP 标称俯仰/偏摆 ±4°；非共心转轴。

9 个理想姿态仅检查载荷对新下座/柱，不等于全行程验证。

未实装、未作光学性能/刚度验证；不是制造放行。

来源：lbtek.com/product/678 与 /154；原厂文件随包。

PBS20-AMP1R-R1 | 仅新制件：316L 不锈钢；去磁、钝化。编号为激光打标，不铣刻。


首件前复核螺纹配合、方向销配合、挡边装配及实际 PBS 尺寸；未作实物试装。

P20-L-R1 固定侧下转接座


标准光学协议 | 单位 mm | R1 | 2026-11-05 | 工程审核版

第一角法；主/俯视 2.5:1，右视 1.5:1；底视独立，以下座2.5:1、上板1.8:1显示。

右视 +X




主视 -Y

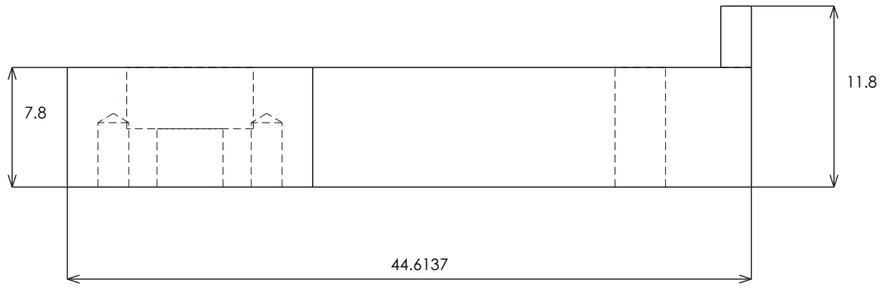

特征	起点 (X,Y,Z)	尺寸 X×Y×Z
B1	(-8,-13.35,0)	16×26.7×7.8
B2	(0,-8,0)	36.6137×20×7.8
挡块1	(34.6137,-3.05,7.8)	2×4×4
挡块2	(34.6137,2.95,7.8)	2×4×4


孔	X	Y	入口
H1	0	8.5	顶面
H2a/b	-5 / +5	0	底面
H3	29.3637	2	顶面

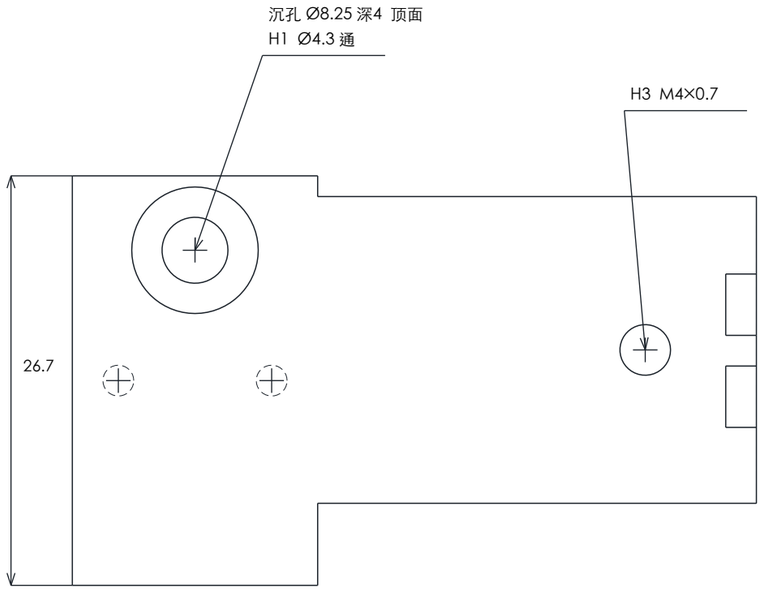

俯视 +Z

局部 Z=0 为柱顶接触面；X/Y 原点为柱轴。

上表面与 AMP 固定框底面贴合。

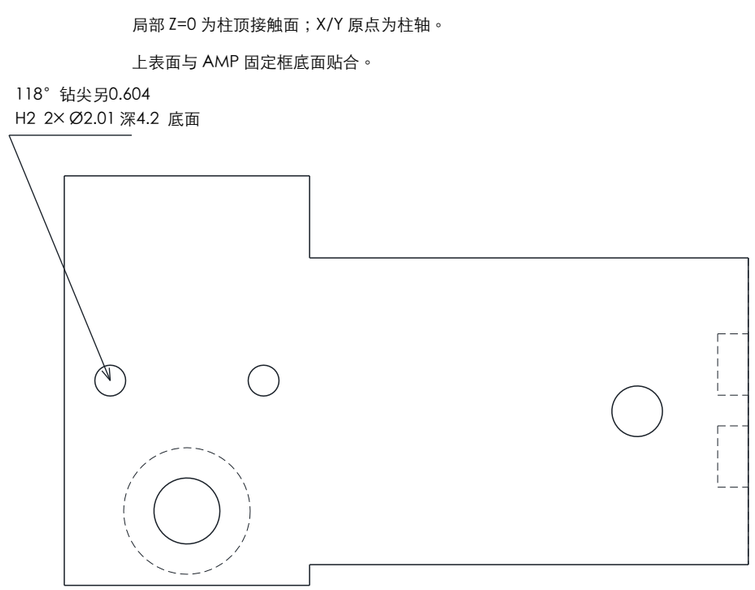

底视 -Z

尺寸定位：全部孔位及台阶以表列局部基准为准；模型孔为底孔/间隙表示。外棱去毛刺，保持功能接触面。

P20-L-R1 | 仅新制件：316L 不锈钢；去磁、钝化。编号为激光打标，不铣刻。


首件前复核螺纹配合、方向销配合、挡边装配及实际 PBS 尺寸；未作实物试装。

P20-U-R1 运动侧上转接板


标准光学协议 | 单位 mm | R1 | 2026-11-05 | 工程审核版


第一角法；主/俯视 2.5:1，右视 1.5:1；底视独立，以下座2.5:1、上板1.8:1显示。

右视 +X

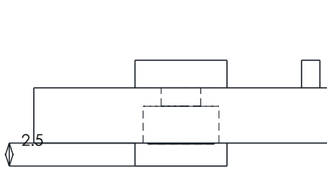

主视 -Y

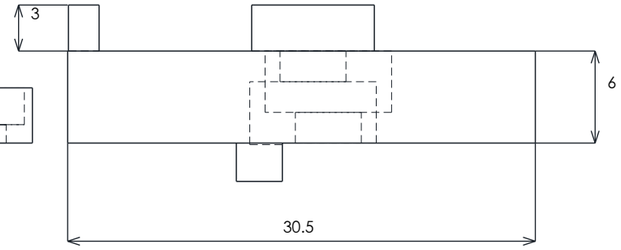

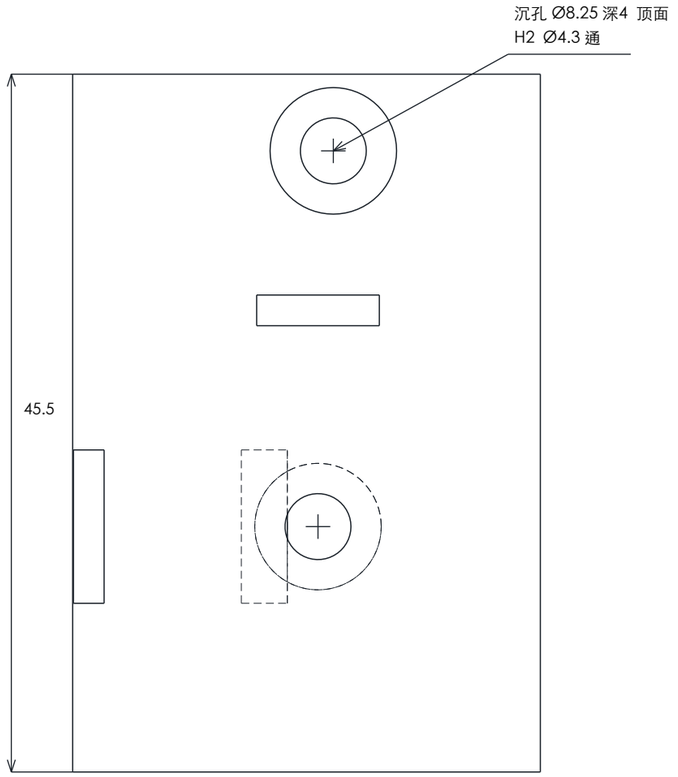

俯视 +Z


特征	起点 (X,Y,Z)	尺寸 X×Y×Z
主板	(-16,-16,0)	30.5×45.5×6
底定位键	(-5,-5,-2.5)	3×10×2.5
左挡边	(-15.95,-5,6)	2×10×3
后挡边	(-4,13.1,6)	8×2×3

孔	X	Y	入口
H1	0	0	底面
H2	1	24.5	顶面

局部 Z=0 为 AMP 台面；光轴投影 X=Y=0。

H1 与 H2 的沉孔入口方向相反。

底键接触 AMP 台面左侧，H2 夹紧；勿粘死调节层。

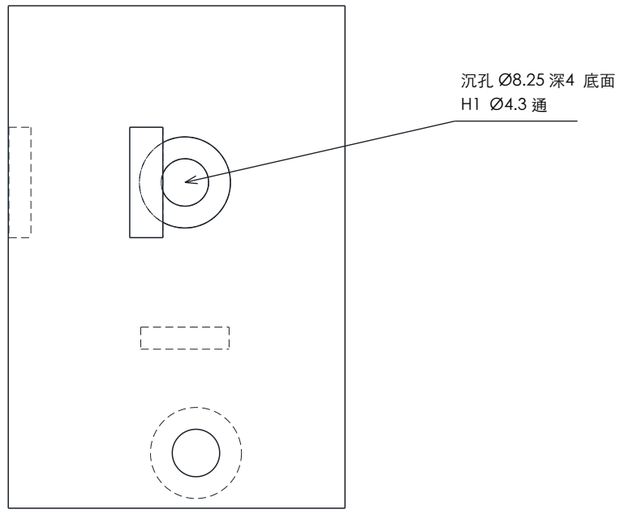

底视 -Z

尺寸定位：全部孔位及台阶以表列局部基准为准；模型孔为底孔/间隙表示。外棱去毛刺，保持功能接触面。


P20-U-R1 | 仅新制件：316L 不锈钢；去磁、钝化。编号为激光打标，不铣刻。

首件前复核螺纹配合、方向销配合、挡边装配及实际 PBS 尺寸；未作实物试装。

唯一编号 · 激光打标定位

标准光学协议 | 单位 mm | R1 | 2026-11-05 | 工程审核版

P20-L-R1

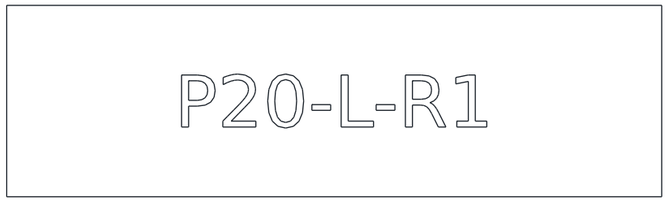


下座外侧 X=-8；阅读沿 -Y，向上为 +Z

局部字框中心 (-8,0,3.9)；字高 2.2 mm。

CAD 主体不铣刻；此 DXF 为闭合字形轮廓，1:1 mm。

P20-U-R1

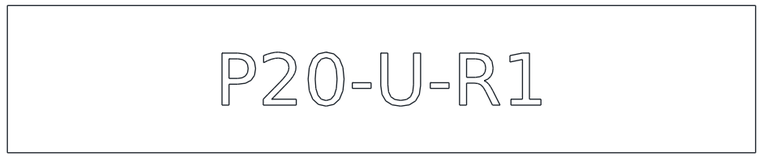

上板前侧 Y=-16；阅读沿 +X，向上为 +Z

局部字框中心 (-0.75,-16,3)；字高 2.2 mm。

CAD 主体不铣刻；此 DXF 为闭合字形轮廓，1:1 mm。

工艺：同材质及表面处理试样确认功率、速度、遍数及清晰度；不规定激光去除深度。

编号分别对应独立 STEP、加工图及 BOM；不得把编号打在支承面、销孔或螺纹上。