

滨松SLM光学头一体L形转接件

三视图 / 外形尺寸 / 孔编号


右视图 Y / Z

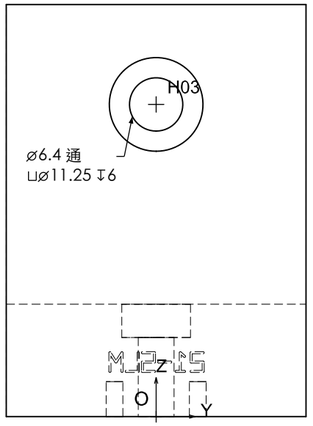

主视图 X / Z

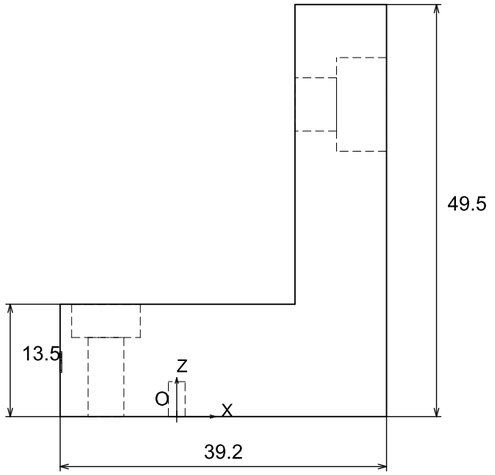

俯视图 X / Y

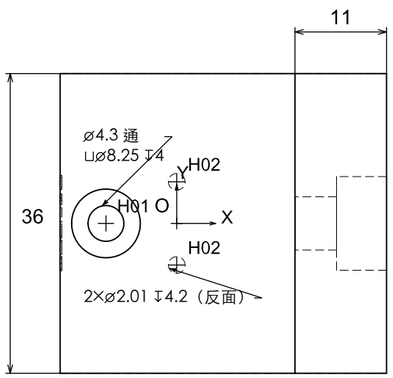

加工基准与说明

以主底面为局部Z0；X/Y方向见坐标箭头。原点距最小X外廓14毫米、距最小Y外廓18毫米。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：本件无攻牙孔；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 采用普通M4预放顺序；光头安装后只要求AF3杆通路，拆光头后取出M4头。
5. 官方背M6孔高24±0.15；Ø6.4径向余量0.2仅余0.05用于其他位置/贴合误差，实际孔位与本件公差需核对。
6. 光学中心高24适用官方未注±1；反射深14.2±0.3。62.5和柱心为名义基准，不是实测零误差。
7. 仅用背M6名义深4；其未注深度公差若按±1，浅限3下M6×8无底余，须实测有效牙深和伸出量。
8. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
9. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
10. 配套名义柱高25；本图局部Z0对应世界Z=25。
11. 背M6×8名义旋入3；深4若按未注±1取浅限3则无底余，须实测后定长。
12. 柱固定建议M4×16；名义旋入6.5，距8深直段孔底1.5；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
f663bd480a1fbe079d5b0087dbeba69e
022b48bd70f828e7428ecc0fd169004b

21-SLM / 滨松SLM光学头一体L形转接件 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：21-SLM-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

滨松SLM光学头一体L形转接件

孔坐标与加工标注

局部基准：以主底面为局部Z0；X/Y方向见坐标箭头。原点距最小X外廓14毫米、距最小Y外廓18毫米。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	-8.5, 0, 13.5	(0, 0, -1)	入口局部Z=13.5；向-Z	1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	配正式新版柱M4；M4×16名义旋入6.5，有效牙深须核实际新版柱。
H02	0, -5, 0 0, 5, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	有效圆柱深4.2；118°钻尖另计约0.604，不得贯穿。
H03	25.2, 0, 37.5	(-1, 0, 0)	入口局部X=25.2；向-X	1× Ø6.4 通孔；同轴沉孔 Ø11.25 深6（从本行入口加工）	配光头背部M6深4；M6×8仅选型起点，名义入牙3、名义底余1；深4若适用±1，浅限3下无底余，需核实际牙深和伸出量。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：本件无攻牙孔；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

21-SLM / 滨松SLM光学头一体L形转接件 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：21-SLM-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

滨松SLM光学头一体L形转接件

台阶、挡边与刻字

局部基准：以主底面为局部Z0；X/Y方向见坐标箭头。原点距最小X外廓14毫米、距最小Y外廓18毫米。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
F01	底台	局部起点(-14,-18,0)；X×Y×Z=39.2×36×13.5	光头底支承面为局部Z13.5。
F02	与底台一体的竖背壁	局部起点(14.2,-18,13.5)；X×Y×Z=11×36×36	贴靠面X14.2、外背面X25.2；总高49.5。
ENG	实体凹刻 21-SLM	字高 2.5；深 0.2；局部Z范围 5.3；7.8	加工面 前侧非配合面X=-14；沿-Y阅读；字框Y约±5.775，局部Z=5.3至7.8；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：本件无攻牙孔；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

21-SLM / 滨松SLM光学头一体L形转接件 修订 M1　单位 mm　第一角投影 图号：21-SLM-M1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 3 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

21-SLM 滨松SLM光学头一体L形转接件

材料：316L不锈钢；去磁、钝化

以主底面为局部Z0；X/Y方向见坐标箭头。原点距最小X外廓14毫米、距最小Y外廓18毫米。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。


未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：本件无攻牙孔；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

H01 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=13.5；向-Z；局部XYZ -8.5；0.0；13.5


H02 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ 0.0；-5.0；0.0；0.0；5.0；0.0

H03 1× Ø6.4 通孔；同轴沉孔 Ø11.25 深6（从本行入口加工）；入口 入口局部X=25.2；向-X；局部XYZ 25.2；0.0；37.5

右视图 Y / Z

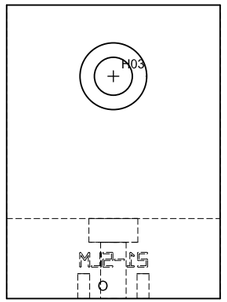

主视图 X / Z

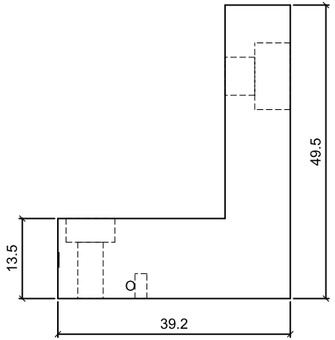

俯视图 X / Y

