

# 一英寸透镜转接下板


右视图 Y / Z




主视图 X / Z

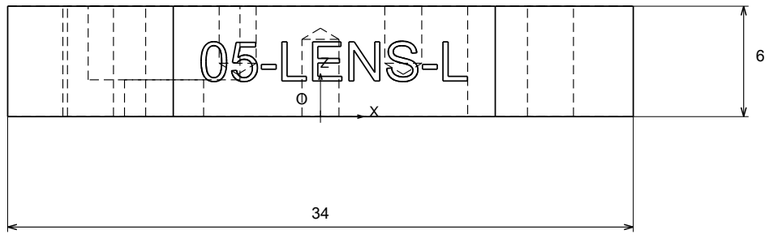


俯视图 X / Y

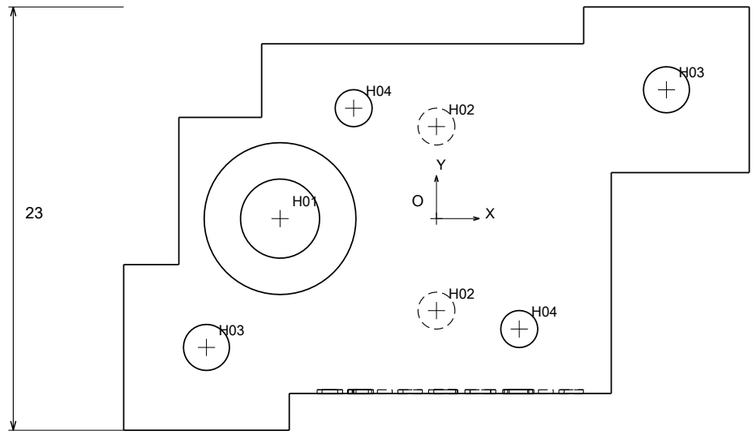


## 加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓11.5mm。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 两个对角M3孔为　　攻牙；层间销孔从顶面加工。

冻结源 SHA256：
8e34874c6d4d11a6a554efe6552acd20761f0b03ff6a76eba93d96a7b8ed9b55

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05-LENS-L / 一英寸透镜转接下板<br>修订 R6　单位 mm　第一角投影<br>图号：05-LENS-L-R6 | 材料：316L不锈钢<br>表面处理：去磁及钝化处理<br>孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明 | 比例 3:1<br>A3 420 × 297<br>打印：实际大小 100% | 页次 1 / 3<br>加工工程图<br>未注条件见技术说明 |

# 一英寸透镜转接下板



局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓11.5mm。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

| 编号 | 孔轴坐标 X, Y, Z (mm) | 入孔轴向 | 入口面 / 基准 | 加工标注 | 补充说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| H01 | -8.5, 0, 6 | (0, 0, -1) | 顶面局部Z=6，向下-Z | 1× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（上表面向下） | |
| H02 | 0, -5, 0<br>0, 5, 0 | (0, 0, 1) | 主底面局部Z=0，向上+Z | 2× Ø2.01 盲孔 深4.2（完整圆柱深；另118°钻尖） | 标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。 |
| H03 | -12.5, -7, 6<br>12.5, 7, 6 | (0, 0, -1) | 见入孔坐标和轴向 | 2× M3×0.5　　攻牙 | |
| H04 | 4.5, -6, 6<br>-4.5, 6, 6 | (0, 0, -1) | 顶面局部Z=6，向下-Z | 2× Ø2.01 盲孔 深3.1（完整圆柱深；另118°钻尖） | 标注深度为有效圆柱深度，钻尖另计，不得贯穿。 |

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05-LENS-L / 一英寸透镜转接下板<br>修订 R6　单位 mm　第一角投影<br>图号：05-LENS-L-R6 | 材料：316L不锈钢<br>表面处理：去磁及钝化处理<br>孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明 | 比例 3:1<br>A3　420 × 297<br>打印：实际大小 100% | 页次 2 / 3<br>加工工程图<br>未注条件见技术说明 |

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓17mm，距最小Y侧外廓11.5mm。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

| 编号 | 加工部位 | 尺寸 / 操作 | 说明 |
|---|---|---|---|
| B01 | 外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次） | 局部起点 (-9.5, -9.5, 0)；X×Y×Z=19×19×6 | |
| B02 | 外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次） | 局部起点 (-17, -11.5, 0)；X×Y×Z=9×9×6 | |
| B03 | 外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次） | 局部起点 (8, 2.5, 0)；X×Y×Z=9×9×6 | |
| B04 | 外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次） | 局部起点 (-14, -5.5, 0)；X×Y×Z=14×11×6 | |
| ENG | 实体凹刻 05-LENS-L | 字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 1.9；4.1 | 加工面 外侧Y=-9.5；字框中心(0.75,-9.5,3)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；字形与位置以配套冻结STEP为准。 |

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

05-LENS-L / 一英寸透镜转接下板

修订 R6　单位 mm　第一角投影

图号：05-LENS-L-R6

材料：316L不锈钢

表面处理：去磁及钝化处理

孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 3:1

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%



加工工程图

未注条件见技术说明