
OBJ-PT1M-AC-R3 · 一体转接座加工审核


316L 不锈钢；去磁、钝化。M4 螺纹在 STEP 中表达为底孔；编号采用激光打标。

右视图 1:1



主视图 1.7:1



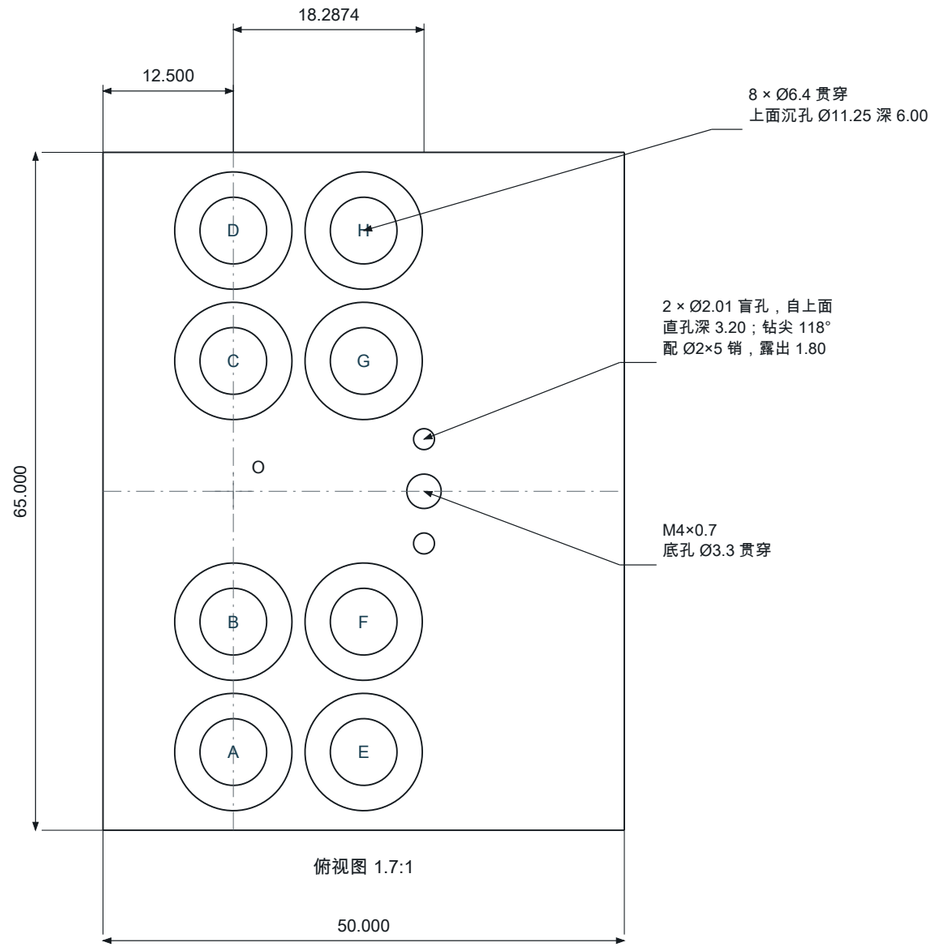

俯视图 1.7:1

基准 O：物镜后端机械出口中心的底面投影。

+X：沿光轴朝电机；+Y：横向；+Z：向上。

外形 X：-12.500 ~ +37.500

外形 Y：−32.500 ~ +32.500

底面 Z=0，顶面为全部沉孔及销孔入口。

孔号	X	Y
A	+0.000	-25.000
B	+0.000	-12.500
C	+0.000	+12.500
D	+0.000	+25.000
E	+12.500	-25.000
F	+12.500	-12.500
G	+12.500	+12.500
H	+12.500	+25.000
M4	+18.2874	0.000
销孔	+18.2874	±5.000

每次仅装 2 颗 ISO 4762 M6×16；按选孔图。

M6 名义啮合 5.220；沉孔底余厚 10.780。

M4×14 薄头沿用，啮合约 5；销孔原深 1.90。

相邻沉孔最小净壁 1.25；不得扩大孔口。

卸下上部镜架后装入并锁紧所选 M6 螺钉。

随后复装镜架及双电机，重新对准光路。

侧面激光编号字高 2.20；详见打标 DXF。

ZZLab · XBK / 物镜 A-C 双电机 · 前伸完整总装 / 12.5 mm 选择孔阵	图号 P
工程审核 R3 · 2026-10-22 · 单位 mm · 尚未放行加工	第一角法；比例按视图标注