

308四输出竖板


右视图 Y / Z

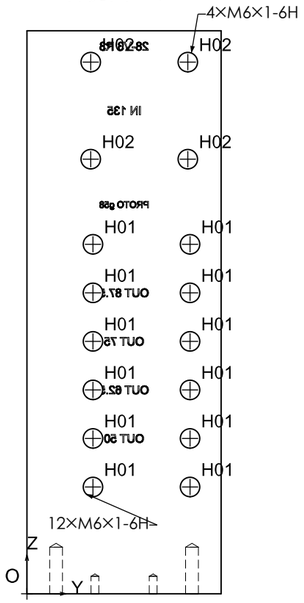

主视图 X / Z

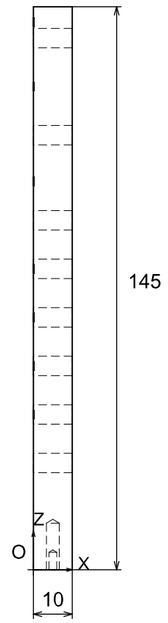

俯视图 X / Y



加工基准与说明

局部原点为竖板底边接合面、后背面及左侧面的交点。A底边Z0，B后背X0，C左侧Y0；镜组贴合面为X10。Z向上，X沿10厚度，Y沿50宽度；总装板底位于主板上方10。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 本图仅定制加工件；商用器件、万能柱与标准螺钉不出加工图。
5. 螺钉沉孔：Onshape ISO公制间隙孔Close配合默认尺寸，按孔表完整加工。
6. 308 nm G58为用户批准的可修正试制假设，激光器绝对足孔位置仍需实测。
7. 底/竖板先在桌外用2×M4×16及2×Ø2×8组装；销埋入量另测。

冻结源 SHA256：
e1451b9ad6ac5b9f7deed4f846b7bd09
3963edc4158ae9d363302f064a68579f

28-V3 / 308四输出竖板 修订 R3　单位 mm　第一角投影 图号：28-V3-R3	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1.4286 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

308四输出竖板

局部基准：局部原点为竖板底边接合面、后背面及左侧面的交点。A底边Z0，B后背X0，C左侧Y0；镜组贴合面为X10。Z向上，X沿10厚度，Y沿50宽度；总装板底位于主板上方10。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	10, 17, 27.5 10, 17, 52.5 10, 42, 27.5 10, 42, 52.5 10, 17, 40 10, 17, 65 10, 42, 40 10, 42, 65 10, 17, 77.5 10, 42, 77.5 10, 17, 90 10, 42, 90	(-1, 0, 0)	局部X=10，向-X	12× M6×1-6H贯穿10；STEP为Ø5攻牙底孔	LOWER 校正卧柱零偏；M6×12，支架夹4、名义旋入8；档位共享同一实体孔，坐标不得取整；各档四孔选择见装配索引。
H02	10, 16.4254, 111.9254 10, 16.4254, 136.9254 10, 41.4254, 111.9254 10, 41.4254, 136.9254	(-1, 0, 0)	局部X=10，向-X	4× M6×1-6H贯穿10；STEP为Ø5攻牙底孔	UPPER 原27实测安装偏量；M6×12，支架夹4、名义旋入8；档位共享同一实体孔，坐标不得取整；各档四孔选择见装配索引。
H03	5, 7.5, 0 5, 42.5, 0	(0, 0, 1)	局部Z=0，向+Z	2× M4×0.7-6H完整有效牙≥10；Ø3.3全径钻深12 + 118°尖约0.991142	接合横板，名义旋入10，底锥攻牙或螺纹铣保证有效牙
H04	5, 17.5, 0 5, 32.5, 0	(0, 0, 1)	局部Z=0，向+Z	2× Ø2.01全径深4.5 + 118°尖约0.603865；总钻深约5.103865	接收Ø2×8上露4，名义全径底余0.5

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

28-V3 / 308四输出竖板 修订 R3　单位 mm　第一角投影 图号：28-V3-R3	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1.4286 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明


308四输出竖板

局部基准：局部原点为竖板底边接合面、后背面及左侧面的交点。A底边Z0，B后背X0，C左侧Y0；镜组贴合面为X10。Z向上，X沿10厚度，Y沿50宽度；总装板底位于主板上方10。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。


编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
F01	矩形板	尺寸X×Y×Z=[10.0, 50.0, 145.0]；局部起点=[0.0, 0.0, 0.0]	尺寸由冻结实体及特征表确定。
E01	实体凹刻 28-V3 R3	字框中心局部(0, 25, 141)；高2.2；深0.2；宽12.47914	外法向局部(-1, 0, 0)；字右(0, -1, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E02	实体凹刻 PROTO g58	字框中心局部(0, 25, 100)；高2.2；深0.2；宽12.565055	外法向局部(-1, 0, 0)；字右(0, -1, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E03	实体凹刻 IN 135	字框中心局部(0, 25, 124.425379)；高2.2；深0.2；宽8.460748	外法向局部(-1, 0, 0)；字右(0, -1, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E04	实体凹刻 OUT 50	字框中心局部(0, 25, 40)；高2.2；深0.2；宽10.0588	外法向局部(-1, 0, 0)；字右(0, -1, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E05	实体凹刻 OUT 62.5	字框中心局部(0, 25, 52.5)；高2.2；深0.2；宽12.558998	外法向局部(-1, 0, 0)；字右(0, -1, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E06	实体凹刻 OUT 75	字框中心局部(0, 25, 65)；高2.2；深0.2；宽10.082004	外法向局部(-1, 0, 0)；字右(0, -1, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
E07	实体凹刻 OUT 87.5	字框中心局部(0, 25, 77.5)；高2.2；深0.2；宽12.558998	外法向局部(-1, 0, 0)；字右(0, -1, 0)；字顶(0, 0, 1)。字形以冻结实体为准。
OPT	实际镜面与光路基准	总装世界上镜反射面圆心(0,4.5,135)；下镜反射面圆心(0,4.5,O)，O=50/62.5/75/87.5。方向−X→−Z→+Y。	后承面加1inch镜厚6mm；俯视可见背面圆心不作反射基准。镜片镀膜另选。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。


右视图 Y / Z

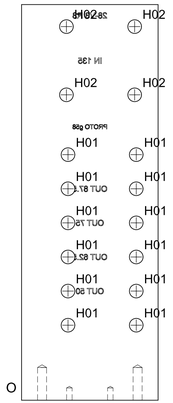

主视图 X / Z



俯视图 X / Y



28-V3 308四输出竖板

材料：316L不锈钢；去磁、钝化

局部原点为竖板底边接合面、后背面及左侧面的交点。A底边Z0，B后背X0，C左侧Y0；镜组贴合面为X10。Z向上，X沿10厚度，Y沿50宽度；总装板底位于主板上方10。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；专用孔径、孔深、螺纹等级依孔表。坐标小数位不代表制造公差。

H01 12× M6×1-6H贯穿10；STEP为Ø5攻牙底孔；入口 局部X=10，向-X；局部XYZ 10.0；17.0；27.5；10.0；17.0；52.5；10.0；42.0；27.5；10.0；42.0；52.5；10.0；17.0；40.0；10.0；17.0；65.0；10.0；42.0；40.0；10.0；42.0；65.0；10.0；17.0；77.5；10.0；42.0；77.5；10.0；17.0；90.0；10.0；42.0；90.0

H02 4× M6×1-6H贯穿10；STEP为Ø5攻牙底孔；入口 局部X=10，向-X；局部XYZ 10.0；16.425378797540716；111.92537879754073；10.0；16.425378797540716；136.92537879754073；10.0；41.425378797540716；111.92537879754073；10.0；41.425378797540716；136.92537879754073

H03 2× M4×0.7-6H完整有效牙≥10；Ø3.3全径钻深12＋118°尖约0.99142；总钻深约12.99142；入口 局部Z=0，向+Z；局部XYZ 5.0；7.5；0.0；5.0；42.5；0.0

H04 2× Ø2.01全径深4.5＋118°尖约0.603865；总钻深约5.103865；入口 局部Z=0，向+Z；局部XYZ 5.0；17.5；0.0；5.0；32.5；0.0