

PACIENTE

MARIA ROSA JORQUERA

ID: 625124 | HC: 9693

Diagnóstico: Ca de Cuello de Útero

MÉDICO RESPONSABLE

Dr. José Luis Castilla

FÍSICO RESPONSABLE

Jorge Escobar

TRATAMIENTO

Aplicador Fletcher (Manchester)

DOSIS TOTAL PRESCRIPTA (PUNTO A)

3000 cGy

FUENTES UTILIZADAS — CS-137

POSICIÓN	N° SERIE	TIPO
F1	M2DR983	Amersham CDCSM2
F2	J5HF205	Amersham CDCJ5
F3	J5HF207	Amersham CDCJ5
F4	J3HF203	Amersham CDCSJ3
F5	J3HB438	Amersham CDCSJ3

ÓRGANOS A RIESGO

ÓRGANO	DOSIS RT EXTERNA	DOSIS BRAQUITERAPIA	DOSIS TOTAL
Vejiga	5494.1 cGy	1895.7 cGy	7390 cGy
Recto	5467.1 cGy	699.6 cGy	6167 cGy
Sigma	4996 cGy	_____ cGy	_____

DR. JOSÉ LUIS CASTILLA

FIRMA Y SELLO — MÉDICO RESPONSABLE

JORGE ESCOBAR

FIRMA — FÍSICO RESPONSABLE

PACIENTE
MARIA ROSA JORQUERADIAGNÓSTICO
Ca de Cuello de ÚteroMÉDICO
Dr. José Luis CastillaFÍSICO
Jorge Escobar

FECHA Y HORA DE COLOCACIÓN


11/05/2026, 09:15 hs

FECHA Y HORA DE EXTRACCIÓN

13/05/2026 a las 19:15 hs

Duración: 58 horas

ESQUEMA DE IMPLANTE — POSICIÓN DE FUENTES

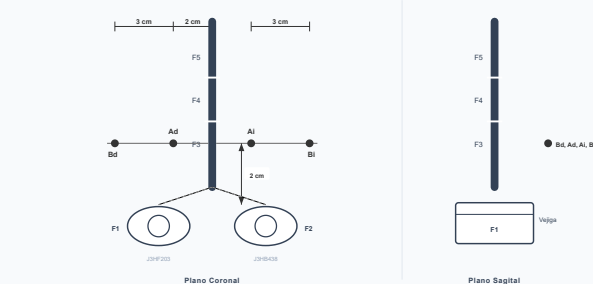

Fuentes Cs-137 CDCSJ (cuerpo) y CDCJ5 (ovoides). Escala 1:1.

* Las fuentes son Cs-137 CDCSJ (cuerpo) y CDCJ5 (ovoides). Escala 1:1.

DOSIS EN PUNTOS DE INTERÉS

PUNTO	CGY
Ad A derecho	3381.2 cGy
Ai A izquierdo	3000.0 cGy
Bd B derecho	1149.1 cGy
Bi B izquierdo	874.1 cGy
R Recto *	699.6 cGy
V Vejiga *	1895.7 cGy

* R y V localizados por el médico según referencias anatómicas.

ACTIVIDAD DE FUENTES A LA FECHA DE TRATAMIENTO

			VERIFICACIÓN — ECLIPSE TPS		
POSICIÓN	N° SERIE	ACTIVIDAD (MCI)	ECLIPSE (MCI)	ERROR %	ESTADO
F1	M2DR983	13.418	13.36	0.4%	✓ Aceptable
F2	J5HF205	37.151	37.02	0.4%	✓ Aceptable
F3	J5HF207	37.308	37.18	0.3%	✓ Aceptable
F4	J3HF203	22.626	22.55	0.3%	✓ Aceptable
F5	J3HB438	23.131	23.05	0.4%	✓ Aceptable


Sistema de puntos según Manchester (Tod & Meredith, 1938, 1953). Se adjuntan curvas de isodosis correspondientes a los planos de las placas localizadoras (anterior y lateral). La escala del diagrama es 1:1.

DR. JOSÉ LUIS CASTILLA

FIRMA Y SELLO — MÉDICO RESPONSABLE

JORGE ESCOBAR

FIRMA — FÍSICO RESPONSABLE

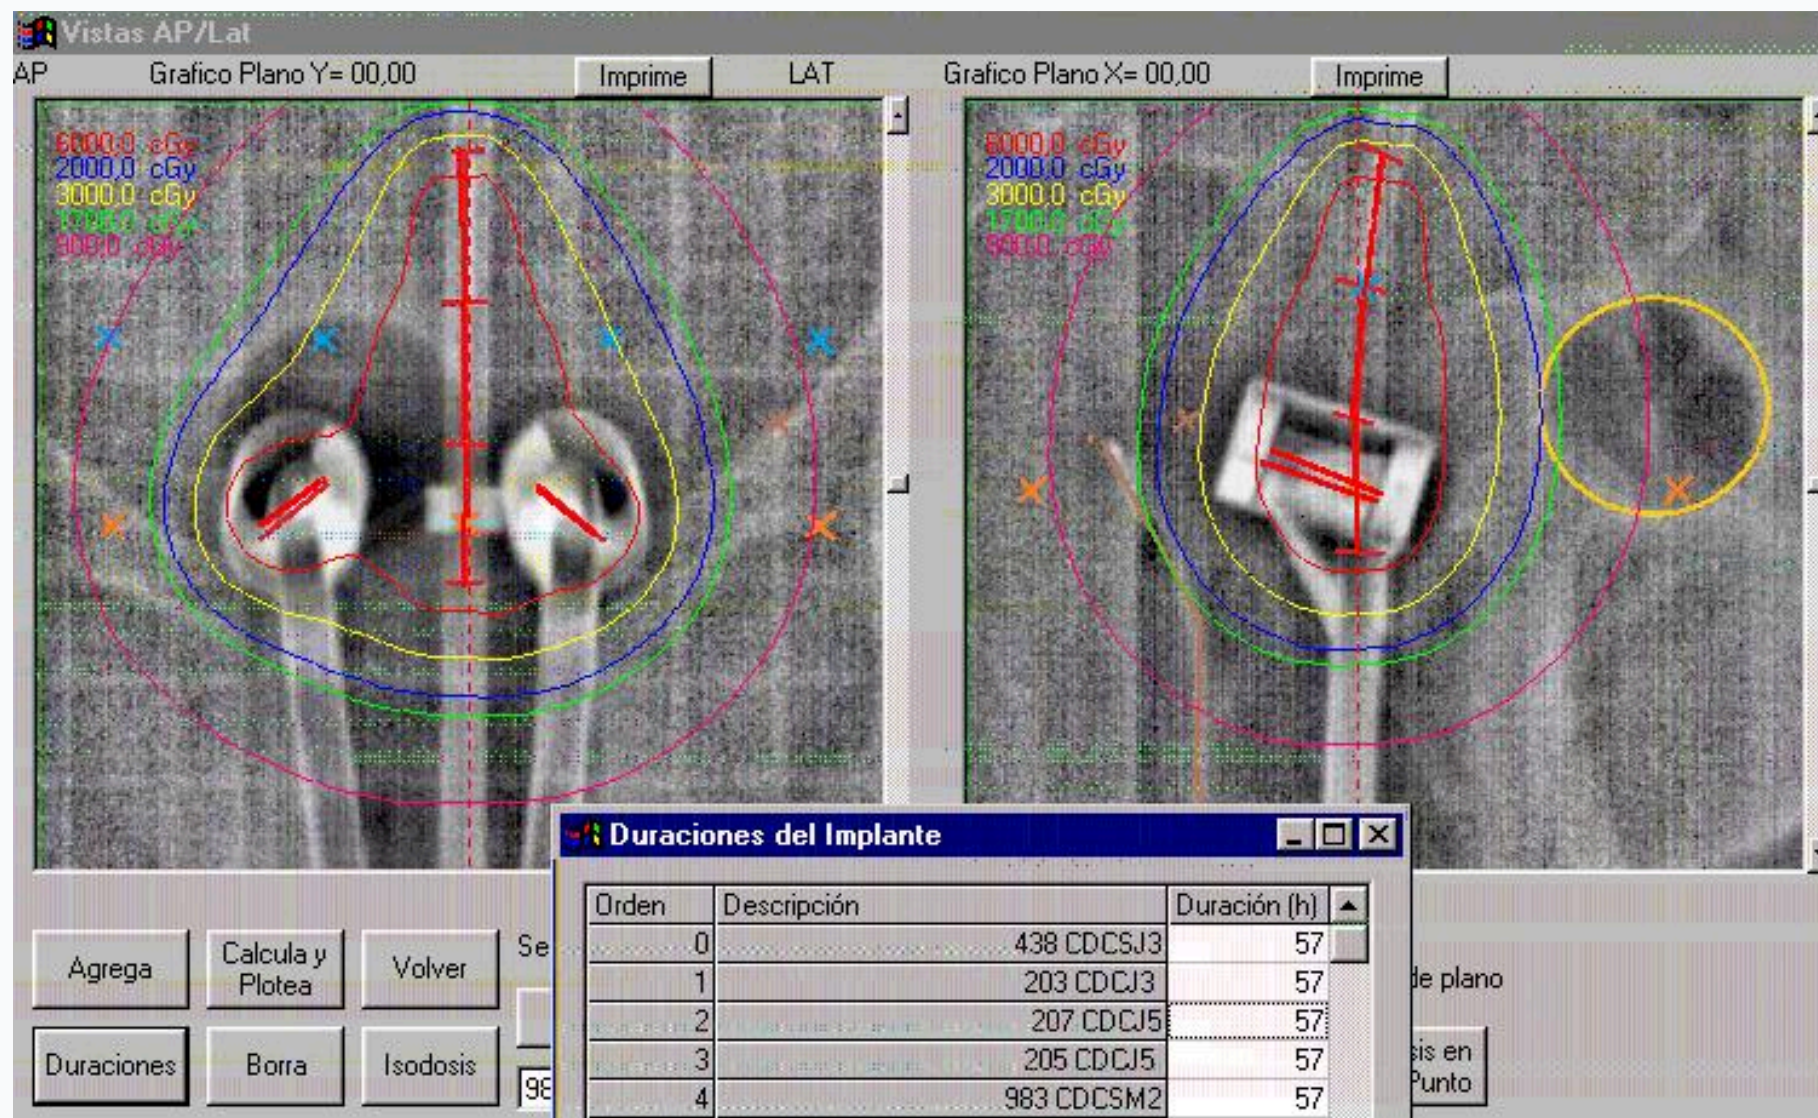

Curvas de isodosis en planos coronal y sagital para los distintos puntos de prescripción A, y B, recto y vejiga.

