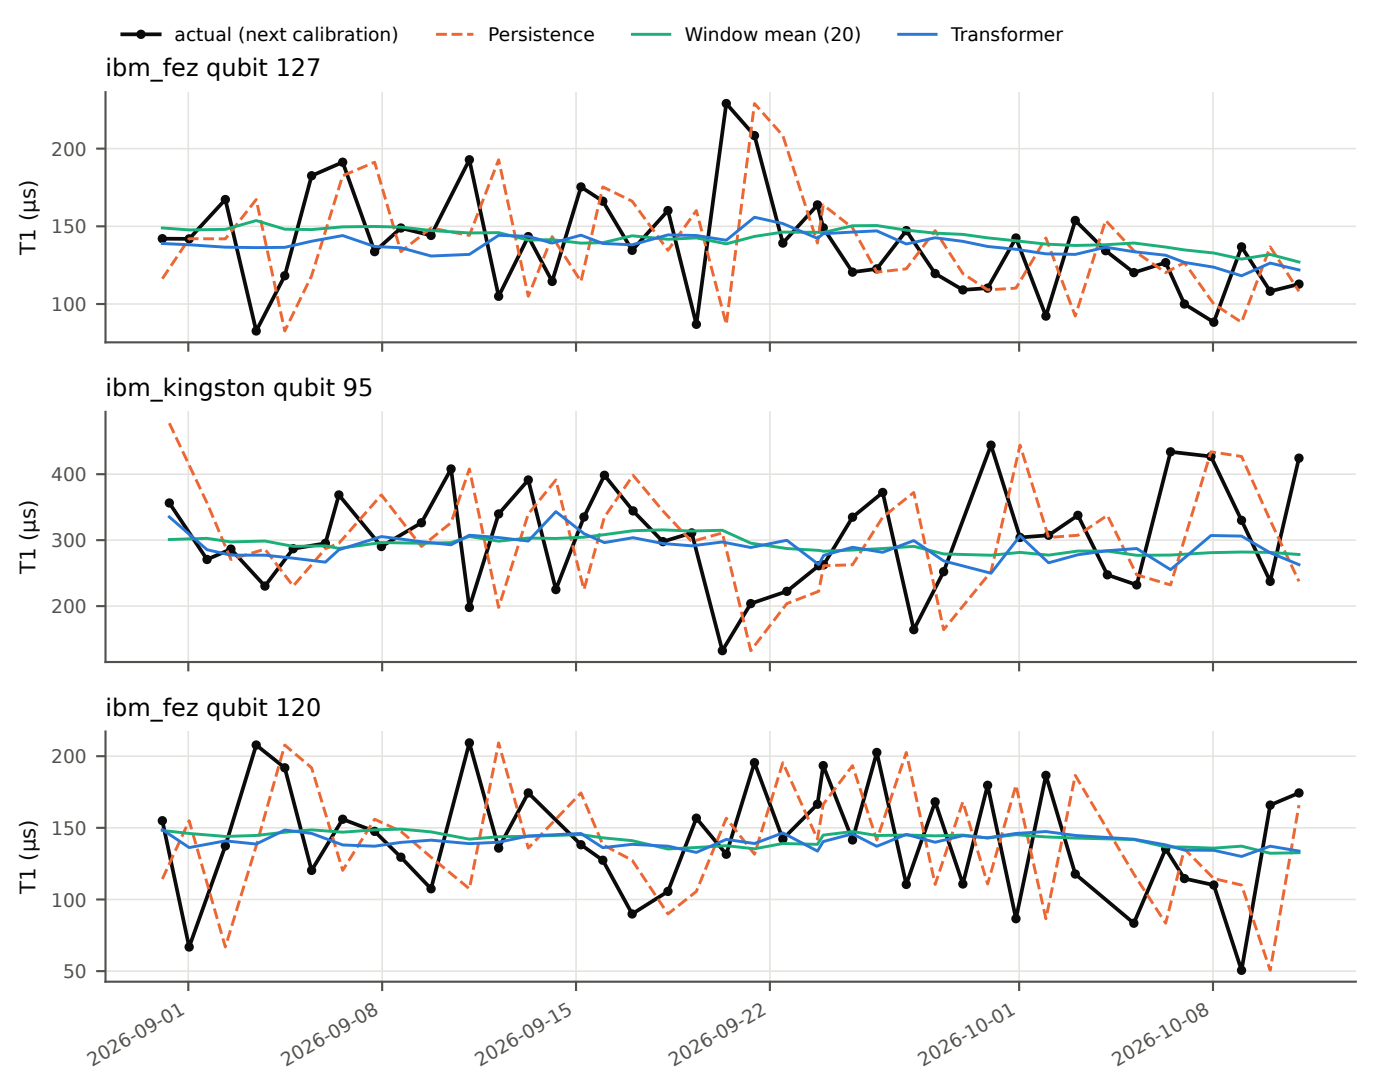
actual (next calibration)
Persistence
Window mean (20)
Transformer
ibm_fez qubit 127
ibm_kingston qubit 95
ibm_fez qubit 120
T1 (µs)
2026-09-01
2026-09-08
2026-09-15
2026-09-22
2026-10-01
2026-10-08