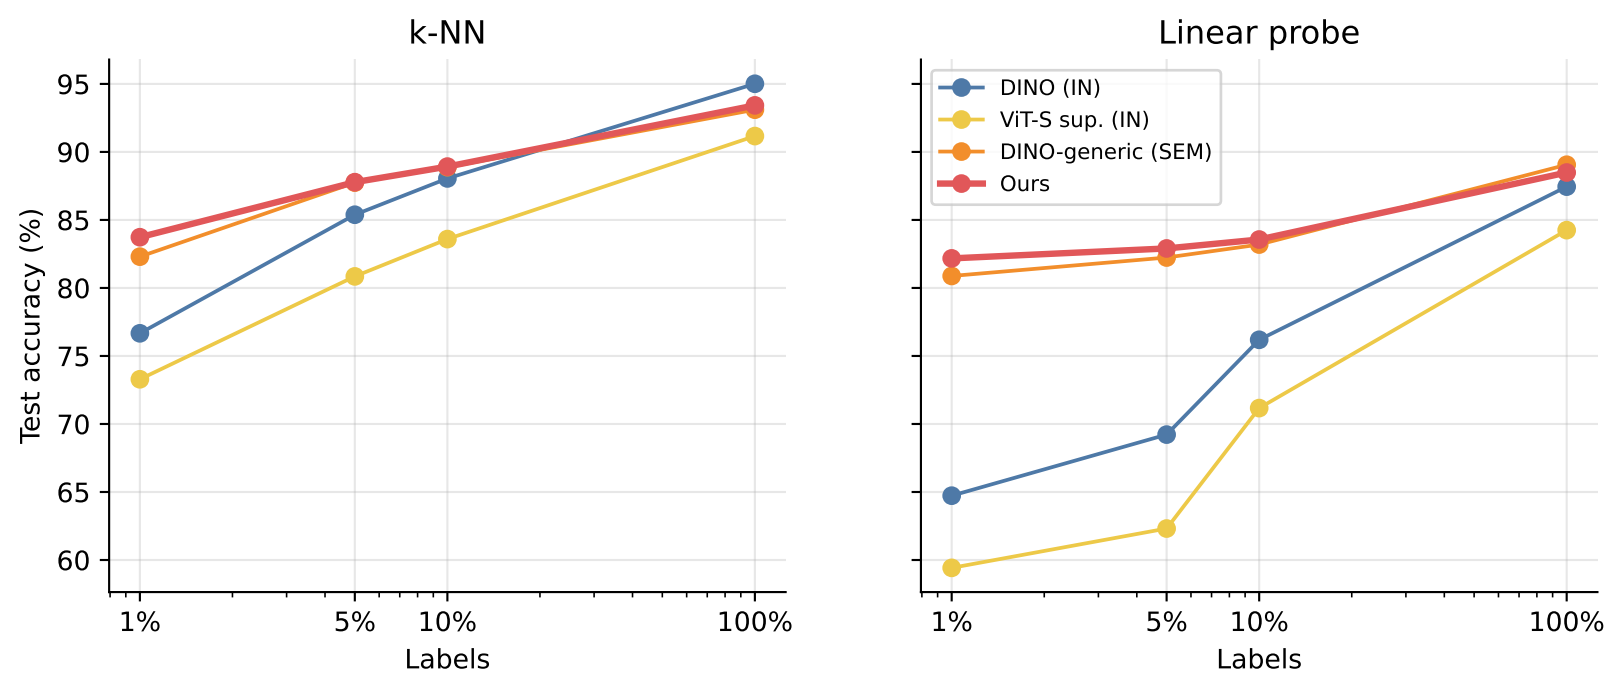
k-NN
Linear probe
Test accuracy (%)
95
90
85
80
75
70
65
60
1%
5%
10%
100%
Labels
DINO (IN)
ViT-S sup. (IN)
DINO-generic (SEM)
Ours