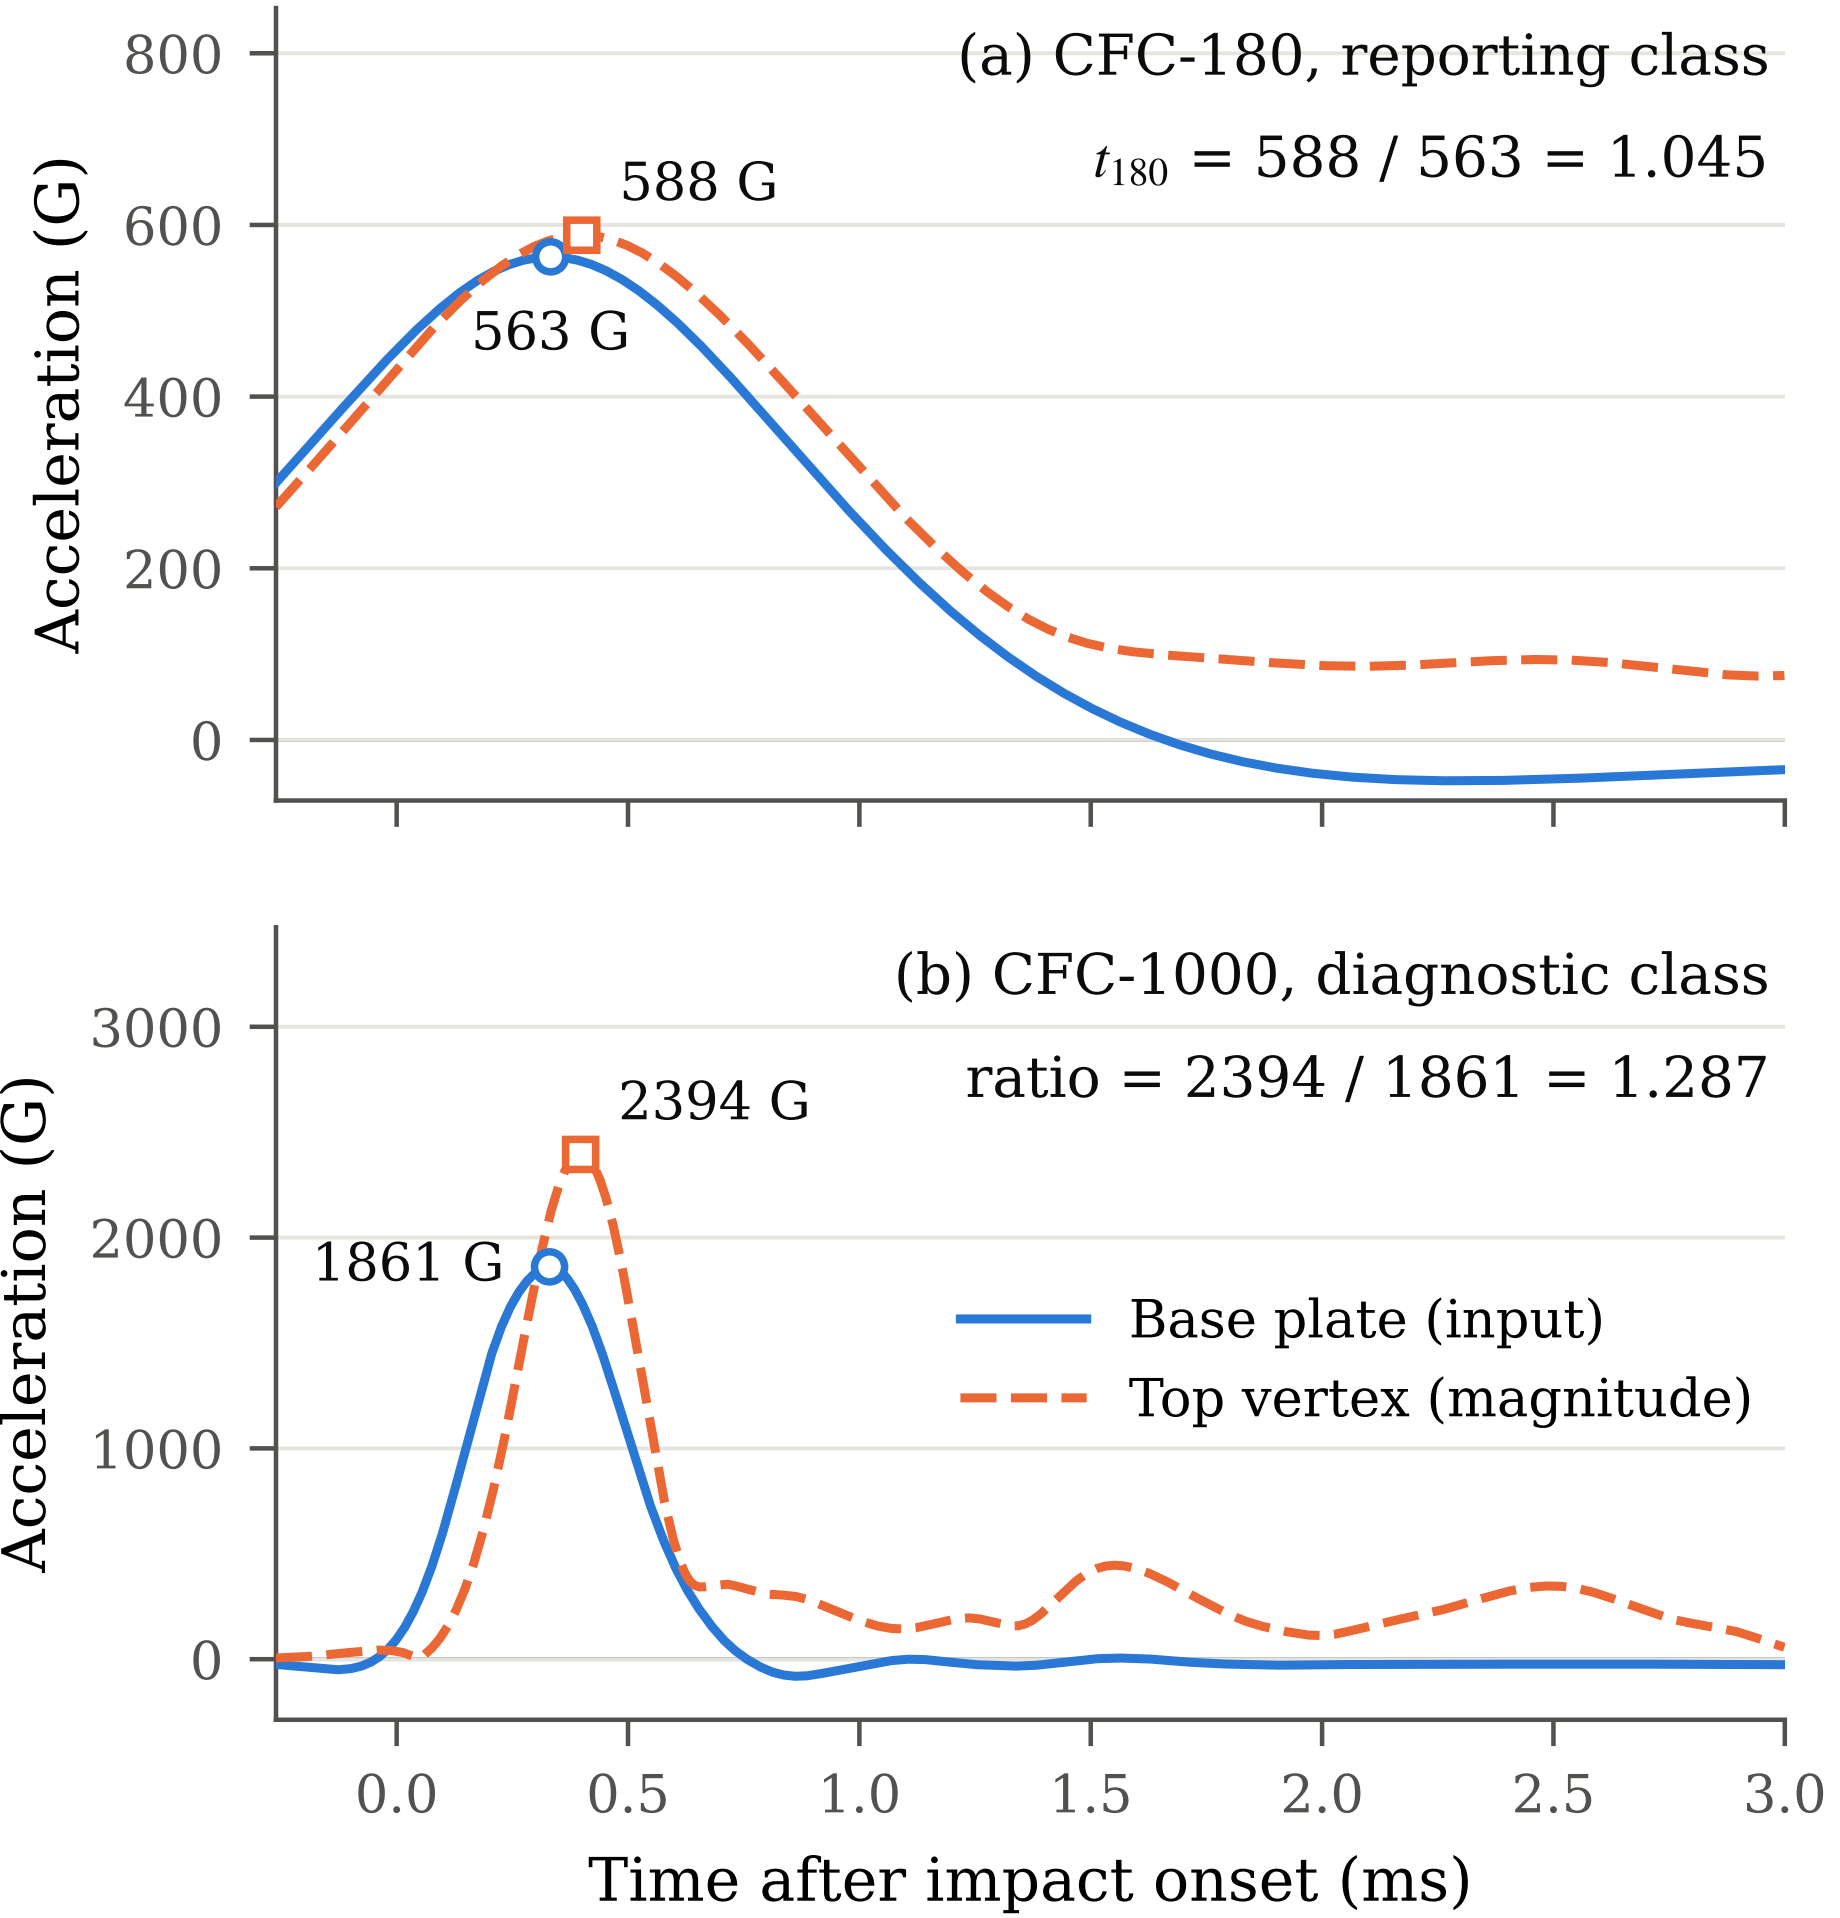
(a) CFC-180, reporting class
t_{180} = 588 / 563 = 1.045
588 G
563 G
Acceleration (G)
800
600
400
200
0
(b) CFC-1000, diagnostic class
ratio = 2394 / 1861 = 1.287
2394 G
1861 G
Base plate (input)
Top vertex (magnitude)
Acceleration (G)
3000
2000
1000
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Time after impact onset (ms)