

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

F0421025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Device	ASPIRADOR	MARCA: Brand	DRIVE
MODELO: Model	18600N	SERIE: Serial	6A11080740
NÚMERO ACTIVO: Institute Inventory	544956	UBICACIÓN: Location	MEDICINA INTERNA

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	147947	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-10-22	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-10-22
TEMPERATURA Inicial: Temperature	26.1 °C	Final: End	26.1 °C
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	58 %	Final: End	58 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE		

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058
CIUDAD: City	PEREIRA
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88
Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
 Metrólogo


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
 Coordinador de Prestación de Servicios

 Av 30 de Agosto Nro 87- 298

 prestacionservicio@husj.gov.co

 (6) 35154 66

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
 This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
 The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
 The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
 The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
 Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
 The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN DE VACÍO

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
20	18.40	-1.60	$\pm$	2.89
40	37.95	-2.05	$\pm$	2.89
60	57.50	-2.50	$\pm$	2.89

Unidad de la Medición
KPa

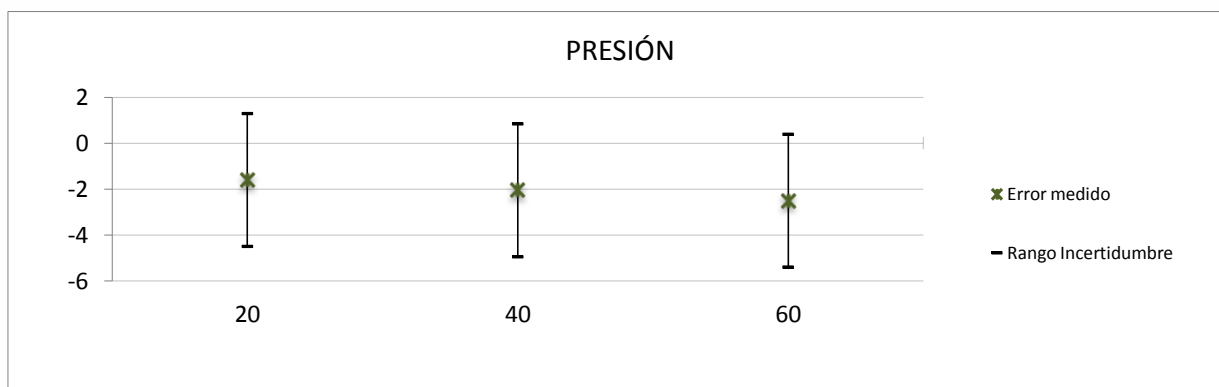

FIN DEL CERTIFICADO



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66