

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M1740925

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO: Device	CENTRÍFUGA	MARCA: Brand	CLAY ADAMS
MODELO: Model	DYNAC III	SERIE: Serial	4930006
Inventario Institución: Institute Inventory	544860		

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Tacómetro	FLUKE	461995	Q681683	2025-09-09

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN							
Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-09-29		Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-09-29			
TEMPERATURA Inicial: Temperature	23 °C	Final: End	23 °C	HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	65 %	Final: End	66 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	LABORATORIO						

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE Institution	
TELÉFONO: 6063119058 Telephone	CIUDAD: PEREIRA City
DIRECCIÓN: Cra 4 #24-88 Address	Correo: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
Métrólogo
Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
 This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
 The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
 The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
 The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
 Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
 The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k=2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

VELOCIDAD

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
1500	1492,86	-7,14	$\pm$ 6,16	RPM
3000	2991,57	-8,43	$\pm$ 6,03	

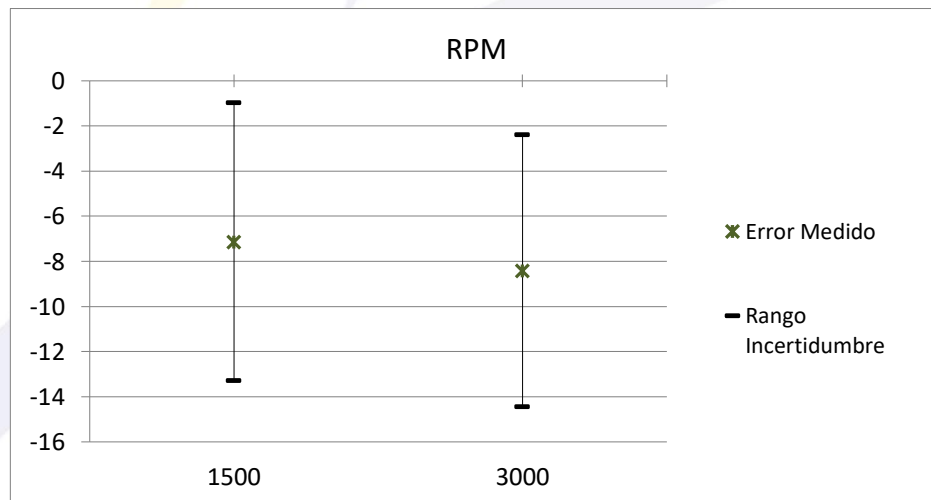

FIN DEL CERTIFICADO