

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

J0701025

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO: Device	CENTRÍFUGA	MARCA: Brand	EPPENDORF AG
MODELO: Model	5702	SERIE: Serial	5702EO839479
Inventario Institución: Institute Inventory	574594		

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Tacómetro	FLUKE	461995	Q681683	2025-09-09

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN					
Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-10-14		Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-10-14	
TEMPERATURA Inicial: Temperature	23 °C	Final: End	23 °C	HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	65 %
				Final: End	66 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	PATOLOGÍA				

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN: Institution	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: Telephone	6063119058
DIRECCIÓN: Address	Cra 4 #24-88
CIUDAD: City	PEREIRA
Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó



JORGE CARDONA IDARRAGA

Cooperativa de Prestadores de Salud del Risaralda
Avenida 30 de Agosto 87 298 Pereira Risaralda
Pereira (6) 3272070
www.coodesuris.com

Metrología
Metrológico



MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura k=2
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor k = 2

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

VELOCIDAD

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
1500	1496,29	-3,71	± 6,67	RPM
4000	3997,20	-2,80	± 5,92	

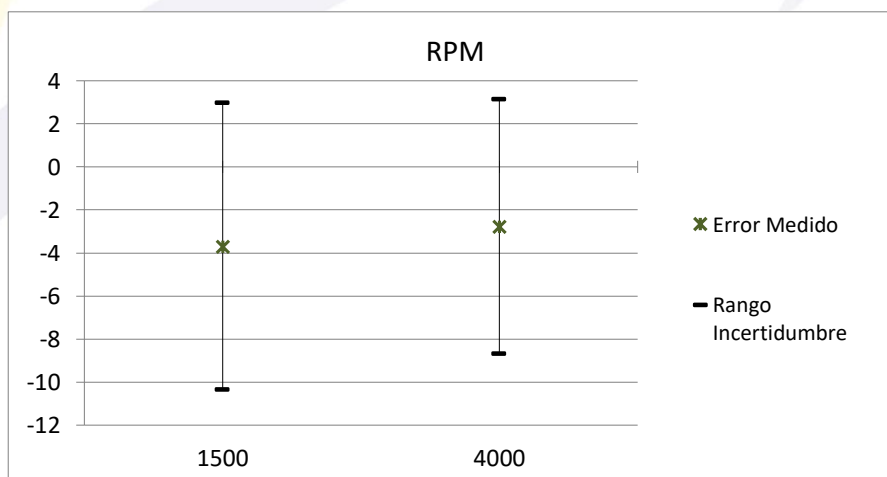

FIN DEL CERTIFICADO