

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M0551025

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO: Device	CONCENTRADOR DE OXÍGENO	MARCA: Brand	JIANGSU KONSUNG MEDICAL
MODELO: Model	KSOC-5	SERIE: Serial	Ma20103740040
Inventario Institución: Institute Inventory	573125		

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Analizador de Flujo de Gases	Fluke Biomedical	VT PLUS HF	147947	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN					
Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-10-07		Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-10-07	
TEMPERATURA Inicial: Temperature	23 °C	Final: End	23 °C	HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	61 %
				Final: End	61 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	URGENCIAS				

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88
CIUDAD: City	PEREIRA
Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: LM-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
Métrólogo
Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador del Laboratorio
Laboratory Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris.
 This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
 The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
 The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
 The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia.
 Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern.

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$.
 The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k=2$.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

FLUJO

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
1	1,38	0,38	$\pm$ 0,31	LPM
3	3,31	0,31	$\pm$ 0,30	
5	5,55	0,55	$\pm$ 0,44	

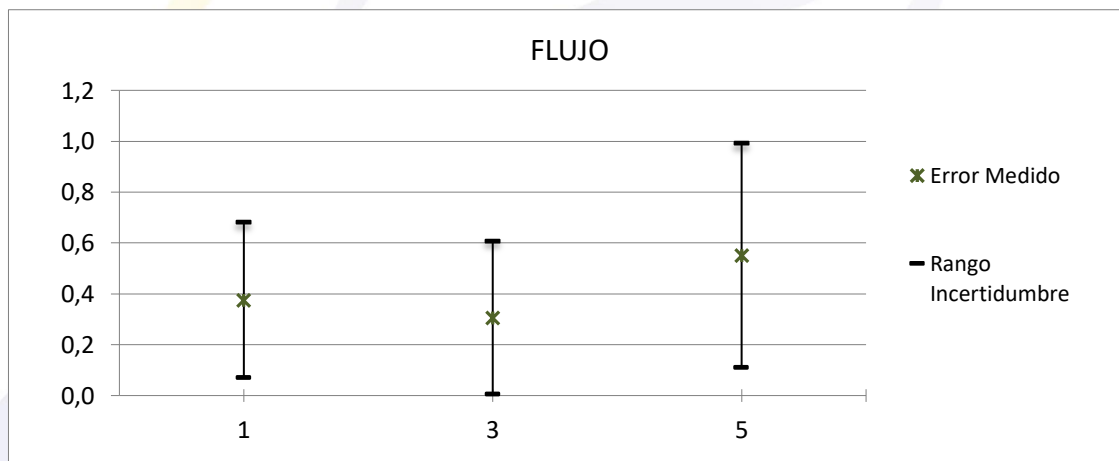

CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO

Flujo de Prueba (LPM)	Medición Promedio	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
3,0	91,35	$\pm$ 0,92	% O ₂

FIN DEL CERTIFICADO