

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M2201025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: DESFIBRILADOR
Device

MARCA: MINDRAY
Brand

MODELO: BENEHEART D3
Model

SERIE: EL-65026398
Serial

Inventario Institución: 549363
Institute Inventory

UBICACIÓN: UNIDAD CRITICA OBSTETRICA
Location

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Analizador de desfibriladores	Fluke Biomedical	IMPULSE 6000D	2268017	2025-09-08

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: 2025-10-28
Date of Receipt

Fecha Calibración: 2025-10-28
Date of Calibration

TEMPERATURA Inicial: 22.1 °C **Final:** 22.5 °C
Temperature End

HUMEDAD Rel. Inicial: 60 % **Final:** 60 %
Humidity End

Lugar de Calibración: HOSPITAL SAN JORGE
Place of Calibration

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
Institution

TELÉFONO: (606)3119058
Telephone

CIUDAD: PEREIRA
City

DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88
Address

Correo: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co
E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris.
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia.
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern.


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$.
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$.

El error máximo permitido es tomado de: Service Manual o NTC-IEC60601-2-4.
The maximum error allowed is taken from: Service Manual or NTC-IEC60601-2-4.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

ENERGÍA

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
30	27.40	-2.60	$\pm$ 0.72	Joules
100	90.20	-9.80	$\pm$ 0.94	
200	181.20	-18.80	$\pm$ 1.31	
300	273.90	-26.10	$\pm$ 2.29	

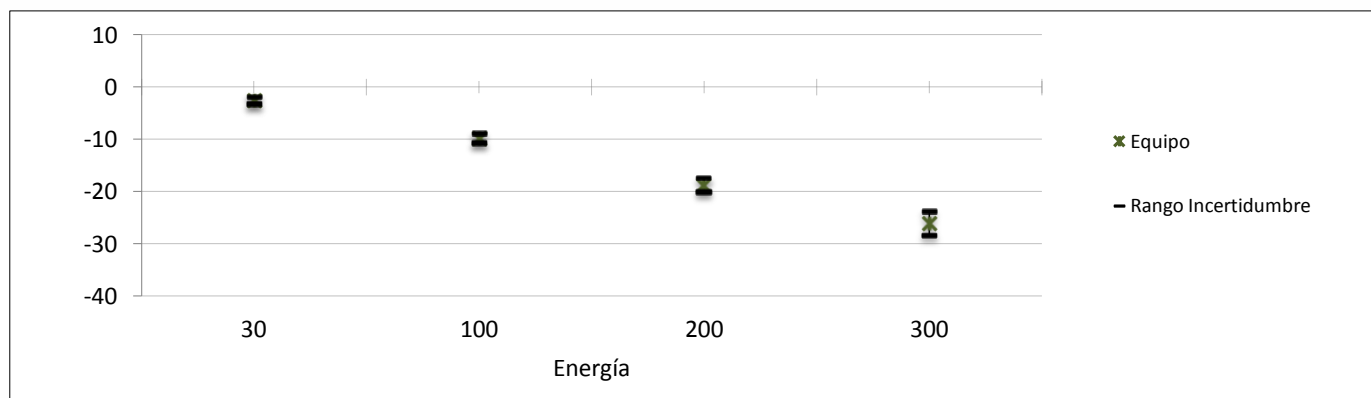

TIEMPO DE SINCRONISMO


Medición Promedio	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
32.75	$\pm$ 1.50	ms



FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
60	60.00	0.00	±	0.82
100	100.00	0.00	±	0.82
160	160.00	0.00	±	0.82

Unidad de la Medición
BPM

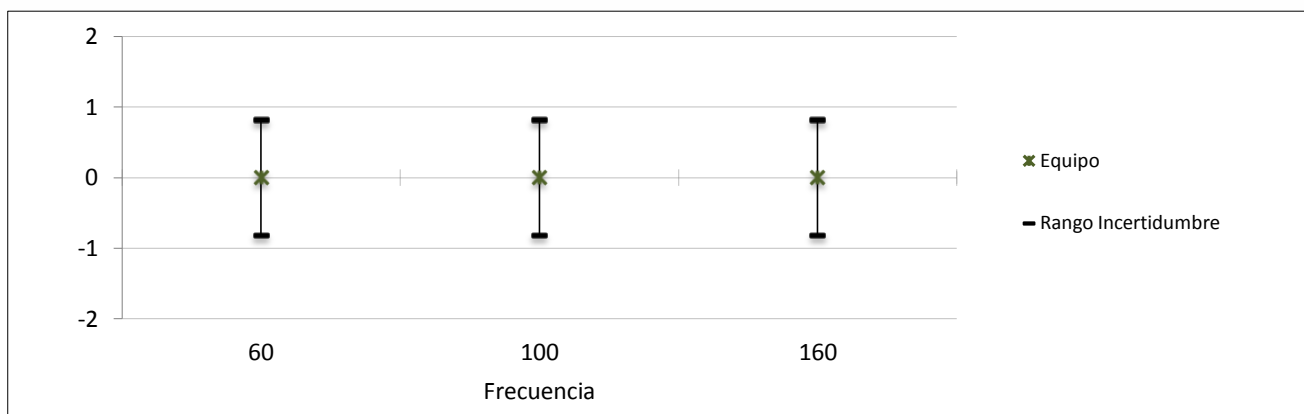

FIN DEL CERTIFICADO