

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

F0431025

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO: Device	DESFIBRILADOR	MARCA: Brand	MINDRAY	
MODELO: Model	BENEHEART D30	SERIE: Serial	FP5-4A012261	
Inventario Institución: Institute Inventory	571095	UBICACIÓN: Location	MEDICINA INTERNA	

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Analizador de desfibriladores	Fluke Biomedical	IMPULSE 6000D	2268017	2025-09-08

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN				
Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-10-23	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-10-23	
TEMPERATURA Inicial: Temperature	22 °C	Final: End	22 °C	
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	61 %	Final: End	61 %	
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE			

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058
CIUDAD: City	PEREIRA
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88
Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

El error máximo permitido es tomado de: Service Manual o NTC-IEC60601-2-4
The maximum error allowed is taken from: Service Manual or NTC-IEC60601-2-4

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

ENERGÍA

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
30	28.80	-1.20	$\pm$ 0.72	Joules
100	97.40	-2.60	$\pm$ 0.94	
200	195.30	-4.70	$\pm$ 1.31	
300	291.30	-8.70	$\pm$ 2.29	

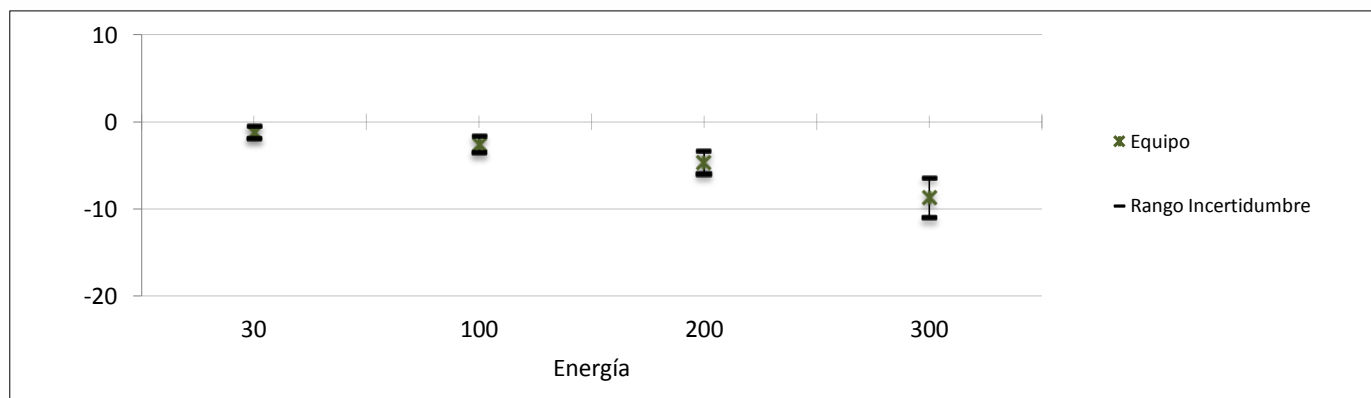

TIEMPO DE SINCRONISMO


Medición Promedio	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
31.50	$\pm$ 1.73	ms



FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
60	60.00	0.00	±	0.82
100	100.00	0.00	±	0.82
160	160.00	0.00	±	0.82

Unidad de la Medición
BPM

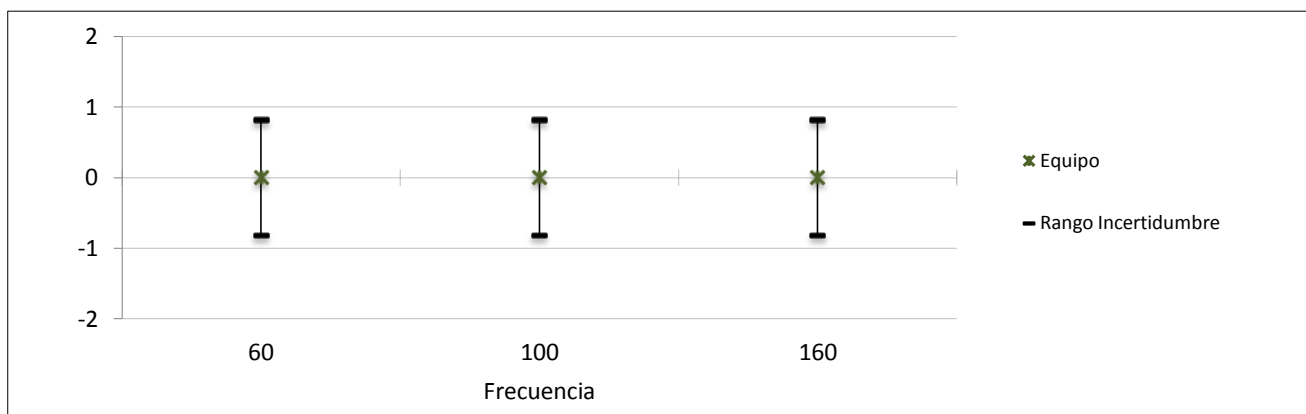

FIN DEL CERTIFICADO