

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M3611125

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO: Device	ECÓGRAFO	MARCA: Brand	MINDRAY
MODELO: Model	Z60	SERIE: Serial	HF9-36004001
Inventario Institución: Institute Inventory	572050		

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Variable
PHANTOM DE ULTRASONIDO	CIRS	PHANTOM 55	D-5363-2	LONG., ÁREA, VOLUMEN
PHANTOM DE ULTRASONIDO	CIRS	PHANTOM 55A	D-5394-2	LONGITUD

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN					
Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-11-26		Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-11-26	
TEMPERATURA Inicial: Temperature	25 °C	Final: End	25 °C	HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	58 %
				Final: End	58 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	URGENCIAS				

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE Institution	
TELÉFONO: (606)3119058 Telephone	CIUDAD: PEREIRA City
DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88 Address	Correo: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA

Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
 This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
 The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
 The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
 The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
 Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
 The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


TRANSDUCTOR CONVEXO LONGITUD ENTRE FILAMENTOS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
5	4.98	-0.03	$\pm$	0.07
10	9.98	-0.03	$\pm$	0.07
20	19.95	-0.05	$\pm$	0.08

Unidad de medida: mm

Rango Calibración Equipo: 5 a 20

Resolución del equipo: 0.10 mm

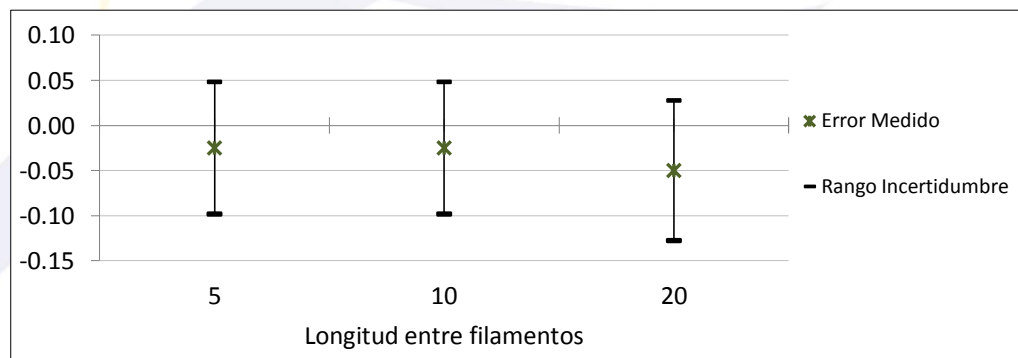


LONGITUD EN FIGURAS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
30	30.03	0.02	±	0.07
54	54.08	0.08	±	0.10

Unidad de medida: mm

Rango de Calibración Equipo: 30 a 54

Resolución del equipo: 0.10 mm

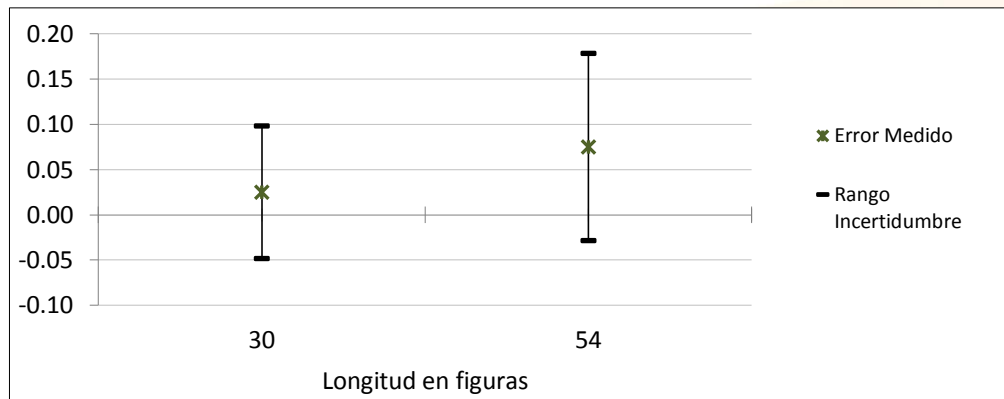

PERÍMETRO EN FIGURAS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
43.982	44.575	0.593	±	0.118

Unidad de medida: mm

Resolución del equipo: 0.1 mm

ÁREA EN FIGURAS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
1.414	1.450	0.036	±	0.084

Unidad de medida: cm²

Resolución del equipo: 0.01 cm²


TRANSDUCTOR FLAT
LONGITUD ENTRE FILAMENTOS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
5	4.98	-0.03	±	0.07
10	9.93	-0.07	±	0.07
20	19.98	-0.02	±	0.13

Unidad de medida: mm

Rango Calibración Equipo: 5 a 20

Resolución del equipo: 0.10 mm

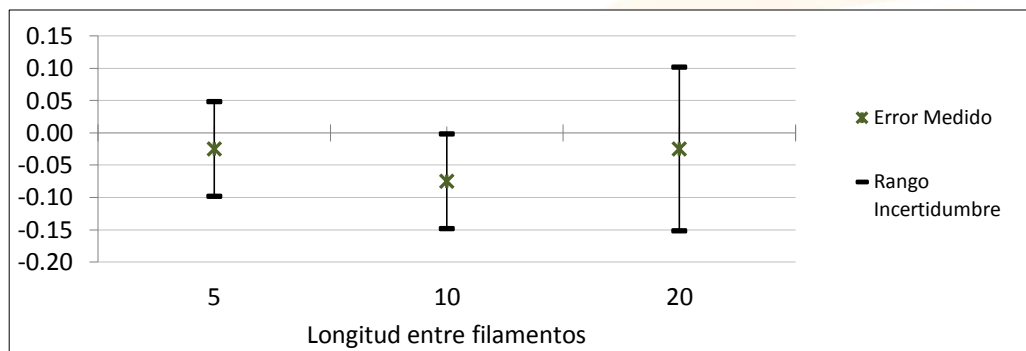


LONGITUD EN FIGURAS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
30	30.00	0.00	±	0.09
54	54.40	0.40	±	0.20

Unidad de medida: mm

Rango de Calibración Equipo: 30 a 54

Resolución del equipo: 0.10 mm

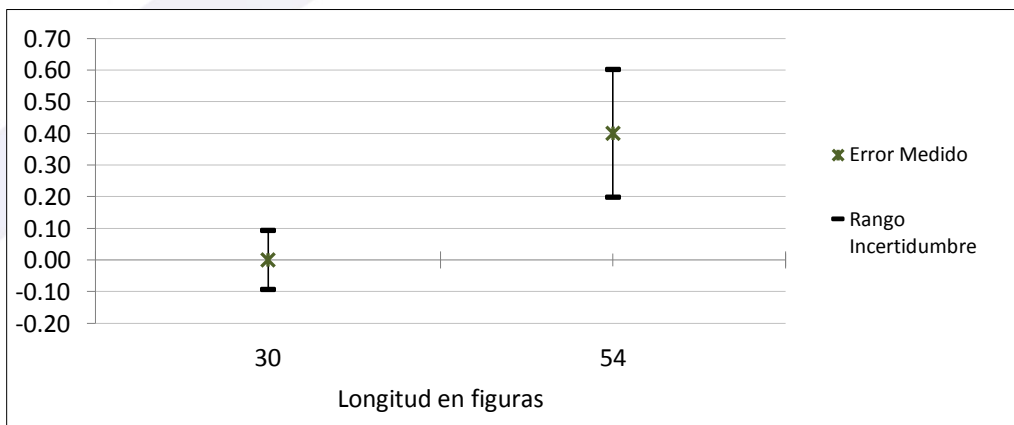

PERÍMETRO EN OBJETOS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
43.982	44.100	0.118	±	0.210

Unidad de medida: mm

Resolución del equipo: 0.1 mm

ÁREA EN FIGURAS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
1.414	1.415	0.001	±	0.082

Unidad de medida: cm²

Resolución del equipo: 0.01 cm²

TRANSDUCTOR TRANSVAGINAL


LONGITUD ENTRE FILAMENTOS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
5	5.050	0.050	±	0.097
10	10.150	0.150	±	0.121
20	20.250	0.250	±	0.121

Unidad de medida: mm

Rango Calibración Equipo: 5 a 20

Resolución del equipo: 0.10 mm

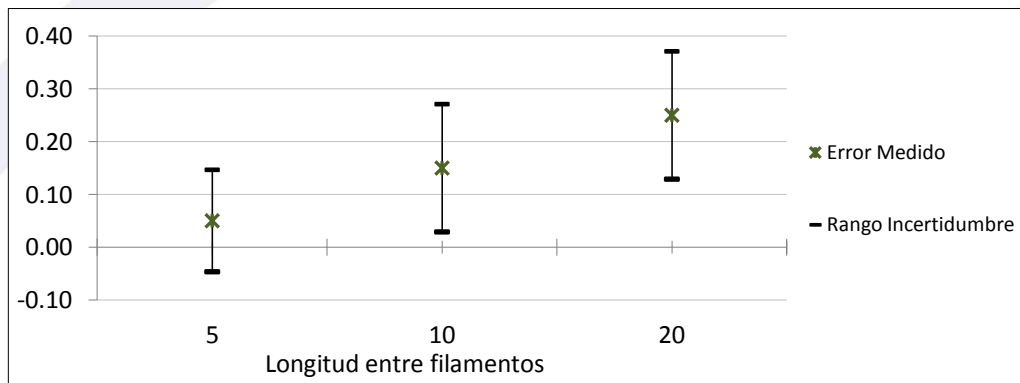


LONGITUD EN FIGURAS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
30	30.300	0.300	±	0.183
54	53.975	-0.025	±	0.093

Unidad de medida: mm

Rango de Calibración Equipo: 30 a 54

Resolución del equipo: 0.10 mm

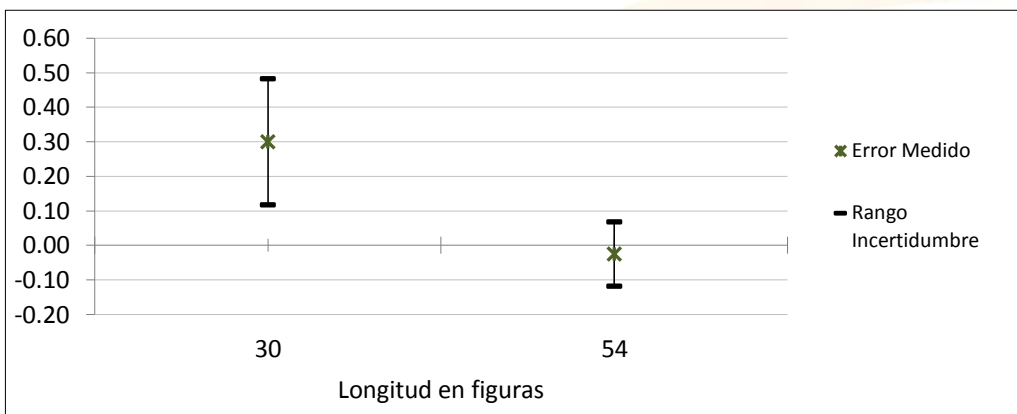

PERÍMETRO EN OBJETOS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
43.982	44.525	0.543	±	0.202

Unidad de medida: mm

Resolución del equipo: 0.1 mm

ÁREA EN FIGURAS

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
1.414	1.428	0.014	±	0.082

Unidad de medida: cm²

Resolución del equipo: 0.01 cm²

FIN DEL CERTIFICADO