

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

J1411125

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Device	ELECTROBISTURÍ	MARCA: Brand	VALLEYLAB
MODELO: Model	FORCE FX	SERIE: Serial	SF0H07640A
Inventario Institución: Institute Inventory	544961	UBICACIÓN: Location	QUIRÓFANO

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE ELECTROBISTURÍ	FLUKE BIOMEDICAL	QA-ES II	200405	2024-08-28

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-11-19	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-11-19
TEMPERATURA Inicial: Temperature	24,7 °C	Final: End	24,7 °C
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	59 %	Final: End	59 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE		

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058	CIUDAD: City	PEREIRA
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88	Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist

Revisó


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$


RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

POTENCIA DE CORTE (W)

PURE

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	Error	Incertidumbre Expandida
20	17,0	-3,0	$\pm 1,42$
50	44,8	-5,3	$\pm 1,50$
150	133,0	-17,0	$\pm 2,66$
300	260,3	-39,8	$\pm 4,70$

Factor de Cresta
Medición Promedio
1,70
Resistencia de carga
300 Ω

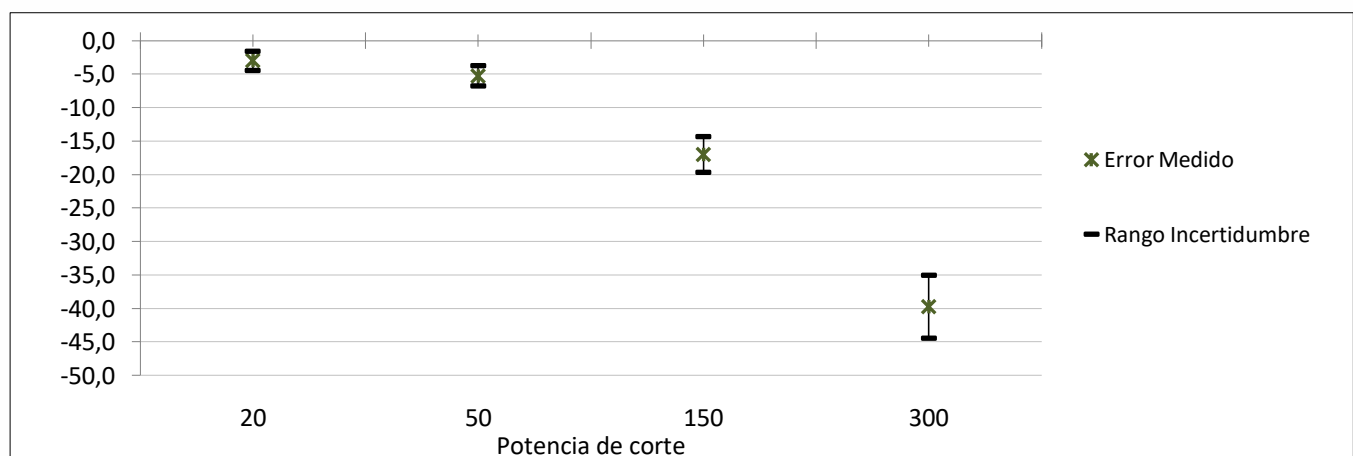


POTENCIA DE COAGULACIÓN (W)

FULGURATE

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
20	17,3	-2,8	±	1,50
40	34,0	-6,0	±	1,64
90	78,5	-11,5	±	2,60
120	103,5	-16,5	±	3,54

Factor de Cresta
Medición Promedio
6,48
Resistencia de carga
300 Ω

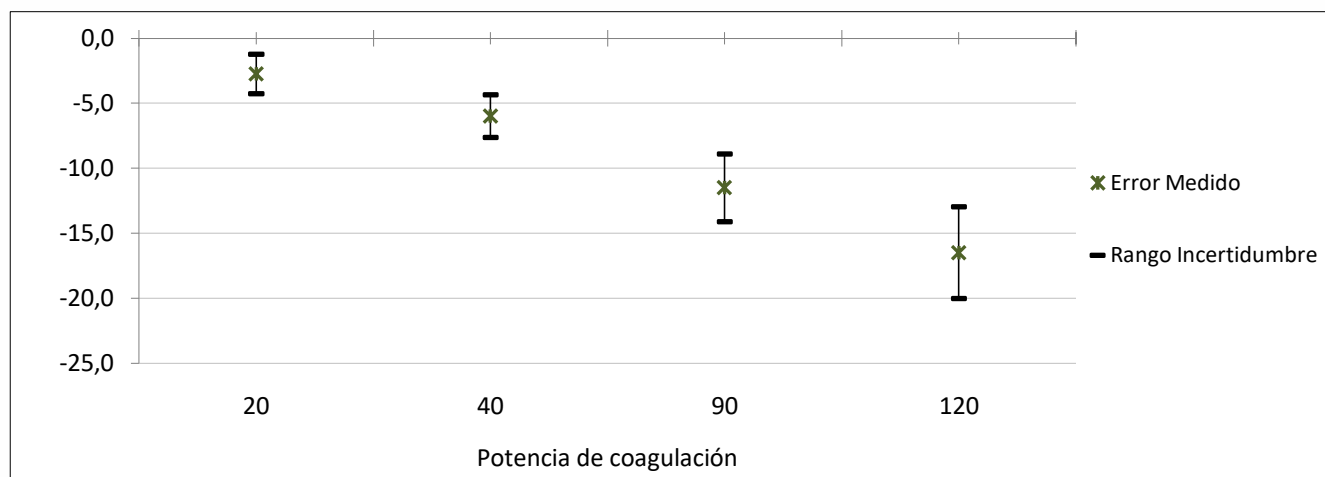

POTENCIA DE COAGULACIÓN - BIPOLAR (W)

STANDARD

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
20	16,8	-3,3	±	1,50
50	41,5	-8,5	±	2,60

Factor de Cresta
Medición Promedio
1,60
Resistencia de carga
100 Ω

FIN DEL CERTIFICADO