

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

J1421125

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: ELECTROBISTURÍ

Device

MARCA: BOVIE

Brand

MODELO: IDS-310

Model

SERIE: BV0232018

Serial

Inventario Institución: 572042

Institute Inventory

UBICACIÓN: BLOQUE QUIRÚRGICO

Location

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE ELECTROBISTURÍ	FLUKE BIOMEDICAL	QA-ES II	200405	2024-08-28

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: 2025-11-19

Date of Receipt

Fecha Calibración: 2025-11-19

Date of Calibration

TEMPERATURA Inicial: 24,8 °C **Final:** 24,8 °C

Temperature

End

HUMEDAD Rel. Inicial: 62 % **Final:** 62 %

Humidity

End

Lugar de Calibración: QUIRÓFANO

Place of Calibration

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

Institution

TELÉFONO: (606)3119058

Telephone

CIUDAD: PEREIRA

City

DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88

Address

Correo: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró



JORGE CARDONA IDARRAGA

Metrólogo

Metrologist

Revisó



MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$


RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

POTENCIA DE CORTE (W)

PURE

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	Error	Incertidumbre Expandida
20	19,5	-0,5	$\pm 1,53$
50	48,0	-2,0	$\pm 1,42$
150	143,0	-7,0	$\pm 2,54$
300	280,5	-19,5	$\pm 4,71$

Factor de Cresta
Medición Promedio
1,60
Resistencia de carga
300 Ω

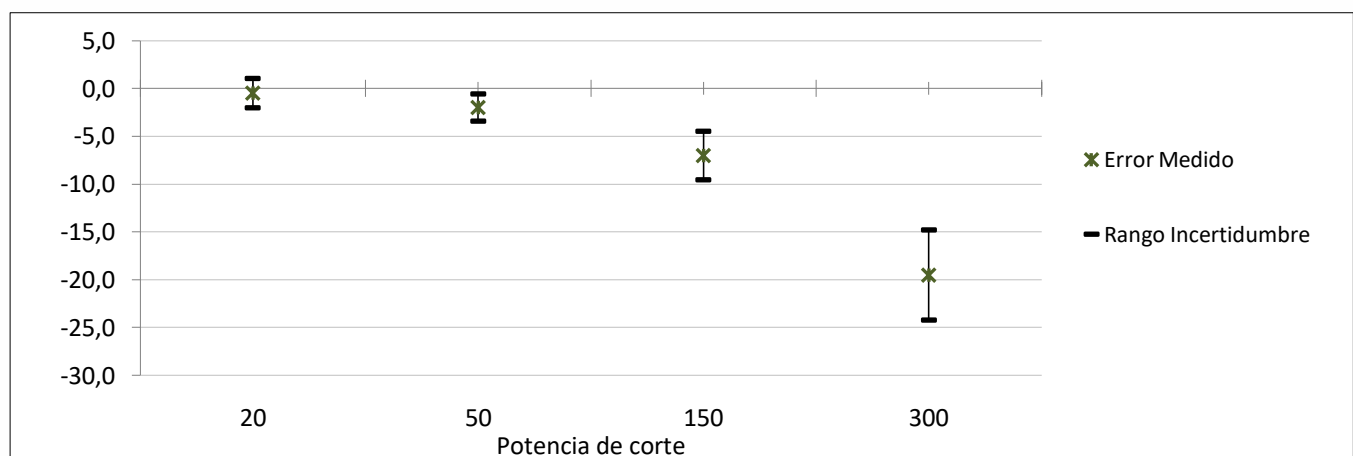


POTENCIA DE COAGULACIÓN (W)

PINPOINT

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
20	19,0	-1,0	±	1,42
40	39,0	-1,0	±	1,42
90	85,0	-5,0	±	2,54
120	114,0	-6,0	±	3,50

Factor de Cresta
Medición Promedio
3,20
Resistencia de carga
500 Ω

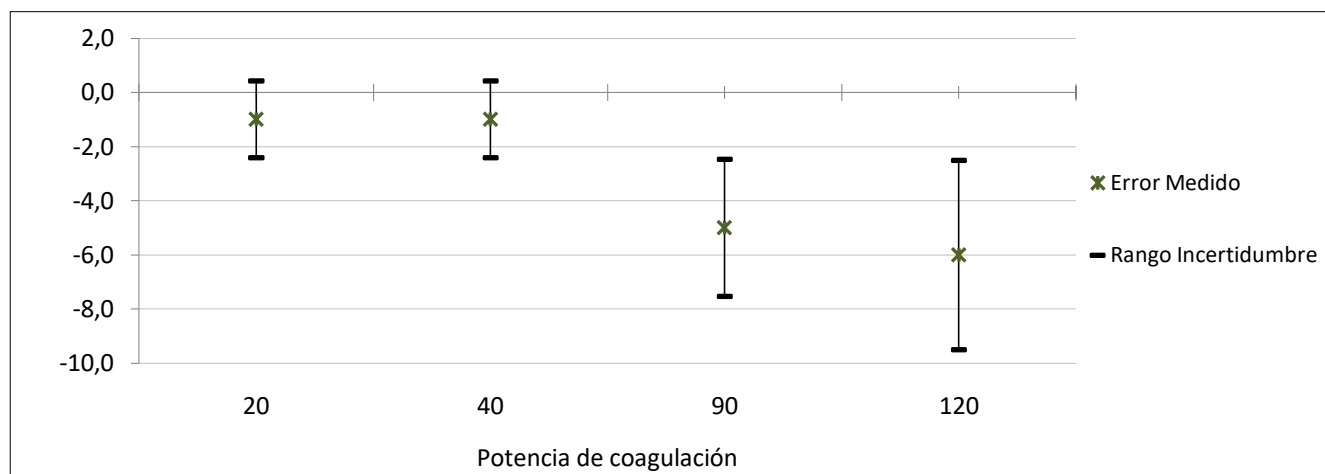

POTENCIA DE COAGULACIÓN - BIPOLAR (W)

STANDARD

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
20	19,0	-1,0	±	1,42
50	47,0	-3,0	±	2,54

Factor de Cresta
Medición Promedio
1,50
Resistencia de carga
50 Ω

FIN DEL CERTIFICADO