

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

J2021125

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO:	ELECTROESTIMULADOR	MARCA:	INTENSITY	
Device		Brand		
MODELO:	TWIN STIM III	SERIE:	SZ5210430625	
Model		Serial		
Inventario Institución:	572740	UBICACIÓN:	TERAPIA RESPIRATORIA	
Institute Inventory		Location		

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Osciloscopio	Fluke Biomedical	124	24750207	2025-08-20

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN															
Fecha Recepción:		2025-11-28			Fecha Calibración:		2025-11-28								
Date of Receipt					Date of Calibration										
TEMPERATURA Inicial:		24,1 °C		Final:		24,1 °C		HUMEDAD Rel. Inicial:		63 %		Final:		63 %	
Temperature				End				Humidity				End			
Lugar de Calibración:		HOSPITAL SAN JORGE													
Place of Calibration															

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
Institution	
TELÉFONO:	(606)3119058
Telephone	
DIRECCIÓN:	CRA 4 # 24-88
Address	
CIUDAD:	PEREIRA
City	
Correo:	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co
E-mail	

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrologo
Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$


RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

CANAL

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	Error	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
25	24,07	-0,93	±	0,25	mA
50	49,22	-0,78	±	0,28	
75	74,71	-0,29	±	0,28	
100	99,22	-0,78	±	0,36	

FRECUENCIA

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
1	1,00	0,00	±	0,82	pulse/min
2	2,00	0,00	±	0,82	
5	5,00	0,00	±	0,82	

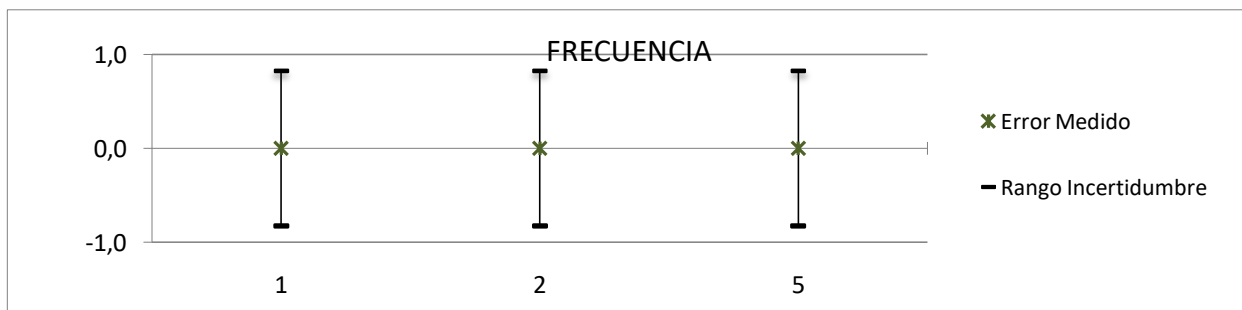

FIN DEL CERTIFICADO