

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

L3751125

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJOMETRO
Device
MARCA: FLOWMETER
Brand
MODELO: FM197B-15L-CH
Model
SERIE: NA
Serial
Inventario Institución: 574385
Institute Inventory

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	2266044	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: 26-11-2025
Date of Receipt
Fecha Calibración: 26-11-2025
Date of Calibration
TEMPERATURA Inicial: 21 °C
Temperature
Final: 22 °C
End
HUMEDAD Rel. Inicial: 67 %
Humidity
Final: 68 %
End
Lugar de Calibración: HOSPITALIZACION CIRUGIA
Place of Calibration

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital universitario San Jorge de pereira
Institution
TELÉFONO: 6063119058
Telephone
CIUDAD: PEREIRA
City
DIRECCIÓN: cra 4 #24-88
Address
Correo: rutahospitalaria@husj.gov.co
E-mail

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó

Leire Garcia

LEIREGARCIA MORALES

Metrologa
Metrologist

MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

Cooperativa de Entidades de Salud del Risaralda
Avenida 30 de Agosto 87 298 Pereira Risaralda
PBX: (6) 3272070
www.coodesuris.com

Certificado de Calibración N° L3751125

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

FLUJO

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
1	0.78	-0.22	$\pm$	0.059	lpm
6	6.39	0.39	$\pm$	0.059	
12	14.00	2.00	$\pm$	0.059	

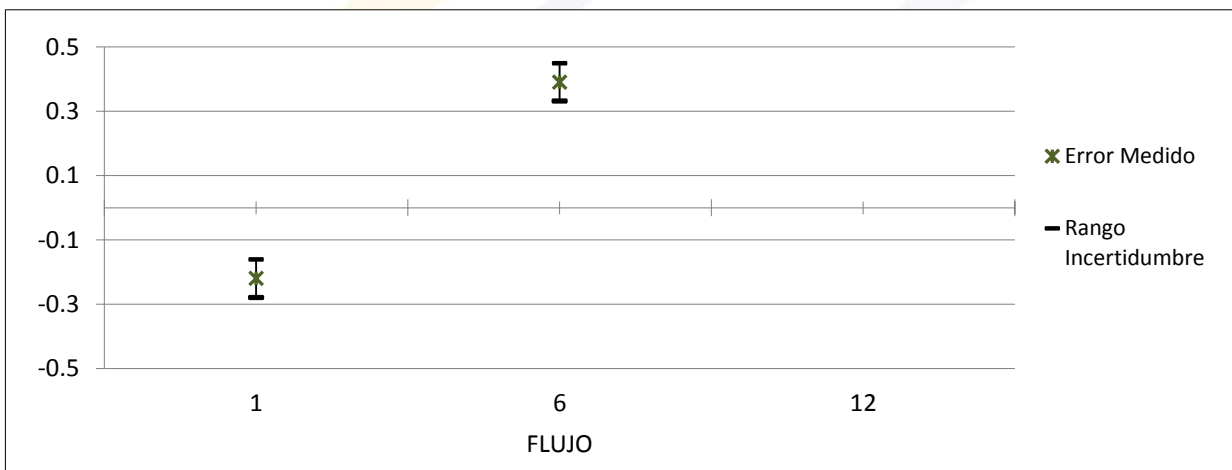

FIN DEL CERTIFICADO