

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M3671125

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: INCUBADORA DE CONTROLES BIOLÓGICOS **MARCA:** 3M
Device Brand
MODELO: ATTEST AUTO READER 390G **SERIE:** 402182
Model Serial
Inventario Institución: NO DEFINIDO
Institute Inventory

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Multímetro	FLUKE	179	18960429	2025-09-09

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: 2025-11-25 **Fecha Calibración:** 2025-11-25
Date of Receipt Date of Calibration
TEMPERATURA Inicial: 21 °C **Final:** 21 °C **HUMEDAD Rel. Inicial:** 57 % **Final:** 57 %
Temperature End Humidity End
Lugar de Calibración: CENTRAL DE MATERIALES
Place of Calibration

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
Institution
TELÉFONO: (606)3119058 **CIUDAD:** PEREIRA
Telephone City
DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88 **Correo:** coordinacion.biomedicos@husj.gov.co
Address E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
Métrólogo
Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
 This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
 The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
 The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
 The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
 Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
 The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

TEMPERATURA

Medición de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	Error	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
37	37,80	0,80	$\pm$ 0,20	°C

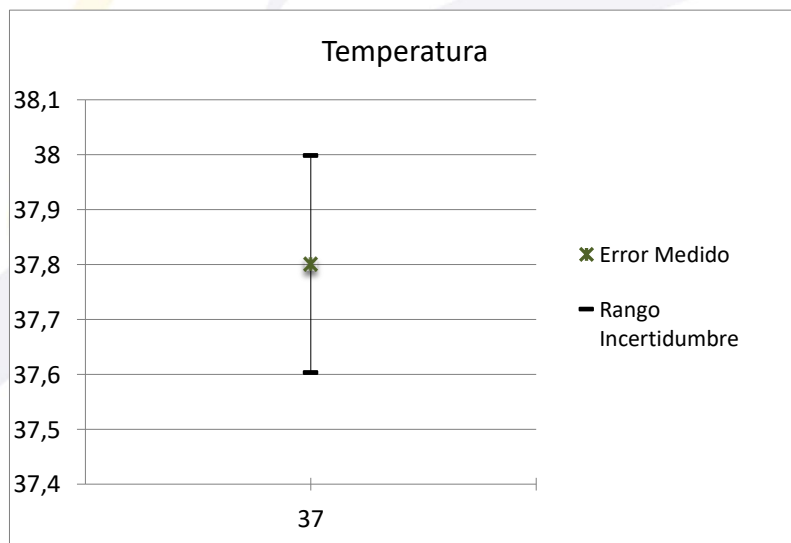

FIN DEL CERTIFICADO