

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

J0040925

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO: Device	INFUSOR	MARCA: Brand	RIESTER	
MODELO: Model	METPAK	SERIE: Serial	181120887	
Inventario Institución: Institute Inventory	574583	UBICACIÓN: Location	UCI PEDIATRÍA	

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 4	2667213	2025-01-30

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN										
Fecha Recepción:		2025-09-02			Fecha Calibración:		2025-09-02			
Date of Receipt					Date of Calibration					
TEMPERATURA Inicial:		26	°C	Final:	26,2	°C	HUMEDAD Rel. Inicial:		61	%
Temperature				End			Humidity			
Lugar de Calibración:		HOSPITAL SAN JORGE								
Place of Calibration										


DATOS DE LA INSTITUCIÓN				
INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	CIUDAD: City	PEREIRA	
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058	Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co	
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88			

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrologist

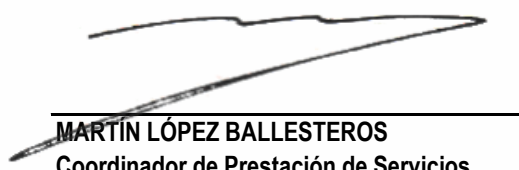
MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris

This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados

The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia

Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$

The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
50	49,80	-0,20	±	1,41	mmHg
100	99,35	-0,65	±	1,36	
200	198,45	-1,55	±	1,36	
300	298,65	-1,35	±	1,60	

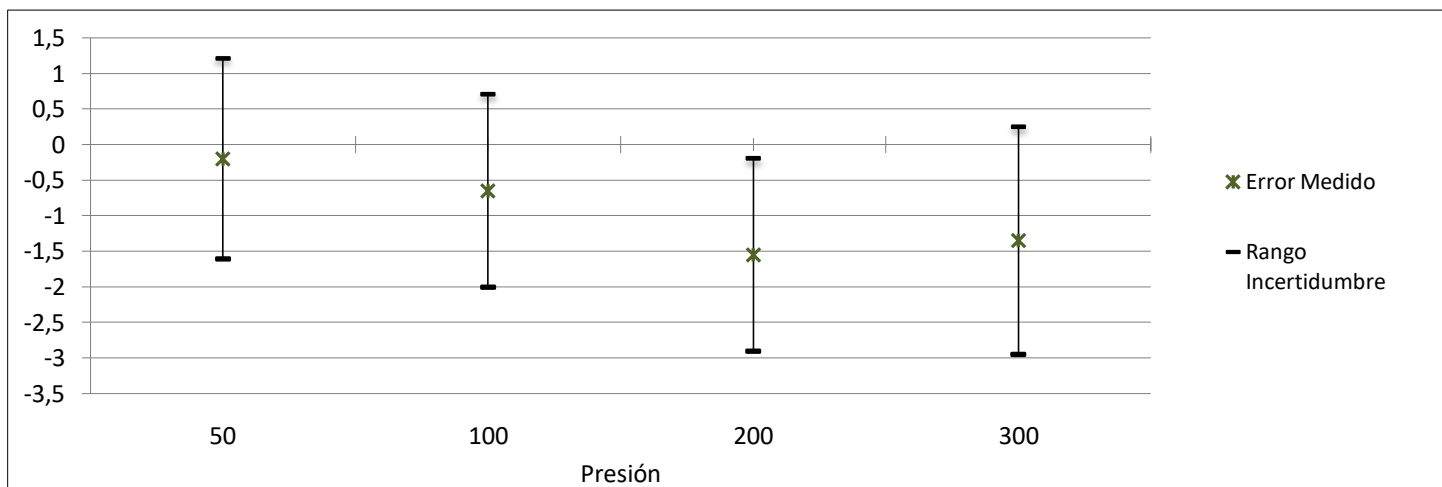

FIN DEL CERTIFICADO