

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

J0150925

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO: Device	INFUSOR	MARCA: Brand	RIESTER
MODELO: Model	METPAK	SERIE: Serial	181120890
Inventario Institución: Institute Inventory	574588	UBICACIÓN: Location	UCI PEDIATRÍA

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 4	2667213	2025-01-30

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN					
Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-09-15		Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-09-15	
TEMPERATURA Inicial: Temperature	26.1 °C	Final: End	26,1 °C	HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	61 %
				Final: End	61 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE				

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88
CIUDAD: City	PEREIRA
Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrologist

Revisó


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
50	48,25	-1,75	±	1,74	mmHg
100	97,75	-2,25	±	1,47	
200	196,95	-3,05	±	1,60	
300	296,55	-3,45	±	1,60	

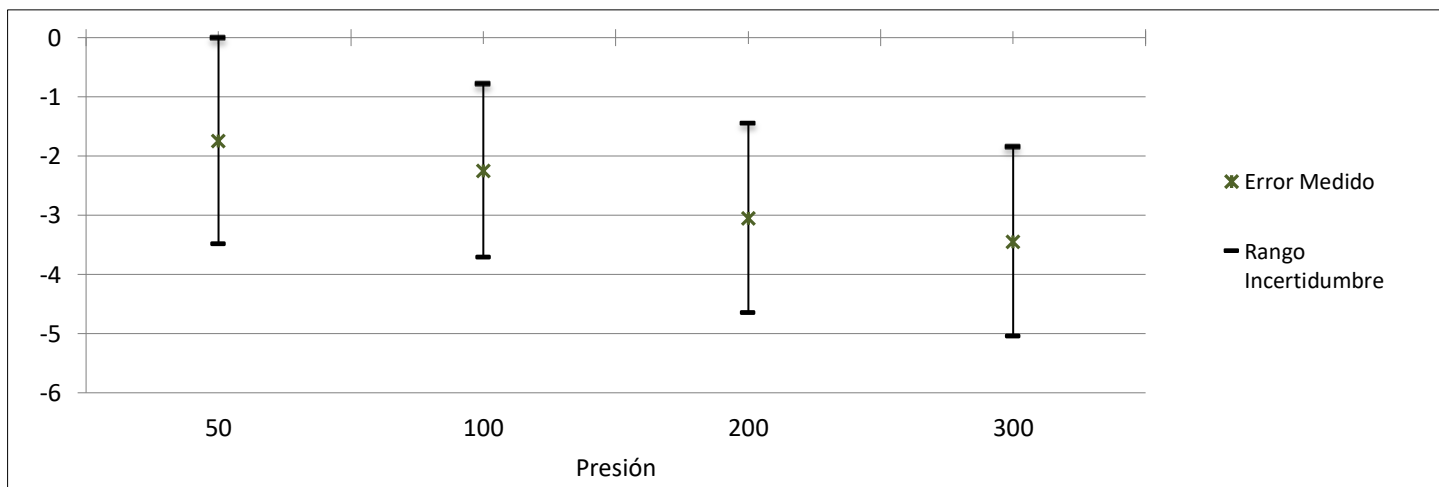

FIN DEL CERTIFICADO