

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° J0081225

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO: Device	MARCAPASOS BICAMERAL	MARCA: Brand	MEDTRONIC	
MODELO: Model	5392	SERIE: Serial	DJH006374P	
Inventario Institución: Institute Inventory	546337	UBICACIÓN: Location	QUIRÓFANO	

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Osciloscopio	Fluke Biomedical	124	24750207	2025-08-20

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN									
Fecha Recepción:		2025-12-01		Fecha Calibración:		2025-12-01			
Date of Receipt				Date of Calibration					
TEMPERATURA Inicial:		24,5 °C	Final:	24,5 °C	HUMEDAD Rel. Inicial:		59 %	Final:	59 %
Temperature			End		Humidity			End	
Lugar de Calibración:		HOSPITAL SAN JORGE							
Place of Calibration									

DATOS DE LA INSTITUCIÓN				
INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE			
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058	CIUDAD: City	PEREIRA	
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88	Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co	

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrologo
Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris.
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia.
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern.

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$.
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k=2$.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

CANAL A


Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	Error	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
2	2,01	0,01	±	0,17	mA
5	5,26	0,26	±	0,17	
10	10,03	0,03	±	0,19	
20	20,03	0,03	±	0,22	

CANAL V

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	Error	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
2	2,02	0,02	±	0,17	mA
5	5,21	0,21	±	0,17	
10	10,25	0,25	±	0,18	
20	20,09	0,09	±	0,21	

FRECUENCIA

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
40	40,05	0,05	±	0,83	pulse/min
80	79,95	-0,05	±	0,86	
160	157,86	-2,14	±	0,82	

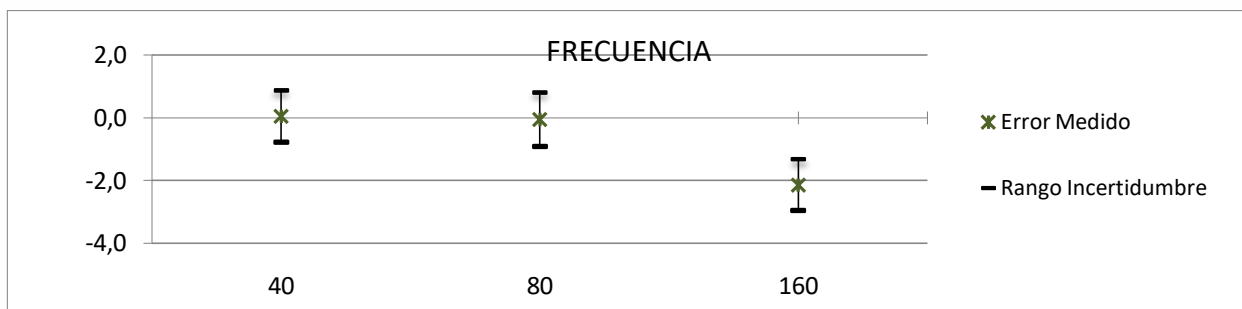

FIN DEL CERTIFICADO