

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° J1981125

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO: Device	GENERADOR MARCAPASOS	MARCA: Brand	OSYPKA
MODELO: Model	101H	SERIE: Serial	1337124
Inventario Institución: Institute Inventory	545698	UBICACIÓN: Location	UCI ADULTOS

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Osciloscopio	Fluke Biomedical	124	24750207	2025-08-20

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN					
Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-11-26		Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-11-26	
TEMPERATURA Inicial: Temperature	25,2 °C	Final: End	25,1 °C	HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	61 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE		Final: End	61 %	

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88
CIUDAD: City	PEREIRA
Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: LM-F0002 - VERSION 01

Elaboró


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrologo
Metrologist

Revisó


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador del Laboratorio
Laboratory Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris

This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados

The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia

Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$

The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

VOLTAJE V-STIM


Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
1	1,11	0,11	±	0,60	
6	6,18	0,18	±	0,60	
12	12,35	0,35	±	0,60	
					V

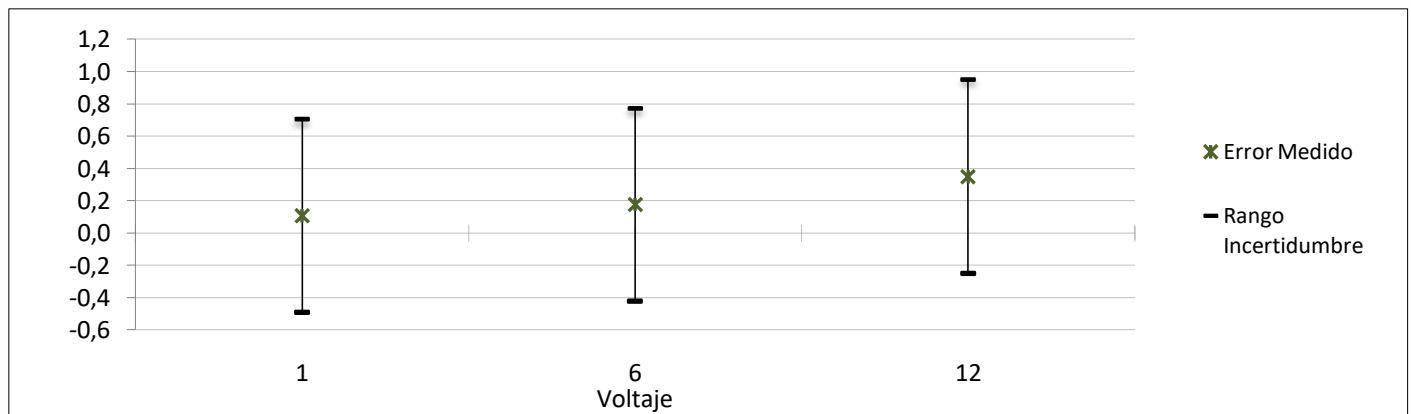

FRECUENCIA

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
60	61,08	1,08	±	0,86
160	159,54	-0,46	±	0,82

Unidad de la Medición
Pulse/Min

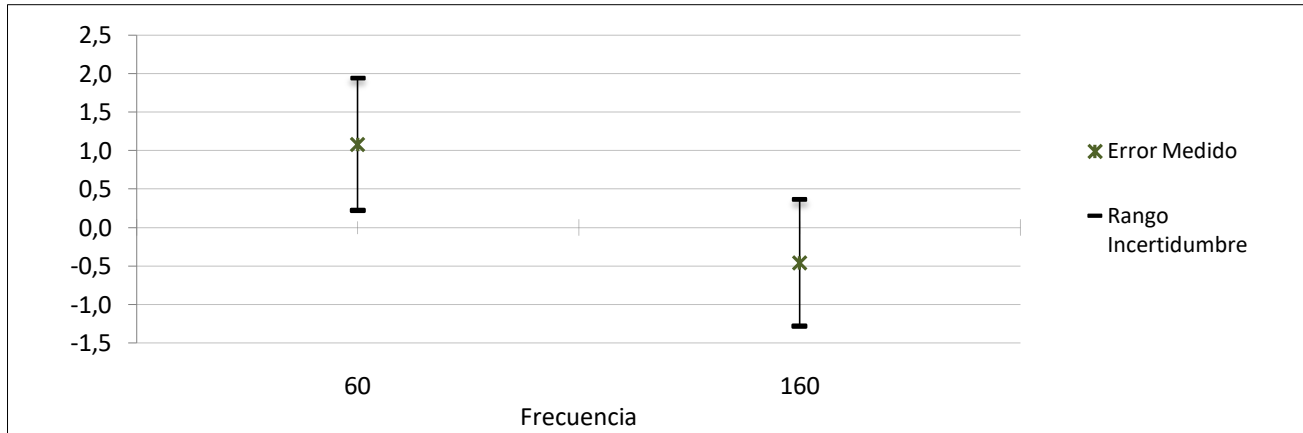

FRECUENCIA X2

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
80	81,48	1,48	±	0,82
180	180,72	0,72	±	0,82

Unidad de la Medición
Pulse/Min

FIN DEL CERTIFICADO