

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

L4231125

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MONITOR DE PRESIÓN
Device
MARCA: LENZ
Brand
MODELO: NA
Model
SERIE: 805BJ09150000867
Serial
Inventario Institución: 572988
Institute Inventory

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 4	2667213	2025-01-30

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: 2025-11-28
Date of Receipt
Fecha Calibración: 2025-11-28
Date of Calibration
TEMPERATURA Inicial: 21 °C **Final:** 22 °C
Temperature End
HUMEDAD Rel. Inicial: 56 % **Final:** 58 %
Humidity End
Lugar de Calibración: BANCO DE SANGRE
Place of Calibration

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital universitario San Jorge de pereira
Institution
TELÉFONO: 6063119058
Telephone
CIUDAD: PEREIRA
City
DIRECCIÓN: cra 4 #24-88
Address
Correo: rutahospitalaria@husj.gov.co
E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
Métrólogo

Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

Cooperativa de Entidades de Salud del Risaralda
Avenida 30 de Agosto 87 298 Pereira Risaralda
PBX: (6) 3272070
www.coodesuris.com

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
 This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
 The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
 The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
 The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
 Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
 The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA


Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
80	74.50	-5.50	± 1.01	mmHg
120	114.00	-6.00	± 0.82	
200	193.00	-7.00	± 1.42	

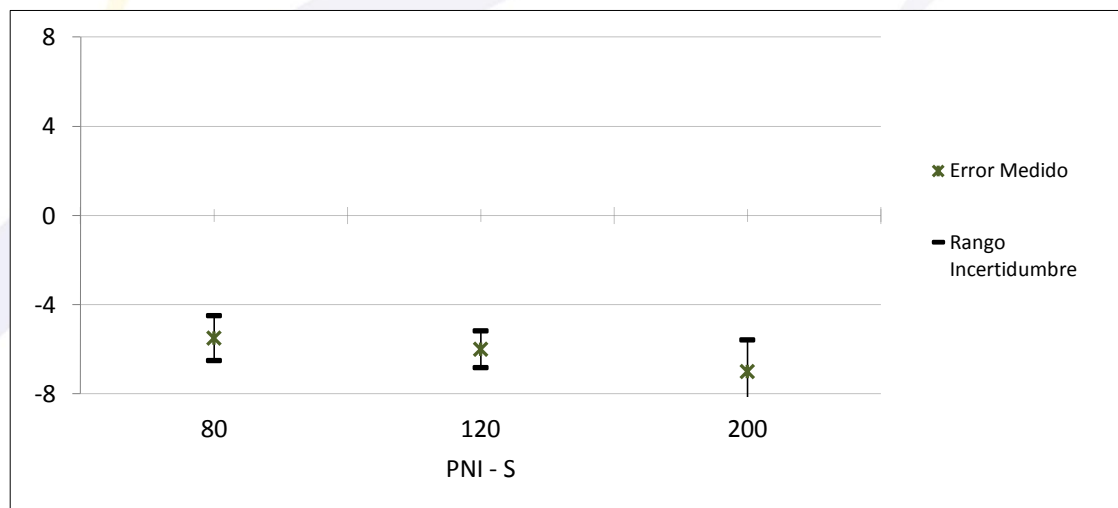

PRESIÓN NO INVASIVA DIASTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
50	47.00	-3.00	±	0.82
80	81.67	1.67	±	1.01
150	147.50	-2.50	±	1.01


Unidad de la Medición
mmHg

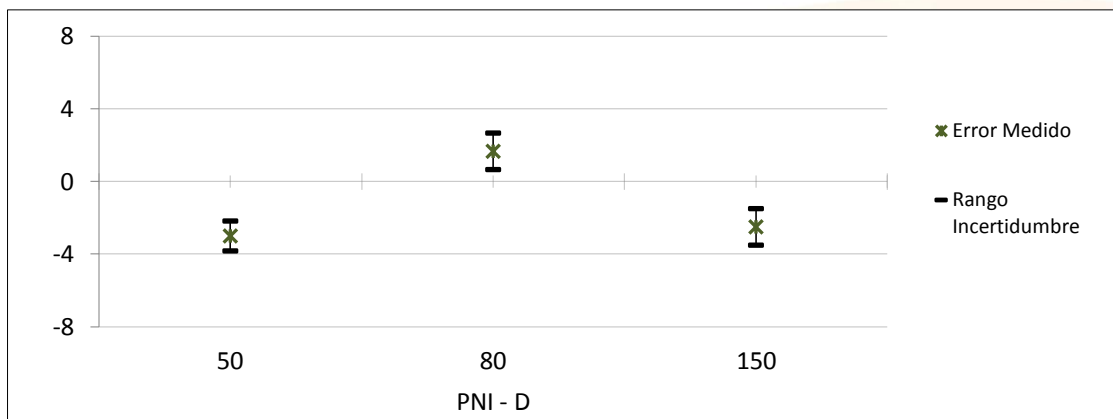

FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
50	50.00	0.00	±	0.82
130	130.00	0.00	±	0.82
180	179.50	-0.50	±	1.00

Unidad de la Medición
BPM

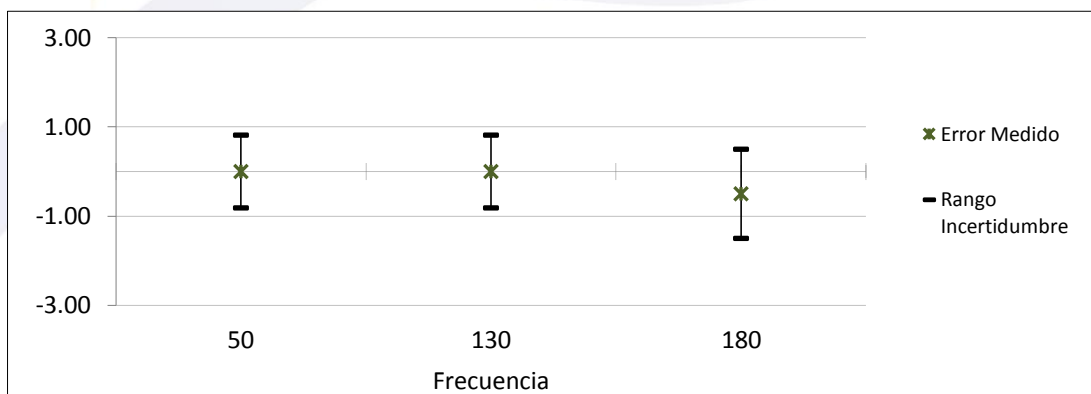

FIN DEL CERTIFICADO